


機械器具62 歯科用切削器  
歯周用キュレット／JMDN 41660000

## ポイント式チタンコートキュレット

### 【禁忌・禁止】

1. 本製品は使用目的以外に使用しないこと。
2. 有資格者以外の使用を禁止すること。

### 【形状・構造及び原理】

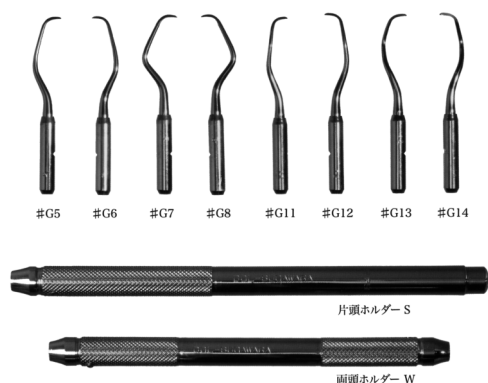

### 【使用目的又は効果】

多くは丸みを帯び、凹面に研磨された鋭利な刃をもち、横断面が半円形の歯科用器具で、歯周ポケット及び根面の搔爬に用いる。

### 【使用方法等】

多くは丸みを帯び、凹面に研磨された鋭利な刃をもち、横断面が半円形の歯科用器具で、歯周ポケット及び根面の搔爬に用いる手用器具である。

### 【使用上の注意】

1. **注意事項の厳守：**器具の正しい使用のために、下記の注意事項を必ず守ること。
  - ・本製品は使用するために必要は知識、技術に習熟した医師が使用すること。
  - ・本製品は未滅菌の為、使用前に必ず洗浄・滅菌を施すこと。
  - ・本製品を包装から取り出す際、及び使用後、洗浄・消毒・滅菌時には先端に十分注意して取り扱うこと。
  - ・異常に気づいた時は、直ちに使用を中止すること。
  - ・性能が落ちた場合は、早めに新品と交換すること。
  - ・本製品は金属であるため、度重なる使用による金属疲労により破損する事がある。
2. **不具合・有害事象の注意事項：**本製品の使用により以下のような不具合・有害事象が起こる可能性がある。
  - ・本製品の適切な洗浄・滅菌を怠ったために起きる感染。
  - ・皮膚の裂傷やグローブの破れ。
  - ・金属アレルギー
3. **ステンレス鋼使用：**素材のステンレス鋼は、鉄に比較して錆びにくい金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。以下の使用上の注意を守ること。

4. **禁忌の薬剤：**次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジンは金属腐食を起こす恐れがあるので、使用しないこと。
5. **家庭用洗剤の使用禁止：**家庭用洗剤は、金属を腐食させることがあるので使用しないこと。洗浄には、歯科用防錆洗浄剤を使用すること。
6. **機能水の使用禁止：**超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
7. **洗浄、消毒、滅菌上の注意：**
  - ・使用後は、防錆洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
  - ・洗浄、消毒、滅菌には、出来るだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で器具が腐食することがある。
  - ・薬液消毒を行なう時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。薬剤の種類によっては、金属素材に影響を及ぼすことがある。
  - ・加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器など）の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質または変色することがある。
  - ・洗浄、消毒、滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の原因となることがある。
8. **磨き粉、金属ウール・金ブラシの使用禁止：**腐食（錆び）の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシを使用しないこと。
9. **保管上の注意：**「もらいさび」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品といっしょに収納・保管しないこと。

### 【保管方法】

1. 本製品は高温・高湿を避け、塵やほこりのない清潔な場所に保管すること。また水漏れや直射日光は避けるよう細心の注意を払うこと。
2. 本製品は、保管の際、変形や損傷の原因になりうる硬い物への接触や、衝撃、落下を避けるよう注意を払うこと。

### 【取扱い上の注意】

1. 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑は取扱いしないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

**使用前・使用後の点検：**使用前・使用後に、刃部に破損、ヒビ、キズがないか、又作業部・柄部に大きなキズや腐食等がないか確認すること。これらがある場合は、使用を中止すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者  
有限会社 菅原歯科精器工業  
電話番号：03-3893-8051