


スカルペルハンドル SAFE-EX(シュベルト)

【形状、構造及び原理等】

1) 形状

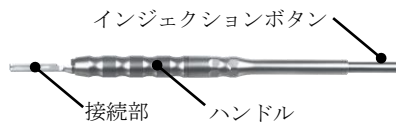

型番
1033-60

2) 原材料：ステンレススチール

【使用目的又は効果】

本品は、組織の切断又は切離が可能な刃を取り付けるために設計された金属性の手術器具である。

【使用方法等】

＜使用前の準備＞

- 1) 本品は洗浄・滅菌後に使用すること。
- 2) 接続部にガタ等が無いかを確認する。

＜使用中の操作＞

- 1) 本品に合う刃（ナイフ等）を選択し、接続部に取り付ける。
- 2) ハンドルを持ち刃（ナイフ等）を操作する。

＜使用後の処置＞

- 1) インジェクションボタンを押し、刃（ナイフ等）を取り外す。
- 2) 表面に付着した異物を拭取った後、温水で洗浄を行う。
- 3) オートクレーブ滅菌を行った後はよく乾燥させる。
- 4) ネジ部分には脱着のしやすさを保つため、別売りのオイルを使用してもよい。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 1) 塩化ナトリウム溶液には浸さないこと。[ひび割れ、腐食の原因となる。]

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 粗雑な取扱いは本品の寿命を著しく低下させるので注意すること。
- 2) 破損、曲がり等の原因となり得るので使用時に必要以上の力を加えないこと。
- 3) 推奨条件以外で滅菌を行う場合はバリデーションを行うこと。その際は 137℃を超えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 高温・多湿を避け、乾燥した場所に保管すること。
- 2) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の曝露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

【保守・点検に係る事項】

＜洗浄・消毒・滅菌方法＞

- 1) 使用後は市販の洗浄剤を用いて洗浄すること。
- 2) 洗浄にはやわらかいブラシを用い、金属製のブラシは用いないこと。

- 3) 自動洗浄を行った場合は、93℃10 分間の熱消毒を行うこと。
- 4) すすぎは蒸留水を用いること。表面のシミや腐食を防ぐことができる。
- 5) 乾燥温度は 93℃を超えないこと。
- 6) 滅菌方法はオートクレーブ滅菌とし、滅菌器の取扱い説明書に従うこと。
- 7) 急速な滅菌は摩耗の原因となることがあるので注意すること。
- 8) 滅菌後は放冷すること。

推奨滅菌条件	
温度：121℃	時間：20 分以上
温度：132℃	時間：15 分
温度：134℃	時間：5 分

＜使用者による保守点検事項＞

- 1) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

＜製造業者＞

A. Schweickhardt GmbH & Co. KG
国名：ドイツ