

機械器具 25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ（JMDN：37090010）

ディフェンド ディスポーザブルキット（送気・送水／吸引 ボタン／

再使用禁止

鉗子栓／灌流コネクター） 富士フィルム内視鏡 G7 操作部用


【禁忌・禁止】

1. 使用方法
- 1) 再使用禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状

1) 鉗子栓



2) 送気・送水ボタン

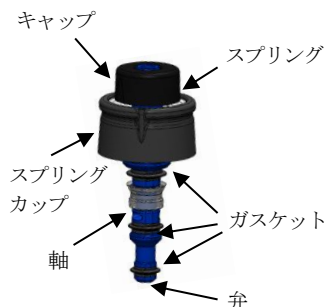

3) 吸引ボタン



4) 灌流コネクター



<付属品>

- ・クリーニングアダプタ

2. 原材料（使用中に間接的に体液等に接触する部分）

- ・鉗子栓：熱可塑性エストラマー
- ・送気・送水ボタン
 - ・ガスケット：熱可塑性エストラマー
 - ・軸：ポリカーボネート
 - ・弁：シリコーン
- ・灌流コネクター：ポリカーボネート

3. 寸法

	鉗子栓	送気・送水ボタン	吸引ボタン	灌流コネクター
外径(mm)	φ 15.8	φ 17.2	φ 17.2	φ 11.7
全長(mm)	22.8	32.0	29.0	24.1

4. 原理

1) 鉗子栓

処置具を内視鏡に挿入するとき、処置具が内視鏡の鉗子口に直接接触することを防止する。また、キャップを本体上部に嵌めることにより、内視鏡の鉗子口のキャップとして機能する。

2) 送気・送水ボタン

ボタン中央部の穴を指でふさぐと送気し、穴をふさいだまま押し込むと送水する。

3) 吸引ボタン

押し込むと内視鏡の先端部から体内の体液や空気などを吸引する。

4) 灌流コネクター

イリゲーションチューブに接続して洗浄液等の吸引又は注入の操作を行う。

【使用目的又は効果】

本品は、富士フィルム株式会社製の消化器内視鏡（G7 操作部）の鉗子栓取付口金、送気・送水シリンダー、吸引シリンダー及び副送水チャンネルにそれぞれ取り付け、以下の目的で使用する。これらは、それぞれ任意の組み合わせで販売される。

1. 鉗子栓

処置具が鉗子口に直接触れることなく、接続及び交換ができるようにする。また、内視鏡処置中、体液などの生体物質の漏出を最小限に抑えるとともに、還流を可能にする。

2. 送気・送水ボタン

送気・送水機能进行操作する。

3. 吸引ボタン

体内の体液や空気などの吸引機能进行操作する。

4. 灌流コネクター

イリゲーションチューブに接続して洗浄液等の吸引又は注入の操作を行う。

【使用方法等】

1. 鉗子栓

- 1) 滅菌包装を開封し、鉗子栓を取り出す。
- 2) 本品を内視鏡の鉗子栓取付口金に取り付け、はまるまで押し下げる。
- 3) 必ず本品の蓋が閉まっていることを確認する。
- 4) 直径が 3mm 以上のものを通す場合、蓋を開けて処置具を挿入する。
- 5) 処置後、本品を取り外し廃棄する。

2. 送気・送水ボタン

- 1) 滅菌包装を開封し、送気・送水ボタンを取り出す。
- 2) 本品を内視鏡の送気・送水シリンダーに取り付け、軽く前後に動かしつつ、ねじりながら押し下げ、はまるまで押し下げる。
- 3) 処置を行う前にボタンを押し下げ、送気・送水チャンネルに送水する。
- 4) 処置後、内視鏡を再洗浄・再滅菌する前に、本品を廃棄する。

3. 吸引ボタン

- 1) 滅菌包装を開封し、吸引ボタンを取り出す。
- 2) 本品を内視鏡の吸引シリンダーに本品を取り付け、軽く前後に動かしつつ、ねじりながら押し下げ、はまるまで押し下げる。
- 3) 処置を行う前にボタンを押し込んで吸引することを確認する。
- 4) 処置後、内視鏡を再洗浄・再滅菌する前に、本品を廃棄する。

4. 灌流コネクター

- 1) 滅菌包装を開封し、灌流コネクターを取り出す。
- 2) 本品を内視鏡の副送水チャンネルへ取り付け、抵抗を感じるまでゆっくり回す。
- 3) ルアーロック接続を介して、イリゲーションチューブをバックフローバルブにしっかり取り付ける。
- 4) 処置を行う前にイリゲーションチューブ及び内視鏡に滅菌水を送水する。
- 5) 処置後に本品を廃棄する。

<組み合わせて使用する医療機器>

本製品は、以下の医療機器と組み合わせて使用する。
・富士フィルム株式会社製消化器内視鏡（G7 操作部）

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

本品に劣化や傷がある場合や、操作や機能に異常のあるものは使用せず、洗浄・消毒・滅菌された新しい製品と交換すること [送気・送水機能が低下するだけでなく、患者の体液などが逆流・飛散し、使用者の感染の原因となるおそれがあるため]。

【使用目的又は効果】

本品の使用に伴い、以下のような有害事象が起こる可能性がある。
感染、損傷

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、高温多湿・直射日光を避けて清潔な場所に保管する。
2. 有効期間
外装に記載の通り（自己認証による）。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

1. 製造販売業者 ステリスジャパン株式会社
電話 03-5210-1521
2. 外国製造業者 Medivators Inc.
メディベーターズ インク
(アメリカ)