

機械器具 51 医療用嘴管及び体液導管
高度管理医療機器 大動脈カニューレ 35565100
(手術用噴霧器 18033000)

体外循環用力カニューレ フレックスメイト (サージブロー エアーフィルターなし SBKN-S)

再使用禁止

【警告】

- ・本品にはエアーフィルターが内蔵されておりません。
- ・本品を使用する場合には、必ずエアーラインもしくは炭酸ガスラインに未使用の滅菌済エアーフィルターを接続してください。
- ・本品にはエアーもしくは CO_2 を使用し酸素は使用しないこと。[酸素を使用すると電気メス等との併用により発火の可能性があります。]
- ・本品とエーチューブを接続しバンド等でしっかりと固定すること。その際、アルコールやアルコールベースの液体及び溶剤等は使用しないこと。[コネクター部にクラックが発生し機能しなくなる恐れがあります。]
- ・本品先端部は吻合部から 5~15cm 離して使用すること。
[近づけすぎると吻合部よりエアーやが混入する恐れがあります。]
- ・本品先端部が患部に直接ふれないようにすること。
[血管吻合部を損傷する可能性があります。]


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）、ポリカーボネートを使用している。

商品番号
SBKN-S

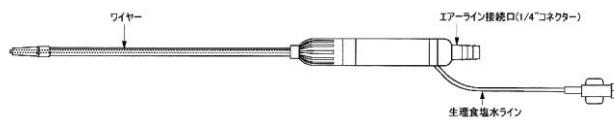

本品は生理食塩水ラインとエアーラインを有し、輸液セットより送り出された生理食塩水とボンベもしくは配管より送り出されたエアーもしくは CO_2 を本体先端部より同時に噴霧させる。

【使用目的又は効果】

本品は心臓手術の際に、一時的に使用する人工心肺ディスポーズブルーセットに接続して使用する。具体的には脱血用カニューレは人工心肺回路の脱血用回路に、送血用カニューレは人工心肺回路の送血回路に、順行性冠灌流（アンテプレジア）用カニューレ、逆行性冠灌流（レトロプレジア）用カニューレ及び心筋保護用部品は心筋保護液注入用回路に、経皮挿入用カニューレは PCPS 用の血液回路に、その他のカニューレは吸引用や輸液用等の回路に、それぞれ接続して使用することを目的とする。

【使用方法等】

使用方法の一例

1. セッティング及び操作方法
 - (1) エーチューブを本品エアーライン接続口に根元まで確実に差し込み、バンド等で固定する。
 - (2) 輸液セットを使用し、生理食塩水を本品生理食塩水ラインに接続する。

- (3) 流量計等を使用し適切な流量に調整する。 CO_2 ボンベを使用する場合には必ずヒーター内蔵のレギュレーター付流量計を使用する。
 - (4) 生理食塩水の量は輸液セットのロールクランプで適切になるよう調整する。
 - (5) (3) 及び (4) を行いながら適切な噴霧状態を維持する。
2. 使用方法に関する使用上の注意
 - (1) 本品の使用を途中で中断する場合は、必ず本品生理食塩水ラインのクランプを行うこと。
 - (2) エアーもしくは CO_2 流量は 3 l/min 以下で使用すること。
 - (3) 本品を極端に曲げた状態で使用しないこと。[エアーもしくは CO_2 が出なくなる恐れがあります。]

【使用上の注意】

使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- ・本品はエアーもしくは CO_2 と生理食塩水を同時に吹きつけ、手術視野の確保を目的としています。よって当該使用目的以外には使用しないこと。

重要な基本的注意

- ・本品の使用は用法を熟知した外科、心臓血管外科、胸部外科及び救命救急部の医師に限ること。
- ・本品及び包装に破損、その他の異常が認められた場合は使用しないこと。
- ・本品は滅菌医療機器であり、滅菌包装の開封は使用直前に行いつつ滅菌包装内の本品の取り出しが清潔域にて行うこと。
- ・本品使用後は血液による汚染を避けるため、十分な措置をとった後に一般廃棄物と区別して処理すること。
- ・本品の内容が目的とする仕様（例えば脱血用、送血用またはその他の使用目的）に合致していることを確認した後、使用すること。
- ・本品の仕様・外観等は改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
- ・病院内の運搬・保管・操作の不注意によって本品に不具合が生じたと考えられる場合には補償はできません。
- ・不注意による不適切な取扱い、誤使用により発生するあらゆる人的被害については責任を負いかねます。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水のかからない場所に保管すること。
 - ・高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
 - ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないこと。
- ##### 有効期間
- ・本品滅菌袋に貼付されているラベルに記載。「自己認証による。」

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者

泉工医科工業株式会社
埼玉県春日部市浜川戸 2-11-1

お問い合わせ先

泉工医科工業株式会社 商品企画
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011