2019 年 3 月（第 1 版）

機 械 器 具 51 医療用嘴管及び体液誘導管　　届出番号：13B2X00095000005
一 般 医 療 機 器　再使用可能な歯科用吸引カニューレ　JMDN コード：38759000

排唾ノズル

【警告】
患者ごとに、指定する方法および条件で、洗浄などの処理を行った上で滅菌すること。
［感染予防のため］

【形状、構造及び原理等】
形状

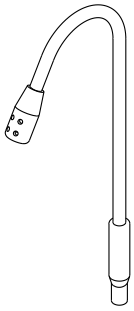

全長：119mm
材質：黄銅

【使用目的又は効果】
歯科用ユニットの排唾ハンドピースに接続して、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。本製品は滅菌後に再使用する。

【使用方法等】

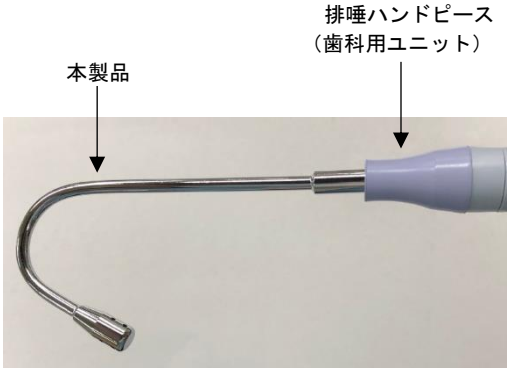

1．本品の外径（φ5.0mm、φ6.5mm）に合う歯科用ユニットの排唾ハンドピースに接続し、歯科用ユニットを操作して、口腔内の水分や切削片などを先端部より吸引する。

2．排唾ハンドピースから取り外し、洗浄、消毒および１３４℃／３分のオートクレーブ滅菌を患者ごとに行う。

【使用上の注意】
・滅菌の注意事項
①本製品は、オートクレーブ滅菌可能です。感染予防のため、患者ごとにオートクレーブ滅菌を行うこと。
②本製品は未滅菌で供給されますので、使用前に洗浄および滅菌をすること。
③オートクレーブ滅菌以外の滅菌は行わないこと。

・使用前の注意事項
①排唾ハンドピースへ確実に接続し、がたつきがなく簡単に外れないことを確認してから使用すること。
②汚れ、傷、破損などの有無を確認すること。
・使用中の注意事項
①本製品のみならず、接続している関連機器全般と患者の状態を常に監視し、異常が見られた場合は直ちに使用を中止すること。
②本製品を口腔内に強く押し当てて使用しないこと。また、継続的な局部への吸引を行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】
①洗浄、滅菌後の製品は、水分を除去し、十分乾燥させてから、滅菌状態を保つことができる容器にいれて保管すること。
②使用回数に関わらず、傷、破損などが見られたら、使用せずに廃棄すること。

【保守・点検に係る事項】
〈使用者による保守点検事項（日常点検）〉
外観の劣化状態を毎使用前後に確認すること。
〈洗浄、消毒、および滅菌方法〉
1．目視で確認できる汚れは、水道水ですすぎながらブラシなどで取り除く。
2．消毒剤に 5 分間浸漬させて、水道水で十分にすすぎ洗いを行う。
3．滅菌パウチに入れオートクレーブ滅菌を行う。（推奨滅菌条件：１３４℃／３分）
・消毒剤を使用する時は、薬剤の添付文書に記載された使用上の注意を守ること。消毒剤はアルカリ性のものを推奨します。
・オートクレーブ滅菌器の取扱説明書を参照し、適切な条件、状態で滅菌を行うこと。
・高温での乾燥は、本製品の材質に影響を与えるので、乾燥工程は１３５℃以下で行うこと。

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

製造販売業者 ベルモントテクノロジー株式会社 ＴＥＬ：０３－３６３７－７１１１
販売業者