

機械器具1 手術台及び治療台
一般医療機器 眼科用手術台 JMDNコード：37225000
メプロ5


*【形状・構造及び原理等】

1) 作動原理


電動油圧装置及び電動モーターを制御することで、機器を作動させます。

2) 外観図


(メプロ5)

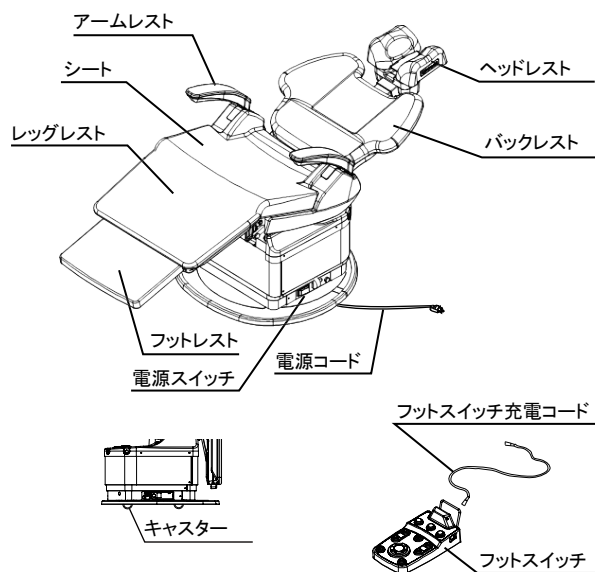

(メプロ5N)

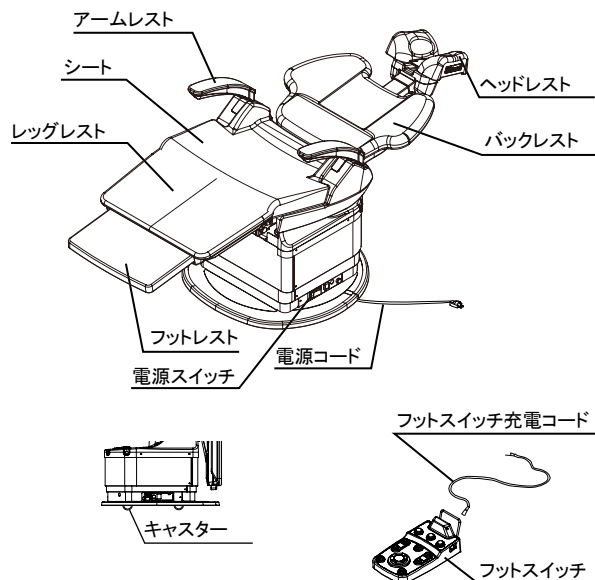

(メプロ5Nプラス)

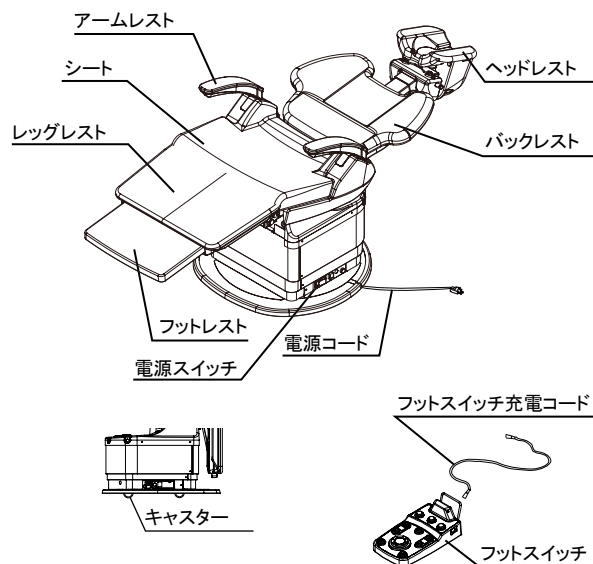

3) 機器の分類

電撃に対する保護の形式による分類：クラス I 機器
電撃に対する保護の程度による分類：B形装着部

4) 電氣的定格

- ①定格電圧：AC100V
- ②電源周波数：50/60Hz
- ③電源入力：メプロ5
3. 7/4. 2A
メプロ5N
4. 1/4. 5A
メプロ5Nプラス
4. 1/4. 5A

5) 機器の仕様

- ①ヘッドレスト部
 - ・ヘッドレストの昇降、ヘッドレストの前屈・後屈・横転（横転はメプロ5Nプラスのみ）
 - 電動モーター式
 - ・ヘッドレストの高さ調節
 - 手動式
- ②バックレスト部
 - ・バックレストの回転（寝起き）
 - 電動油圧式
- ③手術台（椅子）の昇降
- 電動油圧式
- ④フットレスト部の伸縮
- レッグレストの跳ね上げ動作と連動
- ⑤手術台（椅子）の本体移動・固定
- 電動油圧式

<動作保証条件>

下記の条件にて使用すること。（但し、結露しないこと）

周囲温度：0～40℃
相対湿度：10～95%
気圧：700～1060hPa

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

1E08YYB0

【使用目的又は効果】

本機器は眼科手術に使用する眼科用手術台である。

【使用方法等】

- 1) 取付・設置（組立て・据え付け）
 - ①機器の取付・設置は専門の担当者（当社又は当社指定の業者）が行うこと。
 - ②本製品は、必ず平らで丈夫な床の上に設置すること。床面が5°以上傾いている場所へ設置すると本製品が転倒するおそれがあります。
 - ③設置位置は本製品を作動しても壁や周辺機器に当たらない場所にすること。
- 2) 操作方法又は使用方法
機器の詳細な操作方法及び使用方法については、付属の取扱説明書を使用前に必ず読むこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 患者に治療中は動かない様に十分に説明し、操作者は患者等（小児等、介添者や医療スタッフ含む）の手・指・身体の一部を機器の可動部やその周辺に近寄らせないこと。（挟まれて人身事故の原因になるため）
また、操作者は常に患者等から目を離さないこと。
- 2) 薬液等が樹脂や金属塗装面に付着した場合、樹脂が変質したり、塗装が剥れ、内部金属が腐食するおそれがあるので、速やかに清掃してください。
- 3) 機器の清掃には取扱説明書で指定した洗剤を使用すること。
- 4) 手術台（椅子）を作動させる時は、周囲の安全を確認後、作動させること。
- 5) 作動時にはさみ込みのおそれがあるため、周囲に障害物がある時は機器を作動させないこと。
- 6) 他の医用電気機器と併用する場合、電磁的影響による不正確な動作が発生することがないか使用前に確認すること。
- 7) 人体質量135kgより大きな人、及び同時に複数の人を乗せないこと。
- 8) 診療後、または使用しない時は、本体電源を切り、コンセントから電源プラグを抜くこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜耐用期間＞

10年間。（自己認証（当社データ）による。）

※正規の使用法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

シート、ヘッドレストなどのクッション部品、及びスイッチ類は使用環境によって異なります。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項（日常点検）＞

使用者による保守点検内容の概要は、下記のとおりとする。

点検頻度	点検項目
始業前	外観の確認 外観に異常がないことを確認すること。
始業前	正常状態の確認 正常状態・正常動作を確認すること。
始業前	固定状態の確認 本製品の固定を確認すること。
終業後	清浄性の確認 清浄な状態であることを確認すること。

※詳細については、取扱説明書を参照すること。

＜業者による保守点検事項＞

業者による保守点検を実施するときは、当社または当社の指定する業者、若しくは修理業者などの適切な資格者に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

タカラベルモント株式会社

TEL: 06-6212-3620

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。