2021年5月13日（新様式第2版）
適用規格更新による改訂

器具機械　18　血圧検査又は脈波検査用器具
アネロイド式血圧計

医療機器製造販売届出番号
13B3X10062000011

製品番号：500－CN（1～3）　　販売名称：　**アルプケイツー　小児用アネロイド血圧計（ナイロンカフタイプ）**　　一般医療機器 JMDN：16156000

日本製

【形状・構造等】　＊右図参照

・メーター本体：亜鉛ダイキャスト
　直径53mm×全長74　mm
　前面はアクリルカバー

・スケール板：20　～　300mmHg
　白地に黒目盛プリント
　20mmHg毎に数値表示
　（80　～　160赤色表示）
＊中央下部にシリアルナンバー刻印

・ゴム球：ラテックス
　加圧・減圧　部品

・エンドバルブ（逆止弁）：ブラス
・コントロールバルブ：ブラス

・腕帯：ナイロン　及び　マジックテープ
　サイズ：下表参照

・ゴム袋：ラテックス（腕帯に内蔵）
　サイズ：下表参照

＊小児用腕帯のサイズ

腕帯サイズ	ゴム袋サイズ	製品番号
5．5×18．5cm	3．9×　8．1cm	500－CN1
7．5×26．5cm	5．5×11．4cm	500－CN2
11．0×35．5cm	7．8×16．5cm	500－CN3

・ケース：ビニールレザー製、チャック付

【性能・使用目的】

1．性能　　・測定範囲：20　～　300　mmHg

・測定精度：±3　mmHg

・減圧率　：2　～　3mmHg／秒　可能

＊JIS　T 4203：2012　に　適合

2．使用目的
　非観血式聴診法による人体血圧の測定（小児用）

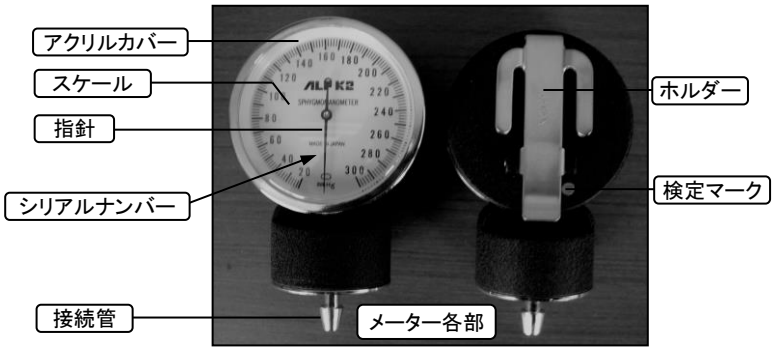

【使用方法】

1．腕帯内蔵のゴム袋チューブをメーターの接続管に接続する。

2．ゴム袋の一方のチューブとゴム球のコントロールバルブを接続する。

3．腕帯を上腕に巻きつけマジックテープでとめる。

4．コントロールバルブを右に廻して締める。

5．ゴム球をポンプ操作して加圧する。

6．コントロールバルブをゆるめて少しずつ減圧する。

7．聴診器でコロトコフ音を聞き取り、最高・最低血圧を測定する。
　（本器に聴診器は含まれていません）

【使用上の注意】

1．メーターは衝撃に弱い精密機器です。

　場合によっては精度に誤差が生じますので、測定の際は
　落としたり、ぶつけたりしないよう充分に気をつけてください。

2．300mmHg　以上の圧力はかけないでください。

3．付属品の腕帯は小児用標準品です。

　正確な測定のために腕帯は対象者および測定部位に合わせて
　新生児用、大人用　など適切な選択をしてください。

4．この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ、発疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状を起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。

【取り扱い上の注意】

1．本器は血圧測定以外の目的には使用しないで下さい。

2．精密測定機器ですので乱暴な取り扱いはしないでください。

3．メーター保護のために、使用後はメーターを腕帯でくるんで
　付属のケースに収納し保管してください。

4．アクリルカバーをはずして指針をさわる等の分解はしないでください。

【保守・点検等】

1．保管は高温・多湿・直射日光を避け、常温で適切な管理をしてください。

2．測定器ですので定期的に点検を行い、精度と安全性を保ってください。

3．腕帯・ゴム球は繰り返し使用され、また人体に接触する付属品です。
　汚れた腕帯は洗浄する等、衛生上の管理をお願いします。

4．ゴム部品は、長期間使用すると劣化（亀裂など）を起こします。
　劣化したゴム部品は交換してください。

5．他社部品の使用は事故・トラブルの原因となる場合があります。
　修理や部品の交換等は、当社純正部品を使用してください。

6．本製品の耐用年数は 3年 です。（自己認証）

【製造業者／製造販売業者】
田中産業株式会社　　東京都荒川区荒川 6－26－5
TEL：03－3892－4481　FAX：03－3892－4450

【アフターサービス等の問合せ先】
田中産業株式会社　　東京都文京区本郷 3－16－3
TEL：03－3814－7181　FAX：03－3814－7177