

機械器具55 医療用洗浄器  
一般医療機器 洗浄針 70459000


## ボトルチップス

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止


#### 【形状・構造及び原理等】

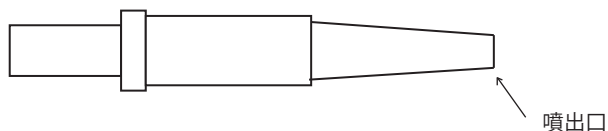

#### 【使用目的又は効果】

- ・生理食塩液等の容器と接合し、皮膚、創傷面、粘膜の洗浄及び医療器具の洗浄時に噴出口として使用する。

#### 【使用方法等】

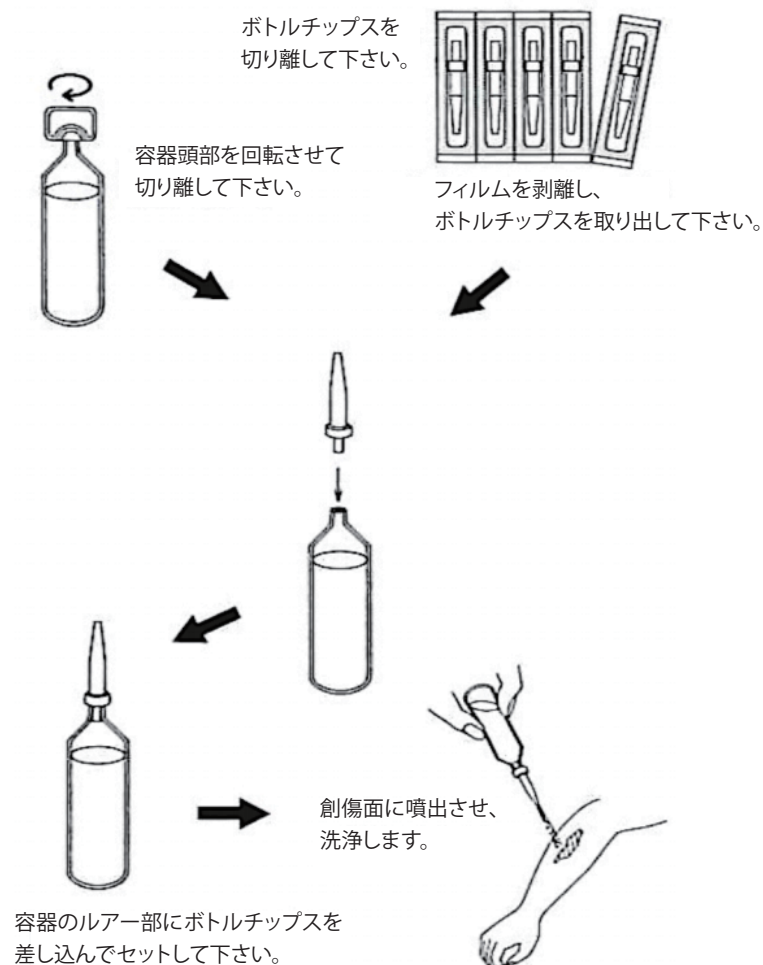

#### 【使用上の注意】

- 1.重要な基本的注意
  - ・使用後は安全な方法で処分すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 1.保管方法
  - ・水ぬれに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて保管してください。
- 2.使用期間
  - ・箱の使用期限欄を参照してください。(自己認証(当社データ)による)

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : エア・ウォーター・リアライズ株式会社  
茨城県笠間市長兎路1320番地5  
電話番号 0296-77-8649  
製造業者 : エア・ウォーター・リアライズ株式会社

#### ＜製品に関する問い合わせ＞

エア・ウォーター・リアライズ株式会社  
フリーダイヤル:0120-305-765  
(受付時間:平日午前9時～午後5時)