

2010年1月28日（第1版）

届出番号 09B1X00003000027

機械器具 09 医療用エックス線装置及び医療用エックス線装置用エックス線管

一般 X線平面検出器 JMDN 70029000

特 管 X線平面検出器 TFP-800B

【形状・構造及び原理等】


1. 構成

- (1) 基本構成
 - <1> 本体
 - <2> コマンドプロセッサ


詳細は、装置付属の取扱説明書（2B305-820JA）を参照してください。

2. 各部の名称

- (1) 本体

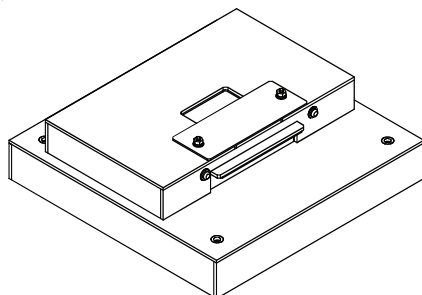

- (2) コマンドプロセッサ

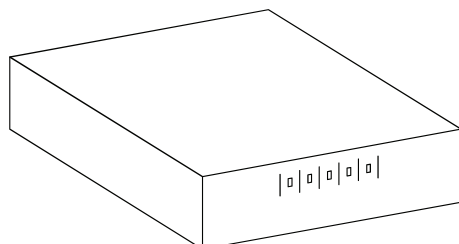

3. 電気定格

- (1) 電源
 - <1> 定格電圧 : 単相交流 200V
 - <2> 電源周波数 : 50/60Hz
 - <3> 消費電力 : 660VA
- (2) 電撃に対する保護の形式による分類 : クラス I 機器
- (3) EMC 規格 : IEC60601-1-2:2001+Amd. 1:2004 に適合している

4. 本体寸法

- (1) 基本構成（寸法：mm）
 - <1> 本体
 - 250（幅）、74（高さ）、250（奥行）
 - <2> コマンドプロセッサ
 - 280（幅）、77（高さ）、260（奥行）

5. 作動・動作原理

X線平面検出器本体に入射したX線は、シンチレータ部で蛍光作用により光の強弱に変換され、フォトダイオード・TFT（Thin Film Transistor）アレイ部で電荷の大小に変換された後、画素ごとに蓄積される。TFTスイッチの選択信号に応じて、順次読み出された画素ごとの電荷は、電圧信号処理部にて電圧信号に変換・増幅・デジタル化された後、コマンドプロセッサに送られて、画像信号となり、画像補正処理された後、据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置に出力される。

【使用目的、効能又は効果】

人体を透過したX線を検出して電気信号に変換し、得られた電気信号を画像処理装置に出力すること。

【品目仕様等】

- <1> 解像度 : 2.6Lp/mm
- <2> 出力画像フォーマット
 - ・非画素加算全視野読出しモード時
 - 1024 画素×1024 画素
 - 最大駆動レート : 30 フレーム/秒
 - ・画素加算全視野読出しモード時
 - 512 画素×512 画素
 - 最大駆動レート : 60 フレーム/秒
- <3> ノイズ（DQE） : 65%以上（0Lp/mm）

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用環境条件

- (1) 周囲温度 : 15 ～ 30℃
- (2) 相対湿度 : 35 ～ 70%（結露しないこと）
- (3) 気圧 : 700 ～ 1060hPa

2. 設置上の注意

当社営業担当に確認してください。

3. 操作方法

- (1) 電源投入
 - <1> 組合せ可能な医療機器の電源 ON スイッチを押すと、これと連動して本装置への電源供給が行われます。
 - <2> 組合せ可能な医療機器により、透視・撮影可能になったことを確認します。
- (2) 透視・撮影
 - <1> 組合せ可能な医療機器により、透視・撮影を行います。
 - <2> 組合せ可能な医療機器により、透視・撮影画像を確認します。
- (3) 電源遮断
 - <1> 組合せ可能な医療機器のシャットダウン操作を行うと、本装置の電源が自動的に遮断されます。
 - <2> 緊急時に、組合せ可能な医療機器の電源 OFF スイッチを押すと、本装置の電源が瞬時に遮断されます。

取扱説明書（2B305-820JA）に従って操作してください。

取扱説明書は、使用前に必ずお読みください。

4. 本システムに組合せ可能な医療機器等

- (1) 販売名 : X線循環器診断システム Infinix Celeve-i
INFX-8000F
- 認証番号 : 218ACBZX00003000
- 製造販売業者 : 東芝メディカルシステムズ株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- (1) この装置は防爆形ではないので、装置の近くで可燃性および爆発性気体を使用しないこと。
- (2) この装置の本体は、据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置に内蔵して使用すること。

＜相互作用＞

- (1) 装置に影響を及ぼすおそれがあるため、検査室および操作室内で、携帯電話など電磁波を発生する機器を使用しないこと。
- (2) 指定された機器以外の装置を接続した場合、所定の EMC 性能を発揮できないおそれがあるので指定機器以外は接続しないこと。

＜その他の注意＞

- (1) この装置を廃棄する場合は産業廃棄物となる。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄処分業者に廃棄を依頼すること。

この他にも本装置を使用するに当たっての注意事項が、取扱説明書の冒頭にピンクや黄色で色分けされたページにまとめて記載しておりますので、装置を使用する前に必ずお読みください。
取扱説明書（2B305-820JA）

「安全上の注意」、「使用・管理に関する重要情報」、「保証について」、「免責事項について」

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 輸送及び保管条件

- (1) 周囲温度 : -10 ～ 60℃
- (2) 相対湿度 : 30 ～ 80%（結露状態は除く）
- (3) 気圧 : 500 ～ 1060hPa

2. 耐用期間

指定された保守点検を実施した場合に 10 年です。

[自己認証（当社データ）による]

（ただし、耐用期間は使用状態により変化するため、個別に定める場合はこれを優先します。）

装置を構成する部品の中にはモデルチェンジの周期が短い一般市販部品があり、耐用期間内であってもサービスパーツを供給できなくなる場合があります。

【保守・点検に係る事項】

保守点検には、「使用者による保守点検」および「業者による保守点検」があります。

1. 使用者による保守点検

「始業点検」と「終業点検」を実施してください。

詳細は、取扱説明書（2B305-820JA）を参照してください。

2. 業者による保守点検

定期点検を行ってください。

サービスエンジニアが行う点検です。

詳細は、取扱説明書（2B305-820JA）を参照してください。

【包装】

- 1 台単位で包装する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

東芝メディカルシステムズ株式会社

住所：〒324-8550

栃木県大田原市下石上 1385 番地

ご連絡は当社 品質環境保証部 にお問い合わせ致します。

TEL：0287-26-6304（ダイヤルイン）

休日・夜間 お客様コール受付窓口

東芝メディカルコールセンタ

お客様専用フリーダイヤル：0120-1048-01

開設時間：

営業日 17:30 ～ 翌日 9:00

休業日 9:00 ～ 翌日 9:00

製造業者

東芝メディカルシステムズ株式会社

最寄りのサービスセンタ