**2010年6月9日（第4版）
*2008年3月12日（第3版）
承認番号　21500BZZ00563000


機械器具10　放射性物質診療用器具
管理　核医学装置ワークステーション　JMDN　40937000

特管　医用画像処理装置　ＧＭＳ－７７００Ａ

【形状・構造及び原理等】

1. 構成
(1) 標準構成
1) オペレータコンソール
・CPU-BOX
・21 型（21 インチ）モニタ
・キーボード
・マウス
2) 基本ソフトウエアパッケージ
3) 付属品
(2) オプション
1) データ記録装置
2) 液晶モニタ
3) オプションソフトウエア
＊詳細は、装置付属の取扱説明書 2B010-361J を参照してください。

2. 各部の名称

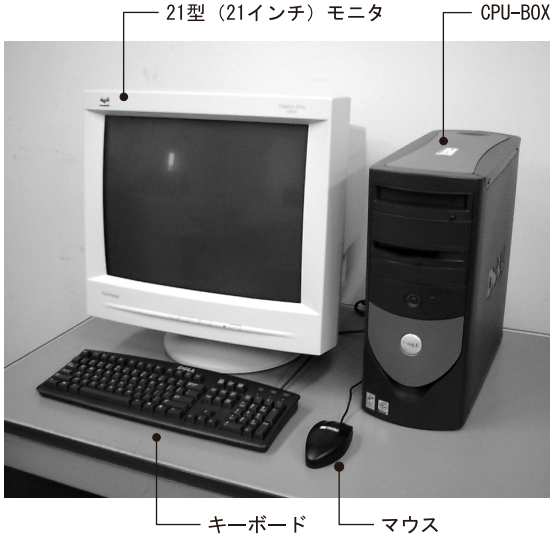

3. 電気定格
(1) 電源定格
1) 電源電圧　　単相100V
2) 周波数　　47Hz ～ 63Hz
3) 電源容量　　0.55kVA
(2) 保護の形式　：クラスI　据置形機器
(3) 保護の程度　：B 形
本装置には装着部はありません。
(4) 接地条件
Ｄ種接地以上の接地が必要

4. 本体寸法及び質量
(1) CPU-BOX
寸法　：　181mm（W）×425mm（H）×447mm（D）
質量　：　14kg
(2) 21 型（21インチ）モニタ
寸法　：　500mm（W）×507mm（H）×488mm（D）
質量　：　23kg

**5. 作動・動作原理
核医学装置等で収集された被検者の画像や情報をさらに処理したうえで表示します。

**【使用目的、効能又は効果】
被検者の病態に係わる判断、評価または診断を行うための画像や情報を提供します。

**【品目仕様等】
主記憶容量　　：　1GB 以上
磁気ディスク容量　：　80GB 以上

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用環境条件
(1) 定常時発熱量　：　約 120W（約 103kcal/h、約 432kJ/h）
(2) 周囲温度　　：　15.5℃～35℃
(3) 周囲湿度　　：　15％～80％（結露のないこと）

**2. 使用方法
本装置の操作の仕方は、下記項目に従って取扱説明書に記載されています。装置を使用する前に必ずお読みください。
(1) 電源の投入遮断
(2) 操作方法

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞
1. 装置に水や洗剤などの液体をかけたり噴霧しないこと。
2. e.soft ソフトウエアを終了させると、現在のワークフローアクティビティはすべて停止してプログラムが閉じるため、保存していないデータはすべて失なわれる。
3. オペレータコンソール部は移動させないこと。機器間ケーブルの破損や機器の落下、システムダウン、データが破損するおそれがある。

＜不具合・有害事象＞
1. 重大な不具合・有害事象
(1) キーボードを繰返し長時間使用しないこと。手や腕などに神経障害を生じるおそれがある。

取扱説明書を必ずご参照ください。

＜その他の注意＞

1. 消毒剤を使用する場合は、消毒剤の取扱説明書の指示どおり行うこと。

この他にもこの装置を使用するに当たっての注意事項が取扱説明書に記載してあります。使用前に必ずお読みください。

取扱説明書

・「安全上の注意」

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 耐用期間［自己認証（当社データ）による］

指定された保守点検を実施した場合に 6 年です。

（ただし、使用状態により差異があるため個別に定める場合はこれを優先します。）

また、装置を構成する部品の中には一般市販部品があり、製品のモデルチェンジが速く、耐用期間内であってもサービスパーツを供給できなくなる場合もあります。（例えば OA 関連機器など）

【保守・点検に係る事項】

保守点検には、日常点検、定期点検があります。

1. **日常点検**

お客様に行っていただく点検です。

詳しくは装置の取扱説明書 2B010-361J の「日常点検」を参照願います。

2. **定期点検**

定期点検（サービスエンジニアが行う点検）があります。

詳しくは装置の取扱説明書 2B010-361J の「定期点検」を参照願います。

3. **定期交換部品と消耗部品**

特にありません。

【包装】

1 台単位で梱包します。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 東芝メディカルシステムズ株式会社 住所：〒324-8550 栃木県大田原市下石上 1385 番地 ご連絡は当社　品質環境保証部　にお願い致します。 ＴＥＬ：0287-26-6304（ダイヤルイン）
休日・夜間　お客様コール受付窓口 東芝メディカルコールセンタ お客様専用フリーダイヤル：0120-1048-01 開設時間： 営業日　17：30 ～ 翌日　9：00 休業日　9：00 ～ 翌日　9：00
製造業者 東芝メディカルシステムズ株式会社
最寄りのサービスセンタ

取扱説明書を必ずご参照ください。