

足すっきり フィットアート

【警告】

1. 適用対象(次の患者に使用する際は、特に注意すること)

- 1) 深部静脈血栓症があり、本品を着用することによって肺血栓症を起こすおそれのある患者。
- 2) 動脈血行障害、うっ血性心不全及び着用部位に炎症性疾患、化膿性疾患、創傷のある患者。
[圧迫により症状が悪化するおそれがあるため。]
- 3) 着用部位に神経障害のある患者。
[血行障害を起こしても認識できないおそれがあるため。]
- 4) 糖尿病患者。
[無症状の神経障害や血行障害を併発している可能性があり、痛み等の異常を認識できないおそれがあるため。]
- 5) 繊維に対して過敏症のある患者。
[接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため。]

2. 使用方法

医師が必要と認める場合を除き、就寝時は着用しないこと。
[臥位になることで静脈還流等に変化が起こり、患者によっては必要以上の圧迫圧がかかるおそれがあるため。]

【禁忌・禁止】(次の患者には使用しないこと)

- 1) 重度の動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の者。
[圧迫により症状を悪化させる危険性が高いため。]
- 2) 感染性静脈炎の患者。
[菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがあるため。]
- 3) 着用部位に極度の変形を有する患者。
[適切な圧迫圧が得られないため。]

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構成

本品はひざ下から足の甲までを覆うゲイター型の弾性ストッキングで、S、M、L、LL の 4 サイズがあります。

2. 寸法

(単位：cm)

適応サイズ	S	M	L	LL
① 足首周囲	18 ～ 20	20 ～ 22	21 ～ 24	23 ～ 26
② ふくらはぎ最大周囲	29 ～ 33	31 ～ 35	34 ～ 38	37 ～ 41

※ 計測位置

- ① 足首周囲
足首で最も細い位置
- ② ふくらはぎ最大周囲
ふくらはぎで最も太い位置

3. 組成

ナイロン、ポリウレタン


4. 原理

本品は、多段階の伸縮性により下肢の足首からふくらはぎにかけて漸減的な圧迫を加える機能を有します。

5. 圧迫圧

部位	圧迫圧
① 足首	26 hPa (20 mmHg)
② ふくらはぎ	20 hPa (15 mmHg)

※ 標準サイズの人が着用したときの平均圧迫圧。計測位置は、①足首の最も細い位置、②ふくらはぎの最も太い位置。

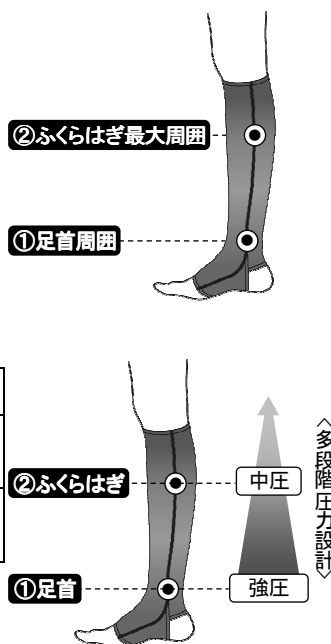

【使用目的又は効果】

下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有しています。


【使用方法等】

1. 適応サイズの選定


メジャー等で足首、ふくらはぎの周長を測定し、正しいサイズを選択してください。部位によって該当サイズが一致しない場合は、大きい方のサイズを選択してください。

2. 着用方法

- 1) 本品をたぐりよせてつま先を入れます。




- 2) 足首まで引き上げ、かかとの位置を正確に合わせます。



- 3) 両手の親指を内側に入れて、しわができないように少しずつひざ下まで引き上げます。
このとき、左右の縫目がねじれなく、まっすぐになるよう調整してください。



- 4) 最後に、土踏まずにかかる後端部分が下記のようにまっすぐに着用されているか確認してください。
足の甲や土踏まずに違和感がある場合は、着用位置がずれている可能性がありますので、正しく着用し直してください。

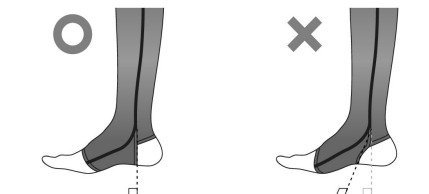

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

- 1) 本品の使用により、脚に疼痛、しびれ、皮膚や爪の変色、皮膚温の低下、かゆみ、発疹、かぶれ等の異常及びその他着用前に感じなかった不快感、違和感が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。

〔動脈及び静脈の血行障害又は神経障害等を発症するおそれがあるため。〕

- 2) ギプス、外傷等により着用部位が長時間不動状態にあった患者
〔潜在的に深部静脈血栓症を発症している可能性があるため。〕

2. 重要な基本的注意

- 1) 本品は弾性ストッキングに精通した者が、着用者に使用方法を説明し、正しい着用手順で使用を開始してください。
- 2) 適正な圧迫圧を得るため、着用部位の規定箇所を必ず計測し、正しいサイズを選択してください。また、サイズ適応外の場合には、本品を使用しないでください。
- 3) 本品に破損(伝線、ほつれ、破れ等)がないことを確認してから着用してください。破損がある場合には、適正な圧迫圧が得られないため使用しないでください。
- 4) 圧迫圧の過不足を防ぐため、たるみやしわのないように本品を着用してください。着用中にたるんだり、しわが寄ったり、ずり落ちたり、誤った位置に着用されている場合には、正しく着用し直してください。
- 5) 1 日数回、皮膚や爪の色に変化がないか確認してください。また、足全体の観察を実施するため、少なくとも1日1回は必ず履き直しを行ってください。
〔血行障害や神経障害等を引き起こすおそれがあるため。〕
- 6) 腫脹の軽減等により着用中に各部位の周長が変わった場合は、適切なサイズに変更してください。
- 7) 本品を折り返して使用しないでください。また、本品を2枚重ねて着用しないでください。
- 8) 本品をはさみで切るなどの加工、修理を行わないでください。
- 9) 本品は繊維製品のため、次のような場合には破損(伝線、ほつれ、破れ等)することがありますので注意してください。
 - ① 少しずつ引き上げず、強く引っ張り上げての着用
 - ② 爪が伸びていたり、反っていたりする足への着用
 - ③ 肌荒れした手や伸びた指の爪での取り扱い
 - ④ 鋭利なものへの接触
 - ⑤ 指輪、ブレスレットをつけたままでの着用
- 10) 軟膏等の薬品や油脂、溶剤等が付着すると繊維が劣化しますので、付着しないよう注意してください。
- 11) 本品は個人用の製品であり、他人への使い回しはしないでください。
- 12) 本品の他に圧迫圧のあるストッキング等を重ねて着用したり、他の圧迫療法と併用したりする場合には、必ず事前に医師へご相談ください。

3. 有害事象

本品の使用により、以下の有害事象が起こる可能性があります。

1) 重大な有害事象

① 血行障害

チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等、血行障害が現れた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

② 神経障害

腓骨神経麻痺等の神経障害が現れた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

③ 皮膚障害

本品のずれ、圧迫等により皮膚潰瘍等の皮膚障害が現れた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

ショック等、末梢循環が不安定な患者に使用した場合には、着用部位に血行障害が発生し、壊疽などの皮膚障害が起こる可能性があるため、着用部位の血流に注意してください。

2) その他の有害事象

本品着用部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれ等の皮膚障害が現れた場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を行ってください。

本品を脱いだ後で皮膚障害が現れる場合もありますので、同様に適切な処置を行ってください。また、足首等に着用の跡が残る場合があります。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び高温多湿を避け、室温下で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

*洗濯時の注意

- 1) 中性洗剤を使用し、水又はぬるま湯で軽く押し洗いしてください。
- 2) 漂白剤や蛍光増白剤入り洗剤は使用しないでください。
- 3) 乾燥機、アイロンの使用は控えください。
- 4) 濃色の製品につき色落ちすることがあります。白色や淡色のものと一緒に洗ったり、濡れたまま長時間放置したりしないでください。
- 5) 汗をかいたままの状態では長時間着用すると、変色したり、他の物や肌に色が移ったりする場合がありますので、注意してください。
- 6) その他の取り扱い方法は洗濯絵表示に従ってください。

【包装】

3 着単位

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

名称：株式会社ナウ

住所：石川県金沢市いなほ1丁目12番地

電話：0120-74-1600

製造業者

名称：株式会社ランブール

住所：富山県小矢部市名畑53番地の5

発売元



名称：株式会社ラッティークイーン

住所：〒955-0065

新潟県三条市旭町 1-7-20

電話：☎0120-97-0447