

機械器具(21) 内臓機能検査用器具

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003
(動脈圧心拍出量計 70050000)

ベッドサイドモニタ BSM-3000 シリーズ ライフスコープ VS (BSM-3532、BSM-3552、BSM-3562)

再使用禁止(ディスプレイのみ)

【禁忌・禁止】

1. 併用医療機器 [相互作用の項参照]

- (1) 磁気共鳴画像診断装置(MRI 装置) [誘導起電力により局所的な発熱で患者が熱傷を負うことがあります。]

2. 使用方法

- (1) 患者の状態を目視で常に確認できないときは、アラーム抑制機能を使用しないでください。[患者の急変に対応できません。]
(2) 再使用禁止(ディスプレイのみ)

【形状・構造及び原理等】

1. 品目の概要

本装置は、患者の近くに設置され、患者のバイタルサイン(心電図、血圧、体温、酸素飽和度など)を画面上に表示、アラームの発生を行うほか、無呼吸検出、不整脈のモニタリングを目的とします。また、各種ユニットやその他の外部機器との接続が可能です。さらに、ネットワークや送信機により複数の患者を同時に看護するためにナースステーションなどに設置された機器と患者データを通信することもできます。
なお、本装置は、接続する SpO₂ の種類により以下のとおり 3 種類あります。SpO₂ の種類が NK の場合には、オプションとして、比較的循環動態が安定している状態において脈波伝播時間を用いた非侵襲的な方法で連続心拍出量を提供することが可能です。


型 名	画面サイズ	SpO ₂ の種類	マルチパラメータコネクタ数
(1) BSM-3532	12.1 インチ	マシモ	2
(2) BSM-3552	12.1 インチ	ネルコア	
(3) BSM-3562	12.1 インチ	NK(アーチファクト対策版)	

2. 構成

名 称		個 数
(1) ベッドサイドモニタ本体		1
(2) レコーダモジュール	WS-371P	選択
(3) 送信機	ZS-900P	選択
(4) マルチガスユニット	AG-920R	選択
(5) CO ₂ ユニット	AG-400R	選択
(6) ニューロユニット	AE-918P	選択
(7) 付属品		一式

※ディスプレイ(付属品)は再使用禁止です。
※上記構成機器は、修理または補充などのため、単体で販売されることがあります。

3. 外観図

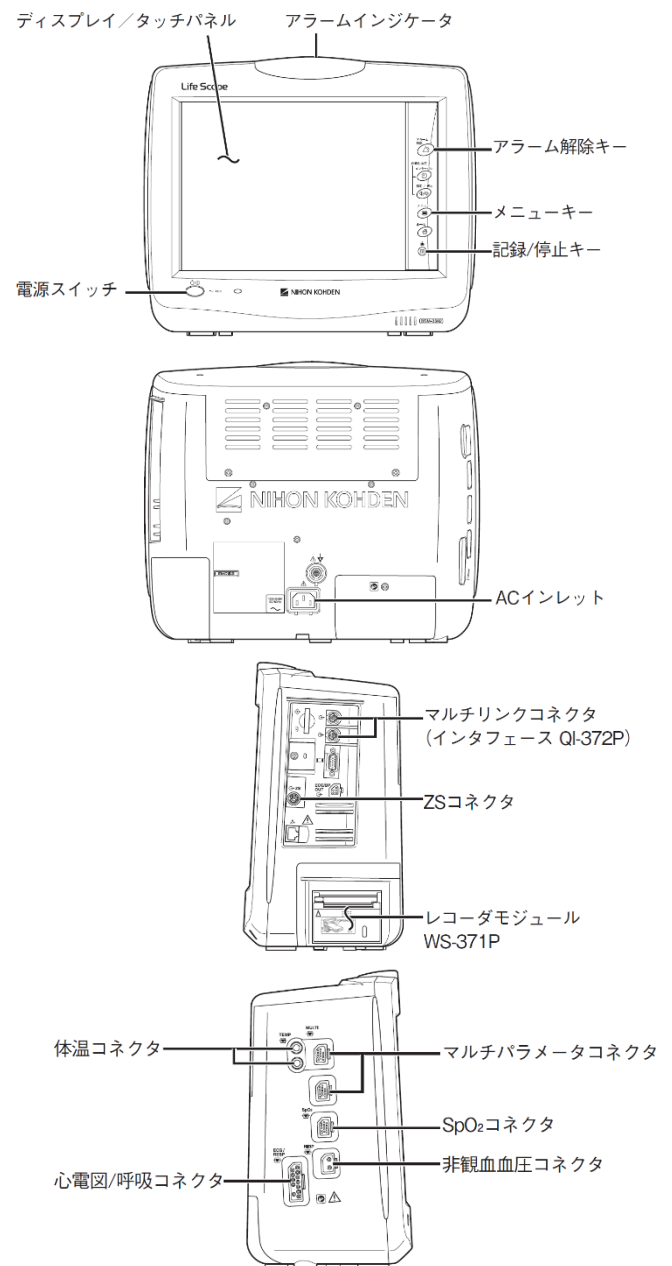

4. 動作原理

(1) 心電図

四肢、または四肢および胸部に貼り付けた電極から電極リード線を介して電極間の差動電圧を取り込み、増幅、演算して得た心電図を表示します。

1) 12誘導心電図解析所見出力機能について(オプション)

生体の四肢および胸部より、心電図電極により導出された心電図信号は、本装置の心電図アンプにより増幅された後、アナログ/デジタル変換され、画面表示されます。本体に内蔵のCPUにより、筋電図および基線動揺などの除去のためのフィルタ処理がされ、続いて、心電図解析処理は、まず波形を計測し、パターン分類を行った後、解析基準に基づいて、各種所見に分類します。

解析基準は、日本循環器管理研究協議会により改訂された、ミネソタコードをベースとした心電図判別基準に基づいています。処理後の心電図データ、計測値および心電図所見は画面に表示されます。

※12 誘導心電図解析所見出力機能は、ベッドサイドモニタに動作禁止状態でプリインストールしている同機能のプログラム(QP-031P)を、選択により動作禁止状態を解除することで有効となります。

(2) 呼吸(インピーダンス方式)

上記心電図測定のために使用している電極から呼吸測定電流を印加します。呼吸により生じた胸郭のインピーダンス変化は、この呼吸測定電流の変化となって現れます。この信号を増幅、演算して得た呼吸曲線を表示します。

(3) 非観血血圧

オシロメトリック法により、非観血的に動脈血圧を計測します。四肢に巻き付けたカフを徐々に加圧もしくは減圧していくと、カフ圧に動脈の脈動による振動(Oscillation)が重畳します。この振動はカフ圧の変化にしたがい徐々に大きくなり、最大振幅をとった後、小さくなる山形を示します。オシロメトリック法はこの振動の振幅と、そのときのカフ圧との関係から、非観血的に血圧値を算出します。

※加圧中の非観血血圧測定の機能は、本装置に付属品の iNIBP プログラム QP-038P を使用したときに有効となります。

(4) SpO₂(動脈血酸素飽和度)

酸化ヘモグロビン(O₂Hb)と還元ヘモグロビン(RHb)の吸光特性が異なることを利用したパルスオキシメトリ法にて測定を行います。具体的には指などの比較的厚みの薄い部分に赤色、赤外 2 つの波長の光を照射し、透過した光を電気信号に変換後、動脈の脈動に起因した脈波波形を得ます。この 2 波長の脈波波形の比から SpO₂ を算出します。使用可能なパルスオキシメータプローブは、当社が精度を保証するプローブのみを用います。

(5) 観血血圧

血管内に留置されたカテーテルから生理食塩水で満たされた延長管などで、圧力トランスデューサまで圧を導き、受圧膜に加えられた圧力に比例した出力電圧を増幅、演算して血圧値を算出します。

(6) 体温

温度プローブ先端に取り付けられたサーミスタの抵抗値を電圧に変換し、増幅、演算して体温を測定します。

(7) CO₂(メインストリーム方式・吸気補正式)

気管内チューブなどに接続されたエアウェイアダプタに取り付けられた CO₂ センサにより、呼気時の CO₂ ガスによる赤外線吸収量と、CO₂ を含まない吸気時の赤外線吸収量の比から呼気中の CO₂ 濃度を算出します。

(8) CO₂(メインストリーム方式・絶対値式)

気管内チューブなどに接続されたエアウェイアダプタに取り付けられた CO₂ センサにより、CO₂ ガスによる赤外線吸収量から CO₂ 濃度を算出します。

(9) CO(心拍出量・熱希釈法)

右房に冷水を注入し、右室で混和された後の血液の温度変化をカテーテル先端のサーミスタで測定し、温度変化曲線(熱希釈曲線)を描きます。この曲線下の面積から心拍出量を測定します。

(10) 心拍出量(esCCO)

測定原理として、ウィンドケッセルモデルによるパルスカンター法を採用し、比較的循環動態が安定している状態において、心電図 R 波から SpO₂ 光電脈波の立ち上がりまでの時間(PWTT)を用いて推定連続心拍出量を算出します。

測定は 64 拍移動平均(心拍数: 64 のとき 1 分平均)で行われ、表示は 3 秒間隔です。

(11) CO₂、N₂O、揮発性麻酔薬

(サイドストリーム方式・マルチガスユニット(AG-920R))

気管内チューブなどに取り付けられたサンプリングチューブにより、呼吸回路から患者が呼吸するガスの一部を持続的に吸引し、吸引したガス内の CO₂、N₂O、揮発性麻酔薬が特定の波長の赤外線吸収する性質を利用し、特定の波長の赤外線を測定ガスに照射し、透過光を赤外線検出器で検出することで各ガス濃度を測定します。計測値はプロトコル変換インタフェースを用いて本装置に表示します。

(12) O₂(サイドストリーム方式・マルチガスユニット(AG-920R))

気管内チューブなどに取り付けられたサンプリングチューブにより、呼吸回路から患者が呼吸するガスの一部を持続的に吸引し、O₂ ガスが常磁性を示すという性質を利用し、磁界内にあるリファレンスセル内のガスと吸引したガス内の O₂ 濃度の差によってリファレンスセルの位置が変位し、その位置を光学的に検出することで O₂ 濃度を測定します。計測値はプロトコル変換インタフェースを用いて本装置に表示します。

(13) CO₂(サイドストリーム方式・CO₂ ユニット(AG-400R))

気管内チューブなどに取り付けられたサンプリングチューブにより、呼吸回路から患者が呼吸するガスの一部を持続的に吸引し、吸引したガス内の CO₂ が特定の波長の赤外線を吸収する性質を利用し、特定の波長の赤外線を測定ガスに照射し、透過光を赤外線検出器で検出することで各ガス濃度を測定します。計測値はプロトコル変換インタフェースを用いて本装置に表示します。

(14) 生体情報の送信

特定小電力無線局医療用テレメータ用無線設備区分 A の標準規格に基づき、420.0500MHz から 449.6625MHz の周波数、電波型式 F7D、水晶発振により制御する周波数シンセサイザ方式、2 値 FSK 変調方式により生体情報をアンテナ(アンテナ利得 2.14dBi 以下)を介して単向通信方式で送信を行います。

(15) 不整脈解析

不整脈解析は、患者から導出される心電図情報から正常 QRS 波の学習を行い、これを基準波形として、それ以降の心電図から検出される QRS 波を、基準波形と異形性の程度、および RR 間隔を判断して、心室性期外収縮(VPC)を求めます。(マルチテンプレートマッチング方式により検出を行います。)最大 2 チャネルの心電図誘導で解析を行います。

(16) アラーム機能

アラーム発生時、下記のアラーム状態になります。

1) 各測定パラメータの測定値が、予め設定した上限や下限に達するかこれを超えた時、以下の状態となります。

- ① アラームが発生したパラメータの数値データが反転およびメッセージが表示されます。
- ② アラーム音が発生します。
- ③ 発生したアラームの分類により、メッセージ表示の色およびアラームインジケータの表示色が異なります。
 - ・緊急アラーム(患者や機器に対し緊急に処置しなければならない場合のアラーム)発生時アラームインジケータは“赤”の点滅。
 - ・警戒アラーム(患者や機器に対し敏速な処置を要求する場合のアラーム)発生時アラームインジケータは“黄”の点滅。
 - ・注意アラーム(正確な計測、治療条件から外れている場合のアラーム)発生時アラームインジケータは“青”または“黄”の点灯。

なお、緊急アラーム、警戒アラーム、注意アラームの設定は、使用者のうち管理者のみが行います。

2) 各心電図で、予め設定した項目の不整脈を検出した時、画面に不整脈メッセージの表示と、アラーム(アラーム音発音、ランプ点灯など)が発生します。

(17) 脳波(AE-918P)

頭部に貼り付けた電極から電極リード線を介して電極間の差動電圧を取り込み、増幅、演算して得た脳波波形を表示します。

5. 原材料

本装置の構成品/付属品のうち、被検者への接触部位(健康皮膚接触)をもつ原材料について、以下に記載します。

品 名	原材料
幼児用カフ YP-710T	外袋：ポリエステル
小児用カフ YP-711T	
成人用カフ(小) YP-712T	
成人用カフ(標準) YP-713T	
成人用カフ(大) YP-714T	
大腿部用カフ YP-715T	
Q ロック SF 幼児用カフ YP-960T	外袋：ナイロン
Q ロック SF 小児用カフ(小) YP-961T	
Q ロック SF 小児用カフ(標準) YP-962T	
Q ロック SF 成人用カフ(標準) YP-963T	
Q ロック SF 成人用カフ(大) YP-964T	
Q ロック SF 大腿部用カフ YP-965T	
幼児用ディスボカフ YP-810P	カフ：塩化ビニル樹脂
小児用ディスボカフ YP-811P	
成人用ディスボカフ (小) YP-812P	
成人用ディスボカフ (標準) YP-813P	
成人用ディスボカフ (長) YP-814P	
成人用ディスボカフ (大) YP-815P	
成人用ディスボカフ (特大) YP-816P	本体：塩化ビニル樹脂
大腿部用ディスボカフ YP-817P	
新生児用ディスボカフ #820S YP-820S	
新生児用ディスボカフ #821S YP-821S	
新生児用ディスボカフ #822S YP-822S	
新生児用ディスボカフ #823S YP-823S	
新生児用ディスボカフ #824S YP-824S	本体：ポリウレタン
新生児用ディスボカフ #830S YP-830S	
新生児用ディスボカフ #831S YP-831S	
新生児用ディスボカフ #832S YP-832S	
新生児用ディスボカフ #833S YP-833S	
新生児用ディスボカフ #834S YP-834S	
幼児用ディスボカフ YP-840T	本体：PVC
小児用ディスボカフ YP-841T	
成人用ディスボカフ (小) YP-842T	
成人用ディスボカフ (標準) YP-843T	
成人用ディスボカフ (大) YP-844T	
大腿部用ディスボカフ YP-845T	

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本装置は、患者の近くに設置され、患者のバイタルサイン(心電図、血圧、体温、酸素飽和度など)を画面上に表示、アラームの発生を行うほか、無呼吸検出、不整脈のモニタリングが可能です。病院の手術室、回復室、一般病棟、ICU、CCU、HCU、NICU、救急外来などおよび一般開業医において使われます。その他、バッテリー動作も可能なので院内外搬送用としても用いられます。比較的循環動態が安定している状態において脈波伝播時間を用いた非侵襲的な方法で連続心拍出量を提供します。

2. 使用目的又は効果に関連する使用上の注意

- (1) 心拍出量(esCCO)が短時間で急激に変化したときに、他の心拍出量計と値がかい離する可能性があります。短時間で心拍出量(esCCO)が急激に変化したときは、血圧値、心拍数など他のバイタルサインの値を組み合わせる臨床的判断を行ってください。

【使用方法等】

1. 使用方法

(1) 各ユニットの接続

- * 1) 送信機の接続
送信機をベッドサイドモニタ本体の ZS コネクタと接続します。本装置では、付属品「送信機 ZS-900P」または「送信機 ZS-600P」(認証番号：231ADBZX00009000)を接続できます。
- 2) プロトコル変換インタフェース QF-801P/QF-802P/QF-901P/QF-902P/QF-903P/QF-904P/QF-905P/QF-907P/QF-908P/QF-909P の接続(オプションの QI-372P/QI-373P 装着時)
プロトコル変換インタフェースのマルチリンクケーブルをベッドサイドモニタ本体またはベッドサイドモニタ本体に差し込まれているインタフェース QI-372P/QI-373P のマルチリンクコネクタに接続します。プロトコル変換インタフェースのインタフェースコネクタを、外部機器に接続します。選択したプロトコル変換インタフェースにより、接続できる外部機器は、下表のとおりです。

プロトコル変換 インタフェース	外部機器
① GF-801P	Oridion 社 MicroPod
② GF-802P	Covidien 社 INVOS SPS
③ GF-901P	Drager 社 人工呼吸器
④ GF-902P	Covidien 社 BIS モニタ
⑤ GF-903P	Edwards 社 CCO モニタ
⑥ GF-904P	AG-920R
⑦ GF-905P	AG-400R
⑧ GF-907P	Puritan Bennett 人工呼吸器
⑨ GF-908P	MAQUET 社 人工呼吸器
⑩ GF-909P	MSD 株式会社 筋弛緩モニタ

(2) 電源の投入

各ユニットの接続を確認した後、ベッドサイドモニタ本体の AC インレットに、電源コードを接続し、商用コンセントに接続します。ベッドサイドモニタ本体の電源スイッチを入れます。自動的にセルフチェック動作を行った後、通常波形画面(リアルタイムモニタリング画面)が表示されます。

(3) 画面操作

操作は、ディスプレイのタッチパネルで行います。画面に表示されたキーに、タッチすることで、操作をすることができます。また、リモートコントローラを用いて、画面操作を行うことができます。

1) 画面の種類

各画面は必要に応じ、タッチパネルの操作で呼び出すことができます。

- ① リアルタイムモニタリング画面
全計測値、全波形、ショートトレンド、患者情報、時刻、各種アラーム、メッセージなどが表示されます。各計測画面をタッチすることによりパラメータ測定画面に移行できます。
- ② メニュー画面
メニューキーをタッチすることにより、メニュー画面に移行します。メニュー画面には、各画面選択キーが配置されており、キーをタッチすることにより、各画面へ移行します。
- ③ パラメータ測定画面
各パラメータのアラームやモニタリング設定を行う画面です。
- ④ レビュー画面
リストデータなどの患者データを表示し、患者の状態または患者の状態変化を見ることができる画面です。
- ⑤ セットアップ画面
各種、装置の設定を行う画面です。
- ⑥ 患者管理画面
患者の属性に関する設定、各パラメータに対するアラーム設定を行う画面です。
- ⑦ インターベッド画面
他のベッドの患者情報を表示する画面です。
- ⑧ 計算・解析画面
ドラッグ計算などの各種計算および12誘導心電図解析を行う画面です。

(4) アラームについて

1) アラーム発生時の動作

アラームが発生すると、アラーム(アラーム音、ランプ点灯など)が発生します。

2) アラームの解除

アラーム発生時にアラーム解除キーを押すと、一定時間アラーム動作を抑制します。アラーム解除中に、他のアラームの発生または、当該アラームの再発生があった場合は、再びアラーム動作を行います。

3) アラーム中断

アラーム中断キーを押すと、一定時間アラーム動作を抑制します。

4) 全アラーム OFF(患者へのモニタリングが適切に行われている場合などに設定します。)

「全アラーム OFF」が表示され、アラームを抑制します。

(5) 記録(オプションのレコーダモジュール WS-371P 内蔵時)

記録/停止キーを押すことにより、レコーダモジュールで波形の記録を行います。記録中に、再度記録/停止キーを押すことにより記録は停止します。

(6) 心電図と呼吸(インピーダンス式)の精度

心電図の誘導方法は、3 電極を使う方法、6 電極を使う方法、10 電極を使う方法があります。3 電極では基本的な I、II、III 誘導のうちいずれかが測定可能です。6 電極では I、II、III、aVR、aVL、aVF、胸部 2 誘導が、10 電極では I、II、III、aVR、aVL、aVF、胸部 6 誘導が測定可能です。電極数は、自動的に認識され、測定可能な誘導が自動的に設定されます。心電図の表示感度切換、誘導切換、フィルタのオン・オフなどの設定は、パラメータ測定画面の中の ECG 画面で行います。また、インピーダンス呼吸に関わる設定は、パラメータ測定画面の中の Resp 画面で行います。呼吸は、心電図と同じ電極の R 電極・F 電極間、または R 電極・L 電極間のインピーダンス変化を検出する方法で測定します。

1) 測定方法

- ① 患者に電極を装着します。
- ② 電極リード線のコネクタを ECG 中継コードに表示通り差し込みます。
- ③ ECG 中継コードを、ベッドサイドモニタ本体の心電図/呼吸コネクタに接続します。

本装置で使用可能な電極には、以下の既届出品があります。

販売名	製造販売届出番号
① ディスポ電極 Bs ビトロード	13B1X00206000187
② ディスポ電極 C ビトロード	13B1X00206000188
③ ディスポ電極 G ビトロード	13B1X00206000192
④ ディスポ電極 J ビトロード	13B1X00206000193
⑤ ディスポ電極 K ビトロード	13B1X00206000207
⑥ ディスポ電極 L ビトロード	13B1X00206000157
⑦ ディスポ電極 M ビトロード	13B1X00206000200
⑧ ディスポ電極 F ビトロード	13B1X00206000189
⑨ ディスポ電極 V ビトロード	13B1X00206000154
⑩ ディスポ電極 D ビトロード	13B1X00206000199
⑪ ディスポ電極 N ビトロード	13B1X00206000201

2 電極による心電図の測定には下記の医用テレメータを用いることができます。

販売名	承認番号
① 医用テレメータ ZZ-100P	21400BZZ00246000

1) 測定方法

- ① ZZ-100P の送信機に電極を取り付けます。
- ② 患者に装着すると測定ができます。

(7) 観血血圧の測定

1) 測定方法

- ① 圧ラインを設定した後、血圧トランスデューサをベッドサイドモニタ本体のマルチパラメータコネクタに接続すると測定開始となり、血圧値と血圧波形が画面に表示されます。
- ② トランスデューサを患者の圧基準の高さに合わせ、三方コックを大気へ開放し、この状態でゼロ校正を行います。

- ③ 再び三方コックを血圧ライン側に戻すことにより、血圧の測定が可能となります。

本装置で使用可能な血圧トランスデューサは以下の既承認品・既認証品があります。

販売名	承認番号/認証番号
① 血圧トランスデューサ	16100BZY00035000
② 血圧モニタリング・キット	15800BZY00559000
③ モニタキット	20100BZZ01182000

(8) 体温の測定

体温プローブを患者に装着し、体温プローブをベッドサイドモニタ本体の体温コネクタに接続すると測定開始となります。体温差(ΔT)を測定する場合は、体温プローブを患者の任意の箇所(2 つ装着し、ベッドサイドモニタの本体の体温コネクタに接続した後、ラベル(測定部位)を選択すると測定開始となります。本装置で使用可能な体温プローブには、以下の既承認品などがあります。

販売名	承認番号/認証番号 /製造販売届出番号
① サーミスタ温度プローブ	20200BZZ00551000
② 表面型サーミスタ温度プローブ	13B2X00125000001
③ 温度モニターカテーテル	20100BZY00111000
④ 温度モニターセンサー	20200BZY01084000
⑤ 温度センサー付フォーリーカテーテル	20300BZY00849000
* ⑥ リューザル体温プローブ	303ADBZX00029000
* ⑦ リューザル体表温度プローブ	13B1X00206000375

(9) 心拍出量の測定

1) 測定方法

- ① カテーテルを CO 中継コードを介してベッドサイドモニタ本体のマルチパラメータコネクタに接続します。
- ② Tb 側にカテーテルを、Ti 側にバスプローブかインラインセンサを接続します。
- ③ 画面の CO 画面を選択し、カテーテルサイズと注入量、またはカテーテル係数を確認します。
- ④ CO スタートキーを押した後、注入を行うことにより、CO 測定が開始され、計測結果が表示されます。

本装置で使用可能なカテーテルは以下の既承認品があります。

販売名	承認番号
① ポリウレタン製サーモダイリユーシオン・カテーテル	20200BZY00247000
② サーモダイリユーシオン・カテーテル(ポリウレタン製)	20700BZY00227000
③ スワンガンツ・サーモダイリユーシオン・カテーテル(ヘパリンコーティング)	20200BZY00488000
④ スワンガンツ・サーモダイリユーシオン・カテーテル	20400BZY00109000

(10) 酸素濃度の測定

呼吸気をサンプリングし、患者の呼吸気の酸素濃度を測定します。

1) 測定方法(吸気/呼気酸素濃度)

- ① 呼吸回路にサンプリングラインを取り付け、マルチガスユニット AG-920R/GF-110P/GF-120P/GF-210R/GF-220R/GF-310R/GF-320R に接続したドライラインまたはウォータトラップに接続します。
- ② 排気ガスアダプタを接続します。
- ③ 各設定を行い、モニタリングを開始します。
- ④ モニタリングが終了したら、使用したサンプリングラインを廃棄します。

本装置で使用可能なマルチガスユニットは以下の既認証品があります。

販売名	認証番号
① マルチガスユニット GF-100 シリーズ	220AHBZX00003000
② マルチガスユニット GF-200 シリーズ	222ADBZX00053000
③ マルチガスユニット GF-300 シリーズ	229ADBZX00093000

(11)SpO₂の測定

1) 測定方法

- ① SpO₂プローブを患者に装着し、コネクタを SpO₂ 中継コードに接続します。
- ② SpO₂ 中継コードのコネクタを、ベッドサイドモニタ本体の SpO₂ コネクタに接続すると自動的に測定を開始します。

※本装置で使用可能な SpO₂ プローブは以下の既届出品の他、ネルコア製の OxiMax シリーズ、マシモ製の LNCS、RD SET シリーズがあります。

販売名	製造販売届出番号
① フィンガープローブ TL-201T	13B1X00206000030
② フィンガープローブ TL-631T3	13B1X002060000206
③ フィンガープローブ TL-630T3	13B1X002060000258
④ フィンガープローブ TL-601T0	13B1X002060000203
⑤ フィンガープローブ TL-631T1	13B1X002060000204
⑥ フィンガープローブ TL-630T1	13B1X002060000256
⑦ マルチプローブ TL-220T	13B1X002060000032
⑧ ディスポオキシプローブ TL-271T	13B1X002060000026
⑨ ディスポオキシプローブ TL-272T	13B1X002060000027
⑩ ディスポオキシプローブ TL-273T	13B1X002060000028
⑪ ディスポオキシプローブ TL-274T	13B1X002060000029
⑫ ディスポオキシプローブ TL-271T3	13B1X002060000239
⑬ ディスポオキシプローブ TL-272T3	13B1X002060000240
⑭ ディスポオキシプローブ TL-273T3	13B1X002060000241
⑮ ディスポオキシプローブ TL-274T3	13B1X002060000242
⑯ ディスポオキシプローブ マルチ Y プローブ TL-260T	13B1X002060000025
⑰ ディスポオキシプローブ TL-051S	13B1X002060000015
⑱ ディスポオキシプローブ TL-052S	13B1X002060000016
⑲ ディスポオキシプローブ TL-061S	13B1X002060000017
⑳ ディスポオキシプローブ TL-062S	13B1X002060000018
㉑ ディスポオキシプローブ TL-530 シリーズ	13B1X002060000319
㉒ SpO ₂ 粘着センサ TL-280 シリーズ	13B1X002060000370

(12)非観血圧の測定

1) 測定方法

- ① カフの選択
患者に合わせて適切なカフを選択し、それに合った中継エアホースを接続します。
- ② カフの接続
中継エアホースのコネクタ部をベッドサイドモニタ本体の非観血圧コネクタに接続すると自動的に測定モードが選択されます。
- ③ カフの装着
患者にカフを装着し測定を開始します。測定中は、上腕の位置は心臓と同じ高さにしてください。

(13)CO₂の測定

1) 測定方法(メインストリーム方式)

- ① 呼吸回路にエアウェイアダプタとともに CO₂ センサを取り付け、センサのケーブルをベッドサイドモニタ本体のマルチパラメータコネクタに接続します。鼻孔で測定する場合ネイザルアダプタのネイザルチューブを患者の鼻腔に挿入し、センサのケーブルをマルチパラメータコネクタに接続します。
- ② 各設定を行い、モニタリングを開始します。
- ③ モニタリングが終了したら、使用したエアウェイアダプタを廃棄します。

本装置で使用可能な CO₂ センサは以下の既認証品があります。

販売名	認証番号
① CO ₂ センサキット TG-900 シリーズ	21400BZZ00536000
② CO ₂ センサキット TG-940 シリーズ	304ADBZX00066000
③ CO ₂ センサキット TG-980 シリーズ	227ADBZX00171000
④ CO ₂ センサキット 酸素マスクシリーズ	224ADBZX00004000

*

2) 測定方法(サイドストリーム方式：AG-400R/MicroPod)

- ① 呼吸回路に、フィルタラインまたはカブノラインを取り付け、CO₂ ユニット AG-400R あるいは CO₂ モジュール MicroPod(認証番号：227ADBZX00130000)のコネクタに接続します。
- ② 必要に応じ、排気ガスアダプタを接続します。
- ③ 各設定を行い、モニタリングを開始します。
- ④ モニタリングが終了したら、使用したフィルタラインまたはカブノラインを廃棄します。

本装置で使用可能なフィルタラインまたはカブノラインは以下の既認証品があります。

販売名	認証番号
① マイクロキャップシリーズ	21400BZG00002000
② カブノストリームシリーズ	220ADBZI00025000

3) 測定方法(サイドストリーム方式：AG-920R/GF-110P/GF-120P/GF-210R/GF-220R/GF-310R/GF-320R)

- ① 呼吸回路に、サンプリングラインを取り付け、マルチガスユニット AG-920R/GF-110P/GF-120P/GF-210R/GF-220R/GF-310R/GF-320R に接続したドライラインまたはウォータートラップに接続します。
- ② 必要に応じ、排気ガスアダプタを接続します。
- ③ 各設定を行い、モニタリングを開始します。
- ④ モニタリングが終了したら、使用したサンプリングラインを廃棄します。

本装置で使用可能なマルチガスユニットは「酸素濃度の測定」の項に記載のとおりです。

(14)脳波(EEG)の測定

ニューロユニット(AE-918P)を用いて、双極8チャンネルの脳波を測定することができます。

1) 測定方法

- ① 用途に合わせ、電極および電極リード線を選択し、国際式 10-20 法などにより位置を決定し、取り付けます。
- ② マルチリンクコネクタをベッドサイドモニタ本体のマルチリンクコネクタに接続します。
- ③ 中継コードを介して、電極リード線をニューロユニットのコネクタに接続すると、自動的に測定を開始します。
- ④ 必要に応じ、パラメータ測定画面の中の EEG 画面にて波形感度やフィルタなどの設定を行います。

本装置で使用可能な電極は以下の既承認・届出品があります。

販売名	承認番号／ 製造販売届出番号
① 血電極 BE-910P	13B1X002060000113
② コロデオノン電極 BE-920P	13B1X002060000114
③ 脳波用血電極 NE-114A	13B1X002060000119
④ 脳波用ディスポ電極 NE-09	13B1X002060000351
⑤ 脳波用血電極 NE-118A	13B1X002060000352
⑥ 脳波用コロデオノン電極 NE-136A	13B1X002060000127
⑦ 脳波用針電極 NE-224S	21900BZX00766000

(15)BIS の測定

BIS プロセッサ QE-910P(承認番号：21900BZX01107000)または BISx モジュール NK(認証番号：230ADBZX00102000)を用いて、BIS 値の測定および 2 チャンネルの脳波を測定することができます。※BISx モジュール NK は BISxLOC4 チャンネル(脳波 4 チャンネル用)を用いると、4 チャンネルの脳波を測定することができます。

1) 測定方法

- ① BIS センサを患者に取り付けます。
- ② 中継コードを介して、BIS プロセッサ QE-910P または BISx モジュール NK をベッドサイドモニタ本体のマルチパラメータコネクタに接続すると、自動的に測定を開始します。
- ③ 必要に応じ、パラメータ測定画面の中の BIS 画面にて波形感度などの設定を行います。
- ④ モニタリングが終了したら、使用した BIS センサを廃棄します。

本装置で使用可能な BIS センサは BIS プロセッサ QE-910P および BISx モジュール NK の承認／認証書のとおりです。

(16)N₂O の測定

患者の呼吸気をサンプリングして、呼吸気中の N₂O 濃度を計測します。

1) 測定方法

- ① 呼吸回路に、サンプリングラインを取り付け、マルチガスユニット AG-920R/GF-110P/GF-120P/GF-210R/GF-220R/GF-310R/GF-320R に接続したドライラインまたはウォータトラップに接続します。
- ② 必要に応じ、排気ガスアダプタを接続します。
- ③ 各設定を行い、モニタリングを開始します。
- ④ モニタリングが終了したら、使用したサンプリングラインを廃棄します。

本装置で使用可能なマルチガスユニットは「酸素濃度の測定」の項に記載のとおりです。

(17)Agent(揮発性麻酔薬)の測定

患者の呼吸気をサンプリングして、呼吸気中の Agent 濃度を計測します。

- ① 呼吸回路に、サンプリングラインを取り付け、マルチガスユニット AG-920R/GF-110P/GF-120P/GF-210R/GF-220R/GF-310R/GF-320R に接続したドライラインまたはウォータトラップに接続します。
- ② 必要に応じ、排気ガスアダプタを接続します。
- ③ 各設定を行い、モニタリングを開始します。
- ④ モニタリングが終了したら、使用したサンプリングラインを廃棄します。

本装置で使用可能なマルチガスユニットは「酸素濃度の測定」の項に記載のとおりです。

(18)FLOW/Paw の測定

マルチガスユニット GF-100 シリーズ(認証番号：220AHBZX00003000)のマルチガス/フローユニット(GF-120P)、マルチガスユニット GF-200 シリーズ(認証番号：222ADBZX00053000)のマルチガス/フローユニット(GF-220R)、およびマルチガスユニット GF-300 シリーズ(認証番号：229ADBZX00093000)のマルチガス/フローユニット(GF-320R)を用いて、FLOW/Paw を測定することができます。

- 「FLOW/Paw」のパラメータは主に人工呼吸器を使用して呼吸管理されている患者を対象にモニタリングされます。
- ・ FLOW：呼吸流量を示す波形です。分時換気量(MV)などを算出するための 1 次パラメータです。
 - ・ Paw：気道内圧を示す波形です。人工呼吸によって患者の気道にかけられている圧力をモニタリングします。
- 3 種のアラームの目的は以下のとおりです。
- ・ MV：分時換気量。患者の 1 分間の換気量を示す値です。呼吸回路や、患者の肺の状態に異常がないかをモニタリングするためにアラームをかけます。
 - ・ Ppeak：最高気道内圧。気道にかけられている圧力の最高値です。呼吸回路や、患者の肺の状態に異常がないかをモニタリングするためにアラームをかけます。
 - ・ PEEP：呼吸終末陽圧。患者の 1 回ごとの呼吸が終わりきったときの圧力です。呼吸回路や、患者の肺の状態に異常がないかをモニタリングするためにアラームをかけます。

1) 測定方法

- ① マルチリンクケーブル・コネクタをベッドサイドモニタ本体のマルチリンクコネクタに接続します。
- ② フローチューブをフローアダプタに取り付けます。
- ③ GF-120P/GF-220R/GF-320R にフローチューブを接続します。
- ④ フローアダプタを呼吸回路に接続します。
- ⑤ モニタの電源を ON し、各設定を行い、モニタリングを開始します。
- ⑥ モニタリングが終了したら、使用したフローチューブを廃棄します。

(19)rSO₂ の測定

rSO₂ モジュール INVOS SPS(認証番号：227ADBZX00210000)を用いて、rSO₂ を測定することができます。

1) 測定方法

- ① rSO₂ モジュール INVOS SPS にセンサーを接続します。
- ② rSO₂ モジュール INVOS SPS とプロトコル変換インタフェース QF-802P を接続します。

- ③ プロトコル変換インタフェース QF-802P をモニタ本体に接続します。
- ④ モニタリングを開始します。

(20)筋弛緩(TOF 等)の測定

1) 測定方法

- ① 電極、刺激ケーブル、加速度トランスデューサ、温度センサを患者に装着します。
- ② メインケーブルを筋弛緩モジュールに接続します。
- ③ 筋弛緩モジュールのインタフェースコネクタを、ベッドサイドモニタのマルチパラメータコネクタに接続します。
- ④ モニタリングを開始します。

本装置で使用可能な筋弛緩モジュールは以下の既認証品があります。

販売名	認証番号
① 筋弛緩モジュール	229ADBZX00035000
② 筋弛緩モジュール AF-200 シリーズ	301ADBZX00047000

(21)esCCO の測定

1) 測定方法

- ① 心電図と SpO₂ のモニタリングを行います。
- ② 校正に使用する血圧を選択し、測定を行います。
- ③ 校正に使用する心拍出量を選択します。
- ④ 校正キーを押し、校正を行います。esCCO 測定が開始され、計測結果が表示されます。
ここで、校正エラーになった場合は、校正パラメータの安定を確認後、再度校正キーを押します。
- ⑤ 測定開始後、esCCO 値が大きく変化した場合に再校正を行います。
再校正は、原則、測定開始時に用いた校正方法により行いますが、②および③の条件に変更があった場合は校正方法を変更します。

本装置の esCCO の測定で使用可能な SpO₂ プローブは以下の既届出品があります。

販売名	製造販売届出番号
① SpO ₂ 粘着センサ TL-280 シリーズ (型名：TL-281T-IB)	13B1X00206000370

2. 使用方法等に関連する使用上の注意

(1) ベッドサイドモニタ本体について

- 1) 本装置の情報のみで、患者の状態を判断しないでください。本装置の情報に基づく臨床判断は、医師が本装置の機能を十分把握した上で、臨床症状や他の検査結果等と合わせて、総合的に行ってください。
- 2) 患者に電極およびセンサ類を装着した後、エラーメッセージが表示されることなく、本装置の画面上に数値および波形が適切に表示されていることを確認してください。エラーメッセージが表示されていたり、数値および波形が適切に表示されない場合は、電極およびセンサ類の装着状態、患者の状態、本装置の設定などを確認し、原因を取り除いてください。
- 3) 患者に電極を装着し、誘導コードおよび装置本体に接続した後、一部の電極が患者からはがれてしまった場合は、その電極の金属部分には、ベッドの金属部や他の導電性のものが触れないようにしてください。また、操作者は素手で触れないようにしてください。患者が電撃を受けることがあります。
- 4) 本装置にバッテリーを組み込んでいない場合は、無停電電源装置(JIS T 0601-1 を満足している機種)や病院内の非常用電源装置などに接続してください。

(2) アラームについて

- 1) スリープ機能を使用するときは、セントラルモニタなど他のモニタでも同時にモニタリングしてください。システムセットアップで「緊急アラーム発生でスリープモードを解除する」をチェックしないでスリープ機能を使用すると、アラーム音、心拍同期音は一切鳴りません。

(3) 心電図のモニタリング

- 1) 本装置の 12 誘導心電図解析は、標準 12 誘導心電図に基づいています。解析には標準 12 誘導心電図を使用してください。ML(Mason-Likar)誘導による心電図を使用する場合は、解析所見や計測値が異なることがあります。

(4) SpO₂ のモニタリング

- 1) 以下の場合、正しく測定できない可能性があります。
 - ① 異常ヘモグロビンの量が多すぎる場合(CO₂Hb、MetHb)
 - ② 血液中に色素を注入した場合
 - ③ CPR 中に測定している場合
 - ④ 静脈拍動がある部位で測定している場合
 - ⑤ 体動がある場合
 - ⑥ 脈波が小さい場合
- 2) フィンガープローブはプローブやケーブルをテープで巻きつけて固定しないでください。うっ血や皮膚障害および熱傷を生じさせることがあります。
- 3) フィンガープローブ以外のプローブをテープで固定する際は、テープを強く巻かすぎないようにしてください。同時に、センサの装着部位より末梢側にうっ血が生じていないかなどで、常に血流をチェックしてください。短時間の装着でも血流を阻害し、皮膚障害および熱傷を生じさせることがあります。また、血流の阻害で正しく測定できないことがあります。
- 4) プローブは一定時間（ディスボアキシプローブは約8時間、リユーザブルプローブは約4時間）ごとに装着部位を変えてください。SpO₂ プローブの装着部位は通常 2~3°C 温度が上昇するため、熱傷を生じさせることがあります。また、装着部位で皮膚障害を生じることがあります。
- * 5) SpO₂ を測定しない場合は、中継コードを装置から取り外してください。ノイズなどが混入し、誤って値を表示することがあります。


(5) 非観血圧の測定

- 1) 血圧値は、患者の測定状態、測定部位、運動の有無、あるいは生理的条件の影響を受けることがあり、以下の場合には非観血圧を正しく測定できないことがあります。
 - ① 体動がある場合
 - ② 脈波が小さい場合
 - ③ 不整脈の発生頻度が高い場合
 - ④ 外部からの振動がある場合
 - ⑤ 急激な血圧変動がある場合
 - ⑥ CPR 中に測定している場合
 - ⑦ 脈拍が遅い場合
 - ⑧ 血圧が低い場合
 - ⑨ 脈圧が小さい場合
 - ⑩ カフを不適切に巻いている場合(きつく巻く、ゆるく巻く)
 - ⑪ 患者の腕の太さに合っていないサイズのカフを使用した場合
 - ⑫ 分厚い衣類の上からカフを巻いている場合
 - ⑬ 劣化したカフを使用した場合
- 2) 非観血圧の測定中は、カフの装着部位を確認し、患者の血液循環に影響がないことを確認してください。
- 3) カフのチューブは、折れ曲がらないようにしてください。血流が阻害され、うっ血をおこすことがあります。カフに圧力がかかった状態が続くと、皮膚障害などを生じます。
- * 4) NIBP に関するコネクタは、IEC 80369-5 の指定とは異なる小口径コネクタを使用しています。そのため、他の小口径コネクタを使用する医療機器に誤って接続され、患者に危害をもたらす危険な状況を招くことがあります。これらのリスクを軽減するために、適切な対策を行って使用してください。

(6) esCCO の測定

- 1) 以下の状態にある患者では PWTT が正しく測定できないため、esCCO の測定値が表示されないことがあります。また、SQI が 2 の状態で表示される esCCO の測定値は正確ではない可能性があります。SQI が 3 以上になるのを待ってから、esCCO の測定を行ってください。
 - ① 末梢循環不全により、安定した脈波が得られない場合
 - ② 体動のある場合
 - ③ 電気メスなどにより、心電図にノイズが混入している場合
 - ④ 低灌流の場合
 - ⑤ 血行力学的に不安定な場合
 - ⑥ 体位を変更中もしくは変更直後の場合

- 2) NIBP カフと SpO₂ プローブを同じ腕に装着した場合、PWTT が正しく測定できないため、esCCO の測定値が表示されないことがあります。また、SQI が 2 の状態で表示される esCCO の測定値は正確ではない可能性があります。SQI が 3 以上になるのを待ってから esCCO の測定を行ってください。または、NIBP カフを SpO₂ プローブとは別の腕に装着して esCCO の測定を行ってください。
- 3) 以下の場合、esCCO が正しく測定できなくなるため、再度校正を行ってください。
 - ① 心電図の誘導設定を変更した場合
 - ② 電極の装着位置を変更した場合
 - ③ SpO₂ プローブの測定位置を変更した場合
 - ④ 電源の再投入
 - ⑤ 入退床
 - ⑥ データ消去
 - ⑦ 患者の体動後や体位を変えた場合
- 4) 患者属性から自動計算した CO を選択して esCCO の校正を行う際は、自動計算された CO が妥当な値であることを医師が判断してから校正を行ってください。妥当な値でない場合は、手動で CO を入力してください。また、校正後も、自動計算された CO が妥当であることを確認してください。
- 5) 短い間隔で非観血圧を測定すると、PWTT が大きく変化した場合に校正用 PWTT に値が反映されず、正しい校正ができないことがあります。
- 6) esCCO を測定する場合は、SpO₂ プローブを足に装着しないでください。esCCO を正しく測定できません。
- 7) 校正用パラメータは、妥当な値であることを医師が判断してから校正を行ってください。esCCO を正しく測定できません。
- 8) 校正用パラメータは、安定している 10 分以内の値であることを医師が判断してから校正を行ってください。esCCO を正しく測定できません。
- 9) CAL CO は、患者属性から自動計算した CO とビジレオモニターの CO にて性能の確認を行いました。既知の CO を esCCO の校正に使用する場合、医師が臨床で用いるのに信頼できる機器で適切に得られた値であることを医師が判断してから校正に使用してください。
校正に使用する CAL CO の値は esCCO の初期値および変化量に影響を与えます。例えば、患者の心拍出量に対して 2 倍の値を CAL CO として入力した場合、esCCO の初期値だけでなく、その後は変化量を 2 倍で推定した値で表示されます。誤差の大きい CO 値を CAL CO として入力した場合、患者の心拍出量の急激な変化に対して esCCO の変化量の誤差は大きくなります。CO 値以外の測定値も考慮して、esCCO の誤差が大きくなると思われる場合は、その値を校正に使用しないでください。また、その測定値を用いて臨床判断を行わないでください。

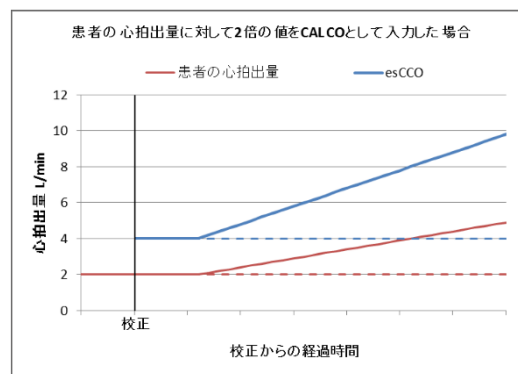

- 10) 小さいCO値が体格などの患者背景に反映されない症例がありました。よって、肥満や心不全などの患者に対し、患者属性から自動計算した CO(重回帰分析法)を用いて校正を行った場合、自動計算された CO では心拍出量を正しく推定できず、CAL CO を高く推定することがあります。校正に使用する CAL CO の値は esCCO の初期値および変化量に影響を与えるため、校正に使用することを意図したCO値が臨床に疑わしいと思われる場合は、その値を校正に使用しないでください。また、その測定値を用いて臨床判断を行わないでください。
- 11) 肥満症、動脈硬化症等による高血圧症例に関しては、esCCO の有効性が確認されていません。

(7) インターベッドについて

- 1) インターベッド機能のみで患者の生体情報をモニタリングすることはしないでください。モニタリングはインターベッド先の機器およびセントラルモニタで行ってください。

(8) サイバーセキュリティに関する注意事項

- 1) 本装置は安全な環境(厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」などに従い、安全に管理されている環境)で使用してください。

【使用上の注意】

1. 使用注意(次の患者には慎重に適用すること)

(1) 心電図のモニタリング

- 1) ペースメーカ使用患者[ペースング検出を「ON」に設定してください。「OFF」に設定すると、ペースメーカパルスの除去を行いません。また、「ON」に設定した場合も、ペースメーカパルスの見落とし/拾いすぎが起きることがあるため、頻繁に患者の状態を確認してください。ペースメーカパルスが除去できない場合、ペースメーカパルスを QRS 波と誤認識し、誤った心拍数を表示したり、心停止などの重大な不整脈を見落とすことがあります。検出されたペースメーカパルスの発生状況だけでは、ペースメーカの動作状況を正しく確認することはできません。]
- 2) 生体の電気的インピーダンス測定センサ(分時換気量(MV)センサなど)を使用したレート応答型ペースメーカを植え込んだ患者[本装置を接続した場合、ペースメーカのセンサが過度に反応し最大レートに達してしまうなど、不適切なペースングレートになる可能性があります。また、本装置が誤った情報を提供してしまう場合も考えられます。この場合は、インピーダンス法による呼吸測定を「OFF」に設定してください。]

(2) SpO₂のモニタリング

- 1) Photo Dynamic Therapy(光線力学療法)中の患者[パルスオキシメータプローブの照射光により、プローブ装着部で熱傷が起る可能性があります。Photo Dynamic Therapy は、光反応性をもつ薬剤を投与し、光過敏性の副作用があります。]

(3) 非観血圧の測定

- 1) 出血傾向あるいは凝固亢進(状態)の患者[カフで腕を締め付けた後に点状の出血や血栓による循環障害を生じることがあります。]
- 2) 創傷のある患者[創傷部位にカフを装着しないでください。悪化の原因となります。]
- 3) 乳腺切除または腋窩リンパ節郭清した患者[乳腺切除または腋窩リンパ節郭清された側の腕にカフを装着しないでください。血流が阻害され、むくみなどの循環障害を生じることがあります。]

(4) CO₂のモニタリング

- 1) 換気量の少ない患者[死腔を考慮してエアウェイアダプタおよびネイザルアダプタを選択してください。アダプタには死腔が存在するため、吸気に CO₂ が混入して測定値が不正確になったり、無呼吸状態の検出が困難になったりすることがあります。]

(5) BIS のモニタリング

- 1) てんかんなどの既知の神経疾患を有する患者、精神活性薬を使用している患者、脳梗塞患者、および18歳未満の子供[臨床経験が少ないため、BIS 値の慎重な解釈が必要となります。]

2. 重要な基本的注意

(1) esCCO の測定

- 1) 以下の状態にある患者では PWTT が正しく測定できないため、esCCO の測定値は表示されません。
 - ① 心房細動、心房粗動、洞性不整脈など、上室性のリズム不正を発生している状態
 - ② 二段脈および三段脈を発生している状態
 - ③ 2度房室ブロック、3度房室ブロックを発生している状態
 - ④ ペーシング中の患者
 - ⑤ 人工心肺中の患者
 - ⑥ 人工心肺を使用しない冠動脈バイパス術(OPCAB)を施行中の患者

- ⑦ 大動脈クランプ中の患者
- ⑧ 心タンポナーデ状態の患者
- ⑨ 心臓脱転中の患者
- ⑩ 大動脈内バルーンポンピング(IABP)中の患者

3. 相互作用(他の医薬品・医療機器等との併用に関すること)

(1) 併用禁忌(併用しないこと)

医薬品・医療機器の名称等 (一般的名称/一般名・販売名)	臨床症状・ 措置方法	機序・危険因子
1) 磁気共鳴画像診断装置 (MRI 装置)	MRI 検査を行うときは、本装置に接続されている電極およびトランスデューサ類を患者から取り外すこと	誘導起電力により局所的な発熱で患者が熱傷を負うことがある

(2) 併用注意(併用に注意すること)

1) 除細動器

- ① 除細動を行うときは、患者の胸部に装着した電極および貼付してある薬剤からなるべく離して通電してください。接触のおそれがある場合は、電極および薬剤を取り除いてください。除細動器のパドルがこれらの物に直接触れると、放電エネルギーによりその部位で熱傷を生じます。
- ② 除細動を行うとき周囲の人は、患者および患者に接続されている装置やコード類には触れないでください。放電エネルギーにより電撃を受けます。
- ③ 除細動のパッド間にケーブル類が配置されている状態で、除細動を行わないでください。除細動の効果が減少します。

2) 電気手術器(電気メス)

- ① 電気メスと併用する場合は、電気メスの対極板の全面積を適切に装着してください。装着が不適切な場合、電気メスの電流が本装置の電極に流れ、電極装着部に熱傷を生じます。詳細は、電気メスの取扱説明書の指示に従ってください。
- ② 電気メスと併用する場合は、電気メスのノイズにより心電図、SpO₂、NIBP が正しく測定できない場合があります。

3) 酸素補給用鼻カテーテル(酸素カニューレ) - CO₂ モニタリング時

- ① 酸素カニューレが正しく装着されていることを、他のパラメータの数値を参考にしたり、定期的に患者を観察して確認してください。動脈血酸素分圧の上昇が確認できない場合は、直ちに CO₂ のモニタリングを中止してください。
- ② YG-122T(酸素カニューレ取付け用)に取り付けた酸素カニューレは、酸素カニューレのチューブが曲がったり、折れたり、ネイザルチューブで塞がれていないか確認してください。酸素カニューレのチューブ先が上や下に向きすぎると O₂ の供給量が不足したり、CO₂ の値が不正確になります。

4. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

(1) 小児等への適用

1) ECG のモニタリング

- ① 小児や新生児の場合、A-FIB 検出の設定を ON にしないでください。正しく検出できないことがあります。
- ② 小児や新生児の場合、QTc 間隔およびQRS 幅を正しく測定できないことがあります。

2) SpO₂のモニタリング

- ① 新生児、低出生体重児にプローブをテープで固定する際は、テープを強く巻きすぎないように特に注意してください。同時に、センサの装着部位より末梢側にうっ血が生じていないかなどで、常に血流をチェックしてください。短時間の装着でも血流を阻害し、皮膚障害および熱傷を生じさせることがあります。また、血流の阻害で正しく測定できないことがあります。
- ② 新生児、低出生体重児については、症状および程度に応じてセンサの装着部位をより頻繁に(通常はディスプレイオキシプローブは約8時間、リユーザブルプローブは約4時間のためそれよりも短い間隔で)変えてください。新生児および低出生体重児は皮膚が未成熟であり、SpO₂ プローブの装着部位は通常 2~3°C 温度が上昇するため、熱傷を生じさせることがあります。また、装着部位で皮膚障害を生じることがあります。

3) CO₂のモニタリング

- ① エアウェイアダプタおよびネイザルアダプタの死腔を十分考慮してください。死腔があるために吸気に CO₂ が混入して測定値が不正確になったり、無呼吸状態の検出が困難になったりすることがあります。

4) esCCO の測定に関する注意事項

- ① 新生児に関しては、esCCO の有効性が確認されていません。

5. その他の注意

- (1) ケタミン、フェンタニル、モルヒネなどの鎮痛麻酔薬または、筋弛緩薬を単独で使用する場合、BIS 値が高い値を示し、適切な BIS モニタリングが行えないと報告されています。

【保管方法及び有効期間等】

1. 耐用期間

6 年(当社データの自己認証による。指定の保守点検を実施した場合に限る。)

【保守・点検に係る事項】

1. 清掃・消毒

詳細は取扱説明書を参照してください。

2. 使用者による保守点検事項

(1) 日常点検

1) 電源投入前

点検項目		点検時期
①	装置本体の周囲に障害物はないか。	始業時
②	電極リード線などの付属品はそろっているか。	
③	ディスプレイが電極や記録紙は十分な量があるか。	
④	洗浄・滅菌されたセンサ類が用意されているか。	
⑤	電源コード、アース線は確実に接続されているか。	
⑥	各測定パラメータのケーブルは接続されているか。	
⑦	SD メモリカードはセットされているか。	
⑧	記録紙はセットされているか。	
⑨	モニタ本体の AC 電源ランプは点灯しているか。	
⑩	外部に傷や破損、変形、汚れなどがないか。	
⑪	操作パネルにはがれ、やぶれがないか。	
⑫	キー、スイッチなどに割れはないか。	
⑬	センサや電極が汚れていたり、破損していないか。	
⑭	電源コードに損傷はないか。	
⑮	電極リード線などが切れかかっていないか。	
⑯	装置が水などの液体でぬれていないか。	

2) 電源投入時および動作中

点検項目		点検時期
①	電源スイッチは正常に点灯するか。	電源投入時
②	発火、発煙や異臭はないか。	
③	アラームインジケータは赤、黄、青、緑色に点灯するか。	
④	音(ブーン)は発生するか。	
⑤	装置に触れたときに感電したり異常な発熱などがないか。	
⑥	画面上にエラーが表示されていないか。	
⑦	画面上の時刻表示は合っているか。	
⑧	周囲で使用している機器になんらかの影響が出ないか。	
⑨	画面表示は正常か。(輝度、歪みや色の異常がないか。表示される数値や波形は適切か。)	動作中
⑩	ランプ表示は正常か。	
⑪	キー・スイッチは正常に操作できるか。	
⑫	タッチパネルは正常に操作できるか。	
⑬	以下のアラーム機能は正常に動作するか。 ・アラームインジケータは赤、黄、青、緑色に点灯するか。 ・音は発生するか。 ・アラーム音量の設定は適切か。	

点検項目		点検時期
⑭	記録紙の搬送は正常か。(蛇行やひっかかりなどがないか)	動作中
⑮	記録状態は正常か。(印字のかすれなどがないか)	
⑯	操作中にエラー表示や異常動作が起きないか。	

3) 終業時

点検項目		点検時期
①	患者さんが入れ代わる場合に「退床」(データ消去)の操作をしたか。	終業時
②	使用中に設定を一時的に変更した場合、元に戻したか。	
③	使用中に何らかの異常が生じなかったか。	
④	外観上で汚れ、傷や破損が生じていないか。	
⑤	センサ類の清掃・消毒・保管をしたか。	
⑥	付属品などの整理をしたか。	
⑦	記録紙やディスプレイが電極などの消耗品の残量が少なくなっていないか。	
⑧	モニタ本体の電源はオフにしたか。	
⑨	周囲に薬品や水などが放置されていないか。	
⑩	使用済みの血圧回路などの廃棄方法は適切か。	
⑪	装置本体の保管状態は適切か。	

点検の内容および方法の詳細は取扱説明書を参照してください。

(2) 定期点検

点検項目		点検時期
1)	各部の汚れはないか。	半年ごと
2)	装置外装にひびや割れなどの破損、変形がないか。	
3)	ラベルにはがれ、やぶれがないか。	
4)	コネクタ、スイッチなどに割れやガタつきがないか。	
5)	各部が血液や薬液で汚れていないか。	
6)	電源コードに破損、被覆のやぶれはないか。	
7)	電源コードの接地線は断線していないか。	
8)	POWER ON チェック結果は「OK」か。	
9)	ROM の動作は正常か。	
10)	RAM の動作は正常か。	
11)	FRAM の動作は正常か。	
12)	本体正面のキーは正常に動作するか。	
13)	タッチキーは正常に動作するか。	
14)	リモートコントローラ(オプション)は正常に動作するか。	
15)	音源およびアンプの状態は正常か。	
16)	メモリカードは正常か。	
17)	アラームインジケータは正常に発光するか。	
18)	ディスプレイの輝度調整機能は正常か。	
19)	VRAM の動作は正常か。	
20)	レコーダモジュール(オプション)の動作は正常か。	
21)	非観血血圧の圧力測定精度は正常か。	
22)	非観血血圧のゼロ校正は正常か。	
23)	非観血血圧の安全回路動作は正常か。	
24)	非観血血圧の加圧スピードは正常か。	
25)	非観血血圧の圧力保持の動作は正常か。	
26)	非観血血圧の電磁弁の動作は正常か。	
27)	非観血血圧の空気回路の動作は正常か。	
28)	日時設定は正しいか。	
29)	心拍数の表示精度、同期音は正常か。	
30)	心電図感度は正常か。	
31)	心拍数、電極はずれアラーム動作は正常か。	
32)	呼吸数の表示精度は正常か。	
33)	呼吸数アラーム動作は正常か。	
34)	SpO ₂ 値、脈拍数の表示精度、同期音は正常か。	
35)	SpO ₂ 値、コード抜けアラーム動作は正常か。	
36)	観血血圧のゼロ校正の精度は正常か。	
37)	観血血圧値の表示精度は正常か。	
38)	観血血圧のコネクタ抜けアラーム動作は正常か。	

点検項目		点検時期
39)	体温の表示精度は正常か。	半年ごと
40)	体温のセンサ抜けアラーム動作は正常か。	
41)	呼吸数、CO ₂ 値の表示精度は正常か。	
42)	CO ₂ のコネクタ抜けアラーム動作は正常か。	
43)	CO ₂ センサキットの測定精度は正常か。	
44)	血液温、注入液温の表示精度は正常か。	
45)	心拍出量の表示精度は正常か。	
46)	CO のコネクタ抜けアラーム動作は正常か。	
47)	バッテリー動作は正常か。	
48)	安全性の点検を行ったか。	

点検の内容および方法の詳細は取扱説明書を参照してください。

3. 業者による保守点検事項

「2. 使用者による保守点検事項」の「(2) 定期点検」と同様です。

4. 定期交換部品

定期交換部品		使用期限
(1)	バッテリーパック SB-671P	約1年使用できます。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 日本光電工業株式会社

電話番号： 03-5996-8000(代表)

日本光電

日本光電工業株式会社

東京都新宿区西落合1-31-4 〒161-8560
☎03-5996-8000(代表) Fax 03-5996-8091

<https://www.nihonkohden.co.jp/>