

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 非能動型呼吸運動訓練装置 11634001

ポーテックス・コーチ 2

【禁忌・禁止】

〈適用対象(患者)〉


- * 1) 次の場合には本品を使用しないこと[治療の効果が得られない可能性があるため]。
- ・ 十分な呼吸療法への協力や理解が得られない患者
 - ・ 深呼吸のできない患者(肺活量が約 10mL/kg 以下、最大吸気量が予測値の約 1/3 以下)

【形状・構造及び原理等】

* 〈形状・構造〉

22-2500 コーチ 2(肺活量が 2500ml までの患者用)

22-4000 コーチ 2(肺活量が 4000ml までの患者用)



番号	名称
①	ハウジング
②	吸気コーチ
③	チューブ
④	マウスピース
⑤	吸気用ポート(裏側)
⑥	ピストン
⑦	インジケータ
⑧	ハンドル
⑨	酸素チューブポート

本品は、呼吸療法のためのインセンティブ・スパイロメータで、未滅菌、同一患者に使用するための製品である。
喀痰の排出の改善、換気不全、無気肺などの予防のために、主に術前／術後及び深呼吸訓練が必要となる患者が適応となる。
本品には、酸素を投与するためのポートがある。

〈原理〉

マウスピースを通して吸気することにより、機器内部が陰圧となり、ピストン及び吸気コーチが上昇する。吸気コーチの位置によって、吸気量が適切かを視覚的に確認することができる。インジケータによって設定した目標吸気量までピストンを上昇させ、持続することにより肺泡を膨らませ、患者の換気機能を改善する。

* 〈原材料〉

マウスピース: ポリプロピレン
・ 未滅菌

【使用目的又は効果】


〈使用目的〉

本品は、患者の吸気量を表示し、深い呼吸を持続させる訓練を行うことで、患者の肺に刺激を与えて換気を改善するために用いる。


【使用方法等】

* 〈使用方法〉


1. 付属のチューブの蛇腹を伸ばしてから、本体の吸気用ポートに取り付けます。マウスピースをチューブ先端に取り付けます。

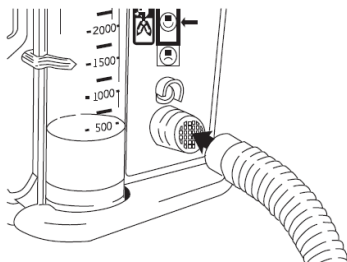

2. 目標の吸気量に、黄色の目標インジケータをスライドさせます。




3. 体の正面で本品のハンドル部分をまっすぐ持ちます。完全に息を吐いてから、しっかりマウスピースをくわえます。

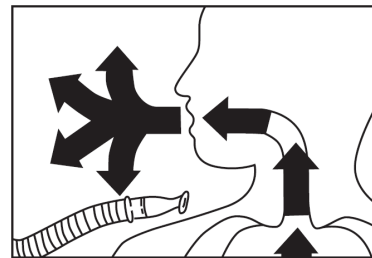

4. 小さい黄色の『吸気コーチ』ができる限り太枠の「☺」内に入るよう、ゆっくりと深く、息を吸います。




5. ゆっくりと深く息を吸い込み、これ以上息を吸い込めない状態になったら、口からマウスピースを外して 6 秒間程度息を止めます。マウスピースを外して口／鼻から息をゆっくり吐き出します。呼吸訓練は、処方された目標インジケータまで黄色のピストンが到達するよう試してください。なお吸気量の最高レベルは、黄色のピストン上部が到達した位置です。

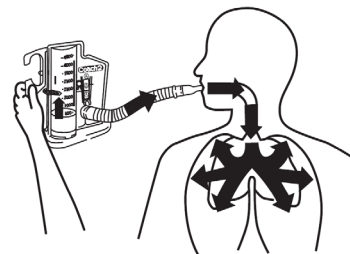

6. 医師から指示された回数を繰り返してください。
7. 医師の指示に従い咳払い(ハフティング)をします。必要に応じて咳をして分泌物を吐き出します。

＊＜酸素投与＞

吸気用ポートの裏側に酸素チューブポートがあります。患者に酸素投与が必要な場合は、一般的な酸素チューブをポートに取り付け、吸気訓練中に酸素を投与できます。投与する酸素流量は、以下のグラフを参考にして患者の状態に合わせて設定してください。酸素濃度は患者の吸気流量の上昇に伴って低下します。

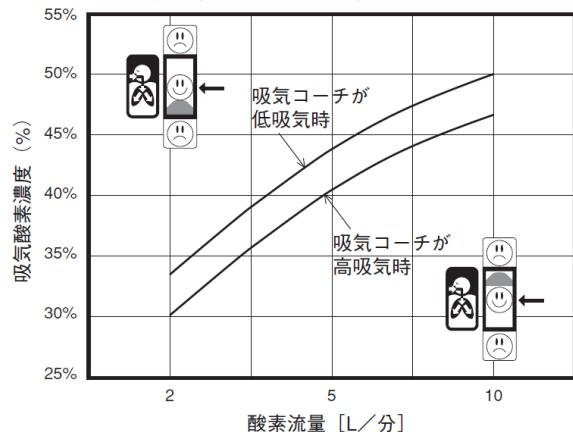

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- *1) 1 回ごとにマウスピースを口から外し、ピストンがハウジングの底部へ降りてきた後に練習を再開すること。
- *2) 酸素チューブが確実に接続されリーク等がないことを確認すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 本品を滅菌しないこと。
- 2) 本品は、インジケータを目線の高さに合わせ、使用中は傾けないこと[最適に機能させるため]。
- 3) 使用中は、ハンドル以外には触らないこと[本品を安定させるため]。

＜不具合・有害事象＞

本品の使用に際して、以下のような不具合が発生する可能性がある。

- 1) その他の不具合
 - ・ 吸気コーチの動作不良
 - ・ ピストンの動作不良
 - ・ インジケータの動作不良
 - ・ 本体の破損

＜その他の注意＞

- 1) 同一患者にのみ使用すること[感染の恐れがあるため]。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

本品を保管するときは次の事項に注意すること。

- ・ 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。
- ・ 保管時(運搬時も含む)は過度な振動・衝撃等に注意すること。

＜有効期間＞

- ・ 本品の包装に記載されている「有効期間」までに使用すること[自己認証(当社データ)による]。

【保守・点検に係る事項】

本品の使用後は、マウスピースをすすいだ後、よく振る等して、十分に乾かすこと。

マウスピース及びチューブ以外は洗浄しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＊＜製造販売業者＞

ICU メディカルジャパン株式会社

＜問合せ先＞

フリーダイヤル 0120-582-855

＊＜製造業者＞

アイシーユー メディカル, Inc.

ICU Medical, Inc.

＜国名＞

アメリカ合衆国