**2025 年 8 月（第 3 版）
*2023 年 5 月（第 2 版）
認証番号　229AABZX00052000
機械器具 12 理学診療用器具
管理医療機器 超音波プローブ用穿刺針装着器具 JMDN 70448000

IC9 用穿刺ニードルガイド

【警告】

使用方法

・本製品のガイド下で電気手術器のニードルカニューレを使用する際は、ニードルカニューレの絶縁皮膜を損傷しないよう、ニードルカニューレの操作を慎重に行うこと。[電気手術器のニードルカニューレを本製品に挿入する際及び本製品に沿って出し入れを行う際、ニードルカニューレ上の絶縁皮膜を破損させ、破損部周囲の組織に熱傷を引き起こす可能性がある]

【形状・構造及び原理等】

形状

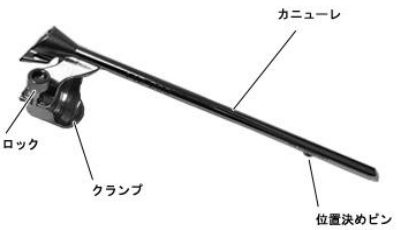

構造・構成ユニット

1.構成
本製品は、以下より構成される。
・カニューレ
・クランプ
・ロック
・位置決めピン

作動・動作原理

本製品は超音波診断用プローブに装着し、穿刺手技を補助するものである。
超音波画像診断装置にてリアルタイムモニタしながら、穿刺を行うことが可能である。

【使用目的又は効果】

使用目的

超音波診断用プローブに固定し、穿刺針を装着するために用いること。

【使用方法等】

使用方法

本製品の各種の使用時における警告・危険・注意事項については、超音波画像診断装置の取扱説明書の操作説明に記載されているので参照すること。

組み合わせて使用する医療機器

本製品は以下の超音波診断用プローブ(類型を含む)に装着して使用する。

販売名	承認番号等
IC9-RS プローブ	226ABBZX00154000

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本機器のガイド下で電気手術器のニードルカニューレを使用する際は、使用前に必ずニードルカニューレ装着面に破損等がなく、スムーズに可動することを確認の上、慎重に操作すること。
2. 画面上の穿刺ガイドラインは穿刺針の刺入方向の目安として使用し、穿刺針を刺入すると、人体組織の影響や、穿刺針の種類等により、穿刺針が曲がって進むことがある。目標部位と穿刺針先を観察しながら行うこと。
3. 穿刺アダプタ本体を超音波診断用プローブに正しく取り付けること。
4. プローブカバーやプローブシースを可能な限り使用すること。操作者は感染症を防ぐために適切な処置を取り続ける必要がある。新しいプローブカバー装着時には、医療スタッフは手袋を交換した後にプローブカバーを装着すること。

妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用

妊婦、妊娠の疑いのある者及び小児へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 消毒後本製品を専用収納ケースに保管する。
2. 保管/運搬は、通常使用される環境の常温・常湿の範囲内で適切に行うこと。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検

1. 使用前点検を行うこと。
2. 保守整備の概要
最適な動作と安全性を確保するため、下表に従いメンテナンスすること。

点検項目	点検頻度
外観・動作の点検	使用前後
洗浄	使用後
消毒	
滅菌	必要に応じて

3. 使用後は洗浄、及び消毒・滅菌を行うこと。
(1) ニードルガイドの洗浄
1) ニードルガイドの表面から目に見える汚れを小さくて柔らかい器具用ブラシで取り除く。
2) ニードルガイドを中性 pH、低発泡の酵素洗剤に 5 分以上浸す。浸しながら、器具用ブラシを使用し表面、及び機構形状部分に詰まった汚れを取り除く。
ニードルガイドを洗剤溶液から取り上げ、乾燥した布で付着した液を拭き取る。 濃度については洗剤の製造会社の使用説明や推奨に従うこと。
(2) ニードルガイドの消毒、及び滅菌
1) 0.55%オルソーフタルアルデヒド系溶液を使用してニードルガイドに対し高位レベルの消毒を行う。 濃度、使用時間、処理後の手順については製造会社の使用説明や推奨事項に従うこと。
2) 2%グルタルアルデヒド系溶液、3.4%グルタルアルデヒド系溶液、又は過酸化水素系溶液を使用してニードルガイドに対し高位レベルの消毒を行う。 ニードルガイドは 15 分から 30 分間、132～138℃で高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)が可能である。

取扱説明書を必ずご参照ください。

3)ニードルガイドに亀裂や破損などの損傷がないか検査し、明らかに損傷している場合、ニードルガイドの使用を中止すること。

推奨洗浄/消毒/滅菌薬液は以下の通りである。ENZOL® 酵素洗剤、CIDEX OPA® オルソーフタルアルデヒド溶液、CIDEX®活性ジアルデヒド溶液、CIDEX Plus®(ジョンソン・エンド・ジョンソン(株))

使用者による保守点検事項の詳細については取扱説明書を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
住所： 〒191-8503 東京都日野市旭が丘 4-7-127

保守サービス連絡先： カスタマーコールセンター
電話： 0120-055-919

**製造業者： シブコ メディカル インスツルメンツ カンパニーインク ディービーエー シブコ アンド シブコ メディカル ソリューションズ
(CIVCO Medical Instruments Co.,Inc. DBA CIVCO and CIVCO Medical Solutions)

国名： アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください。