


ボーングラフトタンプ

【形状・構造及び原理等】

<形状・構造>

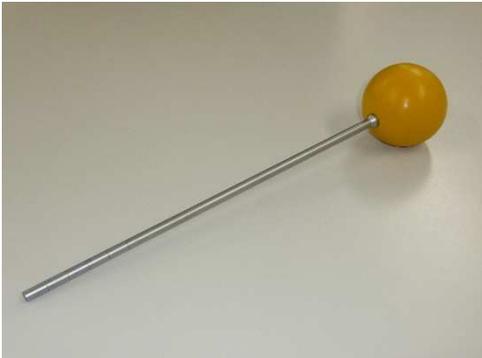

製品名: BONE GRAFT TAMP

製品番号: JS1303201

原材料: ステンレス鋼、ポリフェニルサルフォン

(ステンレス鋼には、クロム及びニッケルが含まれている。)

JANコード: 4580454960014

<原理等>

本品は、脊椎手術用機器に適合した手術器械を使用し、移植骨を決められた位置に的確に設置するために用いる。

【使用目的又は効果】

脊椎固定術等の脊椎手術のために用いる手術器械をいう。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

移植骨を埋植する際に、本品で移植部位に押し込む。
本品は未滅菌品のため、使用前に滅菌を行うこと。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

- (1) 折損、曲がり等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
- (2) 滅菌前に本品に損傷、変形等の異常がないことを点検すること。
- (3) 使用前に必ず洗浄、滅菌すること。
- (4) 使用後は、付着した血液、体液、組織及び薬品が乾燥して固着しないように、直ちに洗浄液に浸漬すること。
- (5) 塩素系及びヨウ素系の消毒剤は腐食の原因となるので、できるだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- * (1) 本品が、クロイツフェルト・ヤコブ病(CDJ)患者又はその疑いのある患者に使用した場合は、最新の国内規制、ガイドラインを遵守すること。

<不具合・有害事象>

本品の使用により起こり得る不具合・有害事象は以下のようなことがある。

- * (1) 重大な不具合
 - 1) 本品の破損、変形

(2) 重大な有害事象

- 1) 血管・神経・組織の損傷
- 2) 感染
- 3) 塞栓(脂肪、血液等)
- 4) 骨折
- 5) 過敏症
- 6) 体内遺残

<高齢者への使用>

高齢者は骨が粗鬆症化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより、骨折したり、インプラント設置後、緩み等が起きる可能性があるため、慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- (1) 常温、常湿で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

- * (1) 本品使用前に、キズ、折れ、曲がり、錆等の不具合がないかを点検すること。
- (2) 本品使用後は、直ちに血液、体液、組織等の汚物を除去し、洗浄・滅菌処理を行うこと。
- (3) 汚染除去に用いる洗剤は、中性洗剤等、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
- (4) 強アルカリ・強酸性洗剤は器具を腐食させる恐れがあるため、使用を避けること。
- (5) 磨き粉や金属タワシで器具の表面を磨かないこと。器具表面に擦過傷を生じ、錆や腐食が発生する恐れがある。
- (6) 器具に付着した洗剤・消毒剤等は浄化水(ろ過、蒸留、脱イオン化等)で完全に洗い流すこと。
- (7) 洗浄後は腐食防止のために、直ちに乾燥させること。
- (8) 下記の滅菌条件が推奨される。

[第十六改正日本薬局方 微生物殺滅法 2. 滅菌法 2.1. 加熱法(i) 高圧蒸気法による。]

滅菌方法: 高圧蒸気法

滅菌条件: 115~118°C 30分間

121~124°C 15分間

126~129°C 10分間

<業者による保守点検事項>

本品使用前に、キズ、折れ、曲がり、錆等の不具合がないことを点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

西島メディカル株式会社

愛知県愛知郡東郷町諸輪字百々51-92

電話: 0561-37-1222