



機械器具 39 医療用鉗子  
一般医療機器 鉗子 10861001 (JMDNコード)

## 【手術用鉗子】

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造

遠位端から転心までの刃の先端は様々な形状になっており、遠位端を開閉するための近位端（ハンドル部）と臓器・組織・血管を把持・結合・圧迫・支持する部分（プラットホーム部）により構成される。

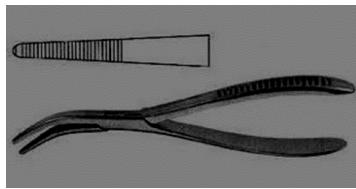

#### 2. 原理

本製品のハンドル部を握って先端を閉じることにより、プラットホーム部がかみ合い、臓器・組織・血管を把持・結合・圧迫・支持することが可能となる。

### 【使用目的又は効果】

臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために用いる手術器具をいう。本品は再使用可能である。

### 【使用方法等】

- 1) 本製品は再使用可能な機器であり、未滅菌品です。本製品を使用する前に必ず滅菌して下さい。オートクレーブ滅菌（134°C、5分）を推奨。
- 2) 一般的な外科手術の手技に従って、適切な組み合わせのもとに操作をして下さい。
- 3) ハンドルを手のひら又は親指と人差し指等を用いて握るとプラットホーム部は閉じ、臓器、組織、血管を把持、結合、圧迫又は支持することができます。
- 4) 使用後は適切な方法により洗浄を行い保管して下さい。

### 【使用上の注意】

- 1) 本製品は、使用する前に滅菌する必要があります。本製品を購入後初めて使用する場合も、洗浄及び滅菌を実施して下さい。
- 2) 本製品を使用する前に、傷や変形、損傷がないことを必ず確認して下さい。
- 3) 本製品使用後は速やかに洗浄等を行って下さい。
- 4) 腐食を避けるために、生理食塩液に長時間接触させないで下さい。

### 【保守・点検に係る事項】

- ・汚染された本製品を取り扱う際には、防水加工された手袋を着用する。
- ・オートクレーブ、洗浄剤、消毒剤は、説明書などに従い正しく使用すること。
- ・廃棄する場合は、付着した血液、体液、組織などの汚物を除去、洗浄した後に処分する。
- ・ブレード部、プラットホーム部の滅菌、消毒は以下の方法によること。
  - ① 使用後直ちに洗浄液などに浸す。
  - ② スポンジ、布あるいはソフトブラシなどを使って洗い、きれいな水で洗浄剤が残留しないようにすぐ。
  - ③ 水分を拭き取るか乾燥させてから、オートクレーブ滅菌（134°C、5分）をする。
- ・ハンドル部の滅菌、消毒は以下の方法によること。
  - ① 消毒剤を塗布した布で拭く。
  - ② 液体に浸さない。
  - ③ 内部に液体が入らないようにする。
  - ④ オートクレーブ滅菌（134°C、5分）が可能。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：アドバンスジャパン株式会社  
住所：埼玉県川口市大字東本郷118-1  
電話番号：048-234-8291

製造業者：プライムチョイス Prime Choice Inc  
国名：パキスタン