医療機器製造販売届出番号:13B1X00079000093

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 手術用ドリルビット JMDN コード: 32390000

テーパード ナビゲーター サージカルキット

【形状・構造及び原理等】

品番	種類
SGTIKIT	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｻｰﾃﾝ ｻｰｼﾞｶﾙｷｯﾄ

キット内容物（1～69）※単品販売もされる。

	品番	数量	種類
1	SGTTRAY	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｻｰｼﾞｶﾙ ﾄﾚｰ
2	SGTTP4	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾃｨｯｼｭﾊﾟﾝﾁ 4.1mm(D)
3	SGTTP5	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾃｨｯｼｭﾊﾟﾝﾁ 5.0mm(D)
4	SGTCP4S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｺｰﾃｨｶﾙ ﾊﾟｰﾌｫﾚｰﾀｰ 4.1mm(D) ｼｮｰﾄ
5	SGTCP4L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｺｰﾃｨｶﾙ ﾊﾟｰﾌｫﾚｰﾀｰ 4.1mm(D) ﾛﾝｸﾞ
6	SGTCP5S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｺｰﾃｨｶﾙ ﾊﾟｰﾌｫﾚｰﾀｰ 5mm(D) ｼｮｰﾄ
7	SGTCP5L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｺｰﾃｨｶﾙ ﾊﾟｰﾌｫﾚｰﾀｰ 5mm(D) ﾛﾝｸﾞ
8	SGTD19A	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾂｲｽﾄﾄﾞﾘﾙ 1.9mm(D)×a(L)
9	SGTD19B	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾂｲｽﾄﾄﾞﾘﾙ 1.9mm(D)×b(L)
10	SGTD19C	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾂｲｽﾄﾄﾞﾘﾙ 1.9mm(D)×c(L)
11	SGTD19D	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾂｲｽﾄﾄﾞﾘﾙ 1.9mm(D)×d(L)
12	SGTD19E	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾂｲｽﾄﾄﾞﾘﾙ 1.9mm(D)×e(L)
13	SGTD19F	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾂｲｽﾄﾄﾞﾘﾙ 1.9mm(D)×f(L)
14	SGTD19G	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾂｲｽﾄﾄﾞﾘﾙ 1.9mm(D)×g(L)
15	MSGTCDS	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｶｳﾝﾀｰｼﾝｸ ﾄﾞﾘﾙ 3.4mm(D)×S(L)
16	MSGTCDL	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｶｳﾝﾀｰｼﾝｸ ﾄﾞﾘﾙ 3.4mm(D)×L(L)
17	SGTCD4S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｶｳﾝﾀｰｼﾝｸ ﾄﾞﾘﾙ 4.1mm(D)×S(L)
18	SGTCD4L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｶｳﾝﾀｰｼﾝｸ ﾄﾞﾘﾙ 4.1mm(D)×L(L)
19	SGTCD5S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｶｳﾝﾀｰｼﾝｸ ﾄﾞﾘﾙ 5mm(D)×S(L)
20	SGTCD5L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｶｳﾝﾀｰｼﾝｸ ﾄﾞﾘﾙ 5mm(D)×L(L)
21	MSGTD85S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 3.25mm(D)×8.5mm(L) ｼｮｰﾄ
22	MSGTD10S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 3.25mm(D)×10mm(L) ｼｮｰﾄ
23	MSGTD11S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 3.25mm(D)×11mm(L) ｼｮｰﾄ
24	MSGTD13S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 3.25mm(D)×13mm(L) ｼｮｰﾄ
25	MSGTD15S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 3.25mm(D)×15mm(L) ｼｮｰﾄ
26	MSGTD85L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 3.25mm(D)×8.5mm(L) ﾛﾝｸﾞ
27	MSGTD10L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 3.25mm(D)×10mm(L) ﾛﾝｸﾞ
28	MSGTD11L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 3.25mm(D)×11mm(L) ﾛﾝｸﾞ
29	MSGTD13L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 3.25mm(D)×13mm(L) ﾛﾝｸﾞ
30	MSGTD15L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 3.25mm(D)×15mm(L) ﾛﾝｸﾞ
31	SGTD485S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 4mm(D)×8.5mm(L) ｼｮｰﾄ
32	SGTD410S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 4mm(D)×10mm(L) ｼｮｰﾄ
33	SGTD411S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 4mm(D)×11mm(L) ｼｮｰﾄ
34	SGTD413S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 4mm(D)×13mm(L) ｼｮｰﾄ
35	SGTD415S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 4mm(D)×15mm(L) ｼｮｰﾄ
36	SGTD485L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 4mm(D)×8.5mm(L) ﾛﾝｸﾞ
37	SGTD410L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 4mm(D)×10mm(L) ﾛﾝｸﾞ
38	SGTD411L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 4mm(D)×11mm(L) ﾛﾝｸﾞ
39	SGTD413L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 4mm(D)×13mm(L) ﾛﾝｸﾞ
40	SGTD415L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 4mm(D)×15mm(L) ﾛﾝｸﾞ
41	SGTD585S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 5mm(D)×8.5mm(L) ｼｮｰﾄ
42	SGTD510S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 5mm(D)×10mm(L) ｼｮｰﾄ
43	SGTD511S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 5mm(D)×11mm(L) ｼｮｰﾄ
44	SGTD513S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 5mm(D)×13mm(L) ｼｮｰﾄ
45	SGTD515S	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 5mm(D)×15mm(L) ｼｮｰﾄ
46	SGTD585L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 5mm(D)×8.5mm(L) ﾛﾝｸﾞ
47	SGTD510L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 5mm(D)×10mm(L) ﾛﾝｸﾞ
48	SGTD511L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 5mm(D)×11mm(L) ﾛﾝｸﾞ
49	SGTD513L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 5mm(D)×13mm(L) ﾛﾝｸﾞ
50	SGTD515L	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ 5mm(D)×15mm(L) ﾛﾝｸﾞ
51	SGTDPHT	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾂｲｽﾄﾄﾞﾘﾙ ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙ
52	SGTDPHR	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾘﾀﾞｸｼｮﾝ ﾄﾞﾘﾙ ﾎﾟ ｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙ
53	MSGIIMS	1	ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｻｰﾃﾝ ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄﾏｳﾝﾄ 3.4mm(D) ｼｮｰﾄ
54	MSGIIML	1	ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｻｰﾃﾝ ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄﾏｳﾝﾄ 3.4mm(D) ﾛﾝｸﾞ
55	SGIIM4S	1	ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｻｰﾃﾝ ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄﾏｳﾝﾄ 4.1mm(D) ｼｮｰﾄ
56	SGIIM4L	1	ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｻｰﾃﾝ ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄﾏｳﾝﾄ 4.1mm(D) ﾛﾝｸﾞ
57	SGIIM5S	1	ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｻｰﾃﾝ ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄﾏｳﾝﾄ 5mm(D) ｼｮｰﾄ

58	SGIIM5L	1	ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｻｰﾃﾝ ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄﾏｳﾝﾄ 5mm(D) ﾛﾝｸﾞ
59	SGTTAPK	1	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾎﾞｰﾝﾀｯﾌﾟｷｯﾄ
60	IMMBP	1	ｻｰﾃﾝ ﾏﾆｭｱﾙ ﾎﾞｰﾝﾌﾟﾛﾌｧｲﾗｰ 3.4mm(D)×4.1mm(P)
61	IMBP4	1	ｻｰﾃﾝ ﾏﾆｭｱﾙ ﾎﾞｰﾝﾌﾟﾛﾌｧｲﾗｰ 4.1mm(D)×5mm(P)
62	IMBP5	1	ｻｰﾃﾝ ﾏﾆｭｱﾙ ﾎﾞｰﾝﾌﾟﾛﾌｧｲﾗｰ 5mm(D)×6mm(P)
63	MDR10	1	ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ ｺﾈｸﾀｰ
64	PHD02N	1	ﾗｰｼﾞﾍｸｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ 17mm(L)
65	RASH3N	1	ﾗｰｼﾞﾍｸｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾁｯﾌﾟ 24mm(L)
66	RE100	1	ﾗﾁｪｯﾄ ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ 6mm(L)
67	RE200	1	ﾗﾁｪｯﾄ ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ 15mm(L)
68	CW100	1	ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ ﾚﾝﾁ
69	WR150	1	ﾗﾁｪｯﾄ ﾚﾝﾁ

59. ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾎﾞｰﾝﾀｯﾌﾟｷｯﾄ(SGTTAPK)内容物

品番	種類
SGTTAPT	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾎﾞｰﾝﾀｯﾌﾟﾄﾚｰ
MSGTT85S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 3.25mm(D)×8.5mm(L) ｼｮｰﾄ
MSGTT10S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 3.25mm(D)×10mm(L) ｼｮｰﾄ
MSGTT11S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 3.25mm(D)×11.5mm(L) ｼｮｰﾄ
MSGTT13S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 3.25mm(D)×13mm(L) ｼｮｰﾄ
MSGTT15S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 3.25mm(D)×15mm(L) ｼｮｰﾄ
MSGTT85L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 3.25mm(D)×8.5mm(L) ﾛﾝｸﾞ
MSGTT10L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 3.25mm(D)×10mm(L) ﾛﾝｸﾞ
MSGTT11L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 3.25mm(D)×11.5mm(L) ﾛﾝｸﾞ
MSGTT13L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 3.25mm(D)×13mm(L) ﾛﾝｸﾞ
MSGTT15L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 3.25mm(D)×15mm(L) ﾛﾝｸﾞ
SGTT485S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 4mm(D)×8.5mm(L) ｼｮｰﾄ
SGTT410S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 4mm(D)×10mm(L) ｼｮｰﾄ
SGTT411S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 4mm(D)×11.5mm(L) ｼｮｰﾄ
SGTT413S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 4mm(D)×13mm(L) ｼｮｰﾄ
SGTT415S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 4mm(D)×15mm(L) ｼｮｰﾄ
SGTT485L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 4mm(D)×8.5mm(L) ﾛﾝｸﾞ
SGTT410L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 4mm(D)×10mm(L) ﾛﾝｸﾞ
SGTT411L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 4mm(D)×11.5mm(L) ﾛﾝｸﾞ
SGTT413L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 4mm(D)×13mm(L) ﾛﾝｸﾞ
SGTT415L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 4mm(D)×15mm(L) ﾛﾝｸﾞ
SGTT585S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 5mm(D)×8.5mm(L) ｼｮｰﾄ
SGTT510S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 5mm(D)×10mm(L) ｼｮｰﾄ
SGTT511S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 5mm(D)×11.5mm(L) ｼｮｰﾄ
SGTT513S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 5mm(D)×13mm(L) ｼｮｰﾄ
SGTT515S	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 5mm(D)×15mm(L) ｼｮｰﾄ
SGTT585L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 5mm(D)×8.5mm(L) ﾛﾝｸﾞ
SGTT510L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 5mm(D)×10mm(L) ﾛﾝｸﾞ
SGTT511L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 5mm(D)×11.5mm(L) ﾛﾝｸﾞ
SGTT513L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 5mm(D)×13mm(L) ﾛﾝｸﾞ
SGTT515L	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾀｯﾌﾟ 5mm(D)×15mm(L) ﾛﾝｸﾞ

基本的形状:

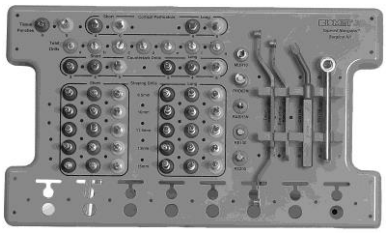

SGTIKIT

SGTTP4 SGTSP4S SGTD19A SGTCD4S SGTD485L

SGTDPHR

IMBP4 MDR10 PHD02N RASH3N RE100

WR150

CW100

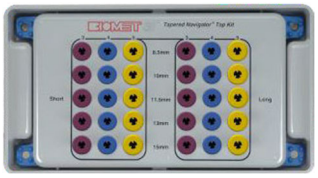

SGTTAPK

MSGTT85S

成分:

1.	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｻｰｼﾞｶﾙ ﾄﾚｰ	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
2～3.	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾃｨｯｼｭﾊﾟﾝﾁ	ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
4～7.	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｺｰﾃｨｶﾙ ﾊﾟｰﾌｫﾚｰﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
8～14.	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾂｲｽﾄﾄﾞﾘﾙ	ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
15～20.	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｶｳﾝﾀｰｼﾝｸﾄﾞﾘﾙ	ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
21～50.	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｼｪｰﾋﾟﾝｸﾞﾄﾞﾘﾙ	ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
51.	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾂｲｽﾄﾄﾞﾘﾙ ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾁﾀﾝ合金
52.	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾘﾀﾞｸｼｮﾝﾄﾞﾘﾙ ﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙ	ﾁﾀﾝ合金
53～58.	ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｻｰﾃﾝ ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄﾏｳﾝﾄ(ｼﾘﾝﾀﾞｰ部) ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ｻｰﾃﾝ ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄﾏｳﾝﾄ(ｽｸﾘｭｰ部)	ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ ﾁﾀﾝ合金
59.	ﾃｰﾊﾟｰﾄﾞ ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ ﾎﾞｰﾝﾀｯﾌﾟｷｯﾄ	ﾁﾀﾝ合金
60～62.	ｻｰﾃﾝ ﾏﾆｭｱﾙ ﾎﾞｰﾝﾌﾟﾛﾌｧｲﾗｰ	ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
63.	ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ ｺﾈｸﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
64.	ﾗｰｼﾞﾍｸｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
65.	ﾗｰｼﾞﾍｸｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾁｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
66～67.	ﾗﾁｪｯﾄ ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ	ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ
68.	ｵｰﾌﾟﾝｴﾝﾄﾞ ﾚﾝﾁ	ﾁﾀﾝ合金
69.	ﾗﾁｪｯﾄ ﾚﾝﾁ	ｽﾃﾝﾚｽｽﾁｰﾙ

【使用目的又は効果】

1. テーパード ナビゲーター サージカル トレー：
SGTIKIT の内容物を収納する。

2～3. テーパード ナビゲーター ティッシュ パンチ：
フラップレス手術のために軟組織を除去するために用いる。

4～7. テーパードナビゲーター コーティカル パーフォレーター：
無歯顎患者の顎骨内に、インプラントを埋入するための形成窩を切削する。

8～14. テーパード ナビゲーター ツイストドリル：
無歯顎患者の顎骨内に、インプラントを埋入するための形成窩を切削する。

15～20. テーパード ナビゲーター カウンターシンク ドリル：
無歯顎患者の顎骨内に、インプラントを埋入するための形成窩を切削する。

21～50. テーパード ナビゲーター シェーピングドリル：
無歯顎患者の顎骨内に、インプラントを埋入するための形成窩を切削する。

51. テーパード ナビゲーターツイストドリル ポジショニング ハンドル：所定の深度までツイストドリルをガイドするために使用する。

52. テーパード ナビゲーター リダクション ドリル ポジショニング ハンドル：
所定の深度までツイストドリルをガイドするために使用する。

53～58. ナビゲーター サーテンインプラントマウント：
サージカルガイドに埋め込まれたマスターチューブを通して、インプラントを埋入するために用いる。

59. テーパード ナビゲーター ボーンタップキット：

60～62. サーテン マニュアル ボーンプロファイラー：
インプラントに合わせて歯槽骨を取り除くために用いる。

63. ハンドピース コネクター：
インプラント用タップ及びインプラント・マウントの操作に用いる。

64. ラージヘクスドライバー：
インプラント・マウントのスクリュー及びヘクストタイプのリテイニングスクリューやユニスクリューの着脱、固定に用いる。

65. ラージヘクス ドライバー チップ：
インプラント・マウントのスクリュー及びヘクストタイプのリテイニングスクリューやユニスクリューの着脱、固定に用いる。

66～67. ラチェット エクステンション：
インプラント用タップ及びインプラント・マウントに接続し、緻密骨へのタッピングやインプラント埋入時の最終固定に用いる。

68. オープンエンド レンチ：
マウントスクリューを取り外す時に、インプラント・マウントを保持するために用いる。

69. ラチェットレンチ：
インプラントの最終固定時や緻密骨へのタッピング時に、ラチェット・エクステンションと共に用いる。

手術用ドリルビットの定義：
手動式又は動力式の手術用穿孔器に取り付ける器具をいう。適切な速度で回転させると、骨に本品の径と同じ寸法の孔が作製される。通常、「ツイストドリル」型（らせん型）であるが、平坦で斜めの刃先を持つものもある。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 使用前に必ず洗浄・滅菌を行うこと。（【保守・点検に係る事項】参照）

2. 各機器の使用方法

1. テーパード ナビゲーター サージカル トレー：
SGTIKIT の内容物を収納する。高圧蒸気滅菌が可能である。

2～3. テーパードナビゲーター ティッシュパンチ：
サージカル・ドリリング・ユニットのハンドピースに装着し、軟組織の除去に用いる。

4～7. テーパード ナビゲーター コーティカル パーフォレーター：
サージカル・ドリリングユニットのハンドピースに装着し、無歯顎患者の顎骨内にインプラントを埋入するために形成窩を切削する。

8～14. テーパード ナビゲーター ツイストドリル：
サージカル・ドリリングユニットのハンドピースに装着し、無歯顎患者の顎骨内にインプラントを埋入するために形成窩を切削する。

15～20. テーパード ナビゲーター カウンターシンク ドリル：
サージカル・ドリリングユニットのハンドピースに装着し、無歯顎患者の顎骨内にインプラントを埋入するために形成窩を切削する。

21～50. テーパード ナビゲーター シェーピングドリル：
サージカル・ドリリングユニットのハンドピースに装着し、無歯顎患者の顎骨内にインプラントを埋入するために形成窩を切削する。

51. テーパード ナビゲーター ツイストドリル ポジショニング ハンドル：手指で把持し、上部からツイストドリルを挿入し、所定の深度までツイストドリルをガイドするために用いる。

52. テーパード ナビゲーターリダクション ドリル ポジショニングハンドル：
手指で把持し、上部からツイストドリルを挿入し、所定の深度までツイストドリルをガイドするために用いる。

53～58. ナビゲーター サーテン インプラントマウント：
サージカルガイドに埋め込まれたマスターチューブを通して、インプラントを埋入するために用いる。

59. テーパード ナビゲーター ボーンタップキット：
ハンドピース又はラチェットレンチに装着したラチェット・エクステンションに接続し、形成窩のネジ切りに用いる。

60～62. サーテン マニュアル ボーンプロファイラー：
サージカルガイドを取り外した後、手指で把持し、適切にアバットメントが装着できるように、インプラントに合わせて歯槽骨を取り除くために用いる。

63. ハンドピースコネクター：
ハンドピースに装着し、インプラント用タップ及びインプラント・マウントの操作に用いる。

64. ラージヘクスドライバー：
手指で把持し、インプラントマウントのスクリュー及びヘクストタイプのリテイニングスクリューやユニスクリューの着脱、固定に用いる。

65. ラージヘクスドライバーチップ：
ハンドピースに装着し、インプラントマウントのスクリュー及びヘクストタイプのリテイニングスクリューやユニスクリューの着脱、固定に用いる。

66～67. ラチェット エクステンション：
ラチェット・レンチの先端に装着後、インプラント用タップ及びインプラントマウントに接続し、緻密骨へのタッピングやインプラント埋入時の最終固定に用いる。

68. オープンエンド レンチ：
手指で把持し、先端でインプラントマウントのシリンダーを側面から固定し、インプラントマウントの着脱、固定に用いる。

69. ラチェットレンチ：
手指で把持し、先端にラチェット・エクステンションを装着し、インプラント用タップ及びインプラントマウントに接続し、緻密骨へのタッピングやインプラント埋入時の最終固定に用いる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

1) 使用前に必ず滅菌を行うこと。

・滅菌方法

(1) サージカルトレーからバーブロックを取り外す。サージカルトレーとブロックを柔毛のブラシと弱い洗剤でブラッシング洗浄し、その後十分に水洗いする。

(2) サージカルトレーに器具類を置き、残留した洗剤や水道水中の含有鉱物を除去するために、バーとトレーにエチルアルコールを注ぐ。この操作は腐食や白い斑点を予防するために重要である。

(3) 外装が破損し器具が汚染されるのを防ぐため、サージカルトレーを紙や滅菌対応のバッグで二重に包む。

(4) 132℃～135℃で 40 分間高圧蒸気滅菌を行う。

(5) 器具を 30 分間乾燥させる。ただし、乾燥時間は滅菌する物の量によって多少の違いがある。

折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

2. 相互作用

［併用禁忌・禁止］（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社の指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されているため、正しく機能しない。よって、指定外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	指定外の製品との併用を想定していない。

3. 不具合・有害事象

本品の使用により、以下のような不具合・有害事象が発生した場合には、直ちに適切な処置を行うこと。

1)不具合

・変形、破損、磨耗

2)有害事象

・本品を用いた手術により、局所の浮腫、疼痛、術部の裂開、短期の知覚過敏、血腫あるいは出血が起こる場合がある。

・下顎の手術の場合は下唇並びに頬のしびれ、上顎の手術の場合は鼻周囲のしびれが起こるが、殆どの場合は一時的なものである。

・歯肉組織の潰瘍、組織反応、あるいは感染を起こす場合があるが、一般的には局部的治療で治癒する。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法

・室温保管

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後の洗浄・滅菌方法

・洗浄方法

1) ドリルや器具類は使用後、有機質分解剤液の入った容器に入れる。
2) 目に見える破片を除去するため、柔毛のブラシでブラッシング洗浄しながら水道水で最低2 分間すすぐ。
3) ドリルを防錆剤薬液の入った超音波洗浄器で5分間超音波洗浄する。ドリルを柔毛で再度ブラッシング洗浄する。
4) 器具を1分間水道水ですすぎ洗いする。
5) 骨片や破片が残っていないか目視検査し、必要に応じて再度洗浄する。

・滅菌方法

1) サージカルトレーからバーブロックを取り外す。サージカルトレーとブロックを柔毛のブラシと弱い洗剤でブラッシング洗浄し、その後十分に水洗いする。
2) サージカルトレーに器具類を置き、残留した洗剤や水道水中の含有鉱物を除去するために、バーとトレーにエチルアルコールを注ぐ。この操作は腐食や白い斑点を予防するために重要である。
3) 外装が破損し器具が汚染されるのを防ぐため、サージカルトレーを紙や滅菌対応のバッグで二重に包む。
4) 132℃～135℃で 40 分間高圧蒸気滅菌を行う。
5) 器具を 30 分間乾燥させる。ただし、乾燥時間は滅菌する物の量によって多少の違いがある。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

ジンヴィ・ジャパン合同会社

電話：03-4333-9900

製造業者

ZimVie US Corp LLC.

アメリカ合衆国