

機械器具 21 内臓機能検査用器具  
高度管理医療機器 重要パラメータ付き多項目モニタ 33586003  
\* 特定保守管理医療機器「生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ」の構成品  
ガスモジュール VMOD-A10  
\*\* ガスモジュール VMOD-A102

**【禁忌・禁止】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

**\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：フクダ電子株式会社


外国製造業者：Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (中国)

シンセン マインドレー バイオメディカル


エレクトロニクスカンパニーリミテッド

**【形状・構造及び原理等】**

- \*\* 本モジュールは、モニタ本体またはサテライトモジュールラックに挿入し、酸素 (O<sub>2</sub>) 濃度、二酸化炭素 (CO<sub>2</sub>) 濃度、笑気ガス (N<sub>2</sub>O) 濃度および揮発性麻酔薬 (AG) 濃度を連続的に測定するために使用します。

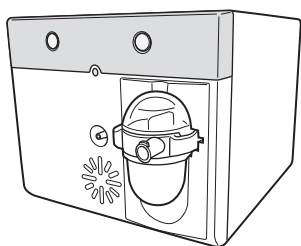

\*\* VMOD-A10



\*\* VMOD-A102

**1. 構成**

**\*\* 適用機器**

本モジュールは、以下の機器に接続して使用できます。

| 適用機器                      | 医療機器認証番号         |
|---------------------------|------------------|
| 生体情報モニタ Accumil V7000シリーズ | 22600BZX00092000 |
| 生体情報モニタ Accumil V6000シリーズ | 22600BZX00264000 |

**【使用目的又は効果】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

**【使用方法等】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

**【使用上の注意】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

**【保管方法及び有効期間等】**

接続する機器の添付文書を参照してください。

**【保守・点検に係る事項】**

接続する機器の添付文書を参照してください。



046-006188-00(4.0)

接続する機器の取扱説明書を必ずご参照ください。

4L011545A