

プロセッサ EPX-3200

*【警告】

適用対象(患者)

全身状態が極めて不良な場合、イレウス、消化管穿孔、呼吸器疾患、循環器疾患などの内視鏡検査を行うことが危険と見なされる場合には、内視鏡検査を行うことの有効性が内視鏡検査を行うことの危険性を上回る場合のみ施行すること。
[消化器内視鏡ガイドラインによる]

【形状・構造及び原理等】

<形状>

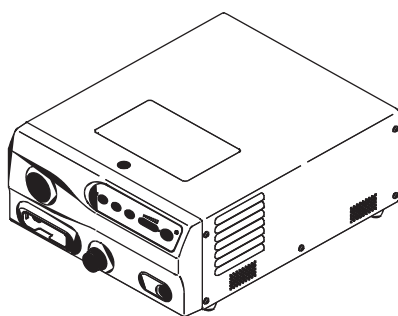


図1

1. 電気的安全性（JIS T 0601-2-18：2013）

電撃に対する保護形式：クラスⅠ機器

電撃に対する保護程度：BF形装着部

2. 電気的定格

電圧：AC100V

周波数：50/60Hz

定格電流：2.7A

3. 電磁両立性規格

本製品は、電磁両立性規格 IEC 60601-1-2:2007 に適合する。

* 4. 仕様

項目	諸元	
映像出力	DVI（解像度：1024×768画素）	
ヒューズ	T5A H 250V×2	
映像出力端子	ビデオ端子	1系統
	Sビデオ端子	2系統
	RGBビデオ端子	2系統
	DVI端子	1系統
制御用端子	リモート端子	2系統
	RS-232C端子	1系統
	キーボード端子	1系統
	フットスイッチ端子	1系統
	ネットワーク端子（10/100BASE）	1系統
その他端子	等電位化端子	1系統
最大送気圧	65kPa	
最大送水圧	65kPa	
最大光量	1.2×10 ³ lm (ファイバー入射口径3mm)	
寸法（W×H×D）	375×190×510mm (コネクタキャップ装着状態での寸法)	
質量	17kg	

5. 動作環境

温度：10～40℃

湿度：30～85%RH（ただし、結露状態を除く）

気圧：70～106kPa

<構造・構成ユニット>

1. 標準付属品

データキーボード：DK-3000

コネクタキャップ：CC-200J、CC-500J

<作動・動作原理>

1. 照明

点灯装置から供給された電源により、ランプ（主灯）が点灯する。このランプの光を集光光学系により内視鏡のライトガイド（以下、LG）に入射させる。LGから入射した光は、照明光学系を通して被写体を照明する。

2. 送気送水機能

ポンプから送られた空気は接続された内視鏡の管路に供給され、内視鏡操作部のボタン操作により、送気と送水を行う。

3. 映像信号処理機能

接続された内視鏡の CCD から出力された電気信号をビデオ信号に変換し、モニター及び周辺機器に映像信号として出力する。

4. 付帯機能

(1) 非常灯切替機能

主灯が点灯しない時に、非常灯に切替える機能

(2) 測光切替機能

測光モードを切替える機能

(3) 送気圧切替機能

送気圧を「強」、「弱」の2段階に切替および停止する機能

(4) 電子拡大機能

画像の中心部を拡大する機能

(5) 周辺機器制御機能

接続可能な周辺機器をコントロールする機能

(6) 色調調整機能

画像の色を調整する機能

(7) 情報表示機能

ソフトウェアのバージョンを表示する機能

(8) ランプ使用時間表示機能

主灯の使用時間（積算）を表示する機能

(9) 色彩強調機能

画像の一部を色で強調する機能

(10) 輪郭強調機能

画像の輪郭を強調する機能

(11) Pin P機能

画像フリーズ時に、静止画像を観察画面に表示し、動画像を小画面に表示する機能

(12) マルチスイッチ機能

プロセッサに搭載された機能から選択した機能を作動または停止させる機能

(13) ネットワーク機能

ネットワークを経由して、データの送受信を行う機能

【使用目的又は効果】

* 内視鏡に照明を供給する光源と、内視鏡を介して体腔内に送気送水を行う機能を有し、内視鏡で捉えた画像を診療のために提供すること。

【使用方法等】

＜使用方法＞

1. 内視鏡を取り付け、本製品の使用前点検を行う。
2. 本製品の電源を入れる。
3. ランプボタンを押して、ランプを点灯させる。
4. 被写体の明るさが適切になるように、輝度調節ボタンで調整する。
5. ポンプボタンで、送気圧を設定する。
6. 必要に応じて画質の調整・各種の設定を行う。
7. 検査の目的にあった適切な前処置を行ってから内視鏡検査を行う。
8. 検査終了後、本製品の電源を切り、内視鏡を取り外す。

＜組み合わせて使用する医療機器＞

本製品は、以下の医療機器と組み合わせて使用する。

販売名	認証番号
電子内視鏡 EG-530NW	221AABZX00069000

内視鏡：3000 シリーズスコープ
550 シリーズスコープ
200 システムスコープ

* ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

* 1. 準備・使用方法

- (1) 点灯中にランプを直接のぞきこまないこと。目の障害を起こすことがある。
- (2) 内視鏡の照明光を直視しないこと。
- (3) LG コネクターの先端が冷えるまで（約 5 分）、手を触れないこと。使用直後の内視鏡の LG コネクターに手を触れると、熱傷するおそれがある。
- (4) 別の手段を準備した上で観察、処置を実施すること。内視鏡システムを使用中、機器が故障するなど予測できない事象が発生するおそれがある。
- (5) 電源は、AC100V を使用すること。それ以外の電源は、火災、感電の原因となる場合がある。
- * (6) 高酸素濃度環境、可燃性ガス雰囲気中では、使用しないこと。火災や爆発を起こすおそれがある。
- * (7) 定格のヒューズを使用すること。ヒューズを交換するときは、電源プラグをコンセントから抜くこと。感電の原因となる。
- (8) 非常灯で観察、処置を実施しないこと。
- (9) 静電気防止のため、内視鏡に触れるときは、保護具を着用すること。

* 2. 準備と点検

- (1) 本製品が故障するなど不測の事態に備えて、使用前に本製品の予備を用意すること。内視鏡手技を継続できない場合がある。
- (2) 組み合わせて使用する周辺機器の電源をカートの絶縁トランスを介さないで接続した場合、外装漏れ電流が増加し、患者および術者が機器に接触したとき、感電したり、傷ついたりするおそれがある。
- (3) システムを構成する機器の端子と患者を同時に触らないこと。感電するおそれがある。
- (4) ネットワークを使用する場合、機器に接続している LAN ケーブルとネットワークシステムの間に IEC60601-1 に適合した分離装置を挿入すること。接続されるネットワークシステムからの漏れ電流や接地間に生じる電位差により、外装漏れ電流が増加し、患者および術者が機器に接触したとき、感電したり、傷ついたりするおそれがある。

3. 機器の組み合わせ

- (1) 感電事故を防止するために本製品の取扱説明書に記載の機器を EPX-3200 設置マニュアルに基き接続・設置してから使うこと。

* 4. 機器の設置

- * (1) 感電事故や機器の落下を防止するため、次の注意事項を守ること。
 - 1) 感電事故の防止
 - ・EPX-3200 の電源プラグは、カートの「プロセッサ・光源装置用コンセント」に直接差し込む。
 - ・電気焼灼器の電源は、カートからとらない。
 - ・2 台目のカートの電源を 1 台目のカートからとらない。
 - ・3 芯 2 芯変換プラグは、使用しない。
 - ・カートのコンセントには、システムを構成する機器以外は接続しない。
 - ・床置きマルチタップから電源をとらない。
 - ・2 つ目のマルチタップの電源を 1 つ目のマルチタップからとらない。
 - ・マルチタップには、システムを構成する機器以外は接続しない。
 - ・カートのコンセントには、マルチタップまたは延長コードを接続しない。
 - 2) 機器の落下の防止
 - ・周辺機器を重ねて載せない。
 - ・機器の足が、ストッパーの内側に収まるように載せる。
 - 3) 雷による誤作動の防止
 - ・病院、診療所の構造設備に適合した電源に接続すること。

5. 機能の喪失

- * (1) 検査中に内視鏡画像の異常（消える、暗くなる、明るくなるなど）があった場合は撮像部が損傷している可能性がある。エラーメッセージが表示されている場合はそれに従い、表示されていない場合は、使用中のスコープの取扱説明書に従って、内視鏡をゆっくり抜去すること。
- * (2) 処置中に内視鏡画像が消える場合、内視鏡画像のフリーズが解除しない場合、内視鏡画像が変色する場合は、直ちに処置を中止し処置具を内視鏡からゆっくりと抜去すること。内視鏡から処置具を抜去しても内視鏡画像が復帰しない場合は、使用中のスコープの取扱説明書に従って、内視鏡をゆっくり抜去すること。
- * (3) 直ちに使用を中止し、営業所またはお買い上げの代理店のサービス窓口に連絡すること。そのまま使用を続けると、内視鏡先端部が発熱し、熱傷の原因となるおそれがある。
- * (4) 電源を再投入する場合は、5 秒以上おいてから行うこと。

6. 保管とメンテナンス

- (1) 点灯時間が 300 時間を越えた主灯は使用しないこと。ランプが破裂して、機器が損傷するおそれがある。
- (2) 点灯時間が 300 時間を越えたら、本製品の取扱説明書の手順に従って主灯の交換を行うこと。
- (3) 消灯直後のランプには手を触れないこと。使用後 60 分間は、交換作業を行わないこと。熱傷のおそれがある。

7. 内視鏡先端部の温度

- (1) 内視鏡をカートのハンガーに掛けておく場合は、ランプを消灯すること。長時間、内視鏡の先端より大光量で照明光を射出していると、先端部の温度が 41℃を超える場合がある。

8. 機器の運搬

- (1) 本製品の重量は、運搬の際に物理的な傷害を引き起こすおそれがある。運搬するときは、二人で行うこと。
- (2) 本製品を移動する場合は、段差、傾斜に注意して、振動、衝撃を与えないように搬送すること。

9. コネクターキャップ

- * (1) 使用時は空いているビデオコネクターに付属のコネクターキャップを装着すること。また、コネクターキャップが濡れたまま使用しないこと。故障の原因となる。

10. 電源

- (1) 電源は定格の電圧を使用すること。故障の原因となる。

取扱説明書を必ずご参照ください。

FV518A

202B1223409H

1908-9.0-FFTP

【使用上の注意】

** <使用注意>

1. 本装置は、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに準拠した環境のネットワークで使用する。
2. ネットワークに接続した環境で使用する場合は、コンピュータウイルス及び情報の漏洩等に注意すること。
3. セキュリティの確保された病院内のネットワークに接続して使用すること。

<重要な基本的注意>

* 1. 電磁波に関する注意事項

- * (1) 本製品は試験の結果、IEC 60601-1-2 : 2007 に規定されている医療機器に関する制限事項に適合することが確認されている。これらの制限事項は、一般的な医療施設での設置の際に、有害な電磁干渉に対して適切な保護を提供するように設定されている。しかしながら、本製品は、本製品の取扱説明書に従って設置使用された場合においても、周辺にある他の装置に有害な干渉を起こす可能性がある。また、特定の設置状況において干渉が生じないことを保証するものではない。したがって、本製品が他の装置に有害な干渉を起こすことが判明した場合、これは本製品の電源のオン・オフを切り替えることで確認できるが、干渉を是正するために以下の措置の 1 つ以上を実施することを推奨する。
- 干渉を受けている装置の向きを変えるか、位置を変えること。
 - 機器間の間隔を拡げること。
 - 製造販売業者または販売業者に相談すること。
- また、電磁波の影響でモニター上にノイズが現れる場合がある。このときは電磁波を発生している装置の電源を切るか、遠ざけること。本製品の取扱説明書に記載されているケーブルを使用すること。記載されていないケーブルを使用すると、本製品の電磁エミッションの増加、または電磁イミュニティの低下を生じるおそれがある。



<不具合>

- (1) 主灯、非常灯の両方が点灯しない場合には、プロセッサの電源を切り、内視鏡のわん曲部を真っ直ぐにしアングルロックをフリー状態にして、アングルつまみから手を離しゆっくりと内視鏡を抜去すること。
- (2) 下記の場合は非常灯が使用できない。
 - 主灯が過熱して、安全装置が作動した場合
 - 主灯を空冷しているファンおよび点灯装置の内部を空冷しているファンが停止して、安全装置が作動した場合
 - 点灯装置が故障した場合
 - 非常灯が切れた場合

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

本製品は、以下の条件を満たす所で保管すること。

保管条件

温度：-10～45℃

湿度：30～95%RH（ただし、結露状態を除く）

気圧：70～106kPa（大気圧範囲）

状態：ケーブルに力の加わらない状態

<耐用期間>

耐用期間は適切な保守点検を行った場合、使用開始から 6 年間とする。

「自己認証（当社データ）による」

【保守・点検に係る事項】

1. 使用者による保守点検の詳細は、取扱説明書を参照すること。
2. 業者による保守点検の詳細は、営業所またはお買い上げの代理店のサービス窓口にお問い合わせのこと。

* <使用者による保守点検事項>

点検項目	点検時期
スコープ接続の確認	検査前
プロセッサの動作確認	検査前

長期間使用していると機器の傷みが進むため、6 ヶ月に一度またはランプの使用時間が 300 時間を越えたら、専門家による点検を受けること。また、少しでも機器に異常を感じた場合も同様に点検を受けること。点検の結果、修理またはオーバーホールが必要であれば本製品の取扱説明書に記載のサービスセンターに依頼すること。

検査中または処置中に、本製品の保守や修理を行わないこと。

1. 清掃

- (1) 本製品の取扱説明書およびデータキーボード取扱説明書の手順に従って清掃を行うこと。

2. 主灯の交換

- (1) 本製品の取扱説明書の手順に従って主灯の交換を行うこと。

<業者による保守点検事項>

点検項目	頻度
外観点検	6 ヶ月毎
プロセッサの機能点検	6 ヶ月毎
映像信号、制御信号入出力点検	6 ヶ月毎
ライト、ポンプ出力点検	6 ヶ月毎
バージョン確認	6 ヶ月毎

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

富士フイルム株式会社

TEL：0120-771669

販売業者

富士フイルムメディカル株式会社

TEL：03-6419-8033

サイバーセキュリティに関する情報請求先

<<製造販売業者と同じ>>

取扱説明書を必ずご参照ください。

FV518A

202B1223409H

1908-9.0-FFTP

取扱説明書を必ずご参照ください。

FV518A 202B1223409H
1908-9.0-FFTP