


【警告】

ブラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者において、実際の血糖値より高値を示すおそれがあるので、ブラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者における血糖測定値に対する影響について、事前に製造販売業者から情報を入手すること。〔ブラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者で、実際の血糖値よりも高値を示すことがあり、その偽高値に基づきインスリン等の血糖降下剤を投与することにより、昏睡等の重篤な低血糖症状があらわれるおそれがある。〕

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本医療機器は分析部と操作部から構成され、オプションにて電解質測定装置（ISE）を接続することができます。

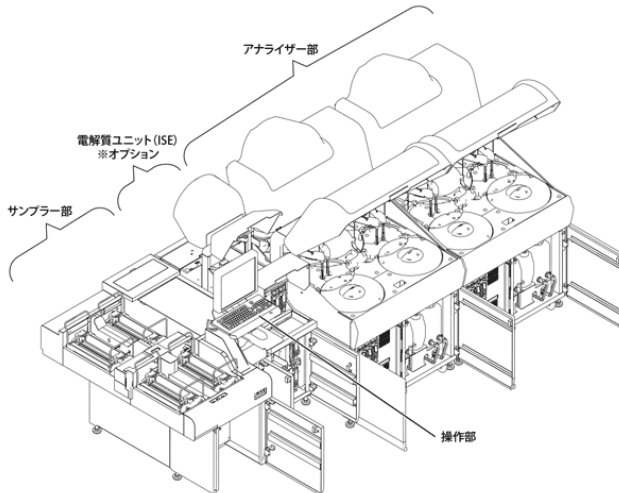

本医療機器はEMC 規格JIS C1806-1：2010 に適合しています。

2. 寸法・重量

1) アナライザー（ANL）

1,060 (W) × 1,580 (D) × 1,260 (H) mm、約600 kg

2) サンプラー（SMP）

1,090 (W) × 1,500 (D) × 1,600 (H) mm、約320 kg

3) 電解質測定装置（ISE）

450 (W) × 1,140 (D) × 1,210 (H) mm、約150 kg

4) 装置全体

1ユニット機：2,150 (W) × 1,580 (D) × 1,600 (H) mm、約920 kg

2ユニット機：3,210 (W) × 1,580 (D) × 1,600 (H) mm、約1,520 kg

3ユニット機：4,270 (W) × 1,580 (D) × 1,600 (H) mm、約2,120 kg

4ユニット機：5,330 (W) × 1,580 (D) × 1,600 (H) mm、約2,720 kg

上記寸法・重量はISE（オプション）を含まない数値です。
ISEを含む場合、幅(W)+450 mm 重量+150 kg。

3. 電気的定格

1) 定格電圧

単相 AC200 V (±10%)

2) 周波数

50 Hz/60Hz±3%

3) 消費電力

6 kVA (1ユニット機の場合)

8 kVA (2ユニット機の場合)

10 kVA (3ユニット機の場合)

12 kVA (4ユニット機の場合)

4) 電撃に対する保護の形式

クラスⅠ機器（永久設置形機器）

■詳細は取扱説明書「2 使用上の注意、設置環境及び仕様」をご参照ください。

4. 動作原理

本医療機器は、検体（血清、血漿、尿）中の化学成分を測定する生化学自動分析装置です。検体分注、試薬分注、検体と試薬の混合（攪拌）、恒温反応後にその検体の吸光度を測定し、その吸光度に基づき濃度値が算出されます。検体の分注、攪拌、測光などの工程は自動的に行われます。

また、オプションの電解質測定部（ISE）は、特定のイオンに選択的に感応するイオン選択性電極とREF電極に検液を通過させ、両電極間の電位差を測定する装置です。

■詳細は取扱説明書「3 システム概要」をご参照ください。

【使用目的又は効果】

用手法による臨床化学分析法を忠実に自動化した装置である。測定は個別のキュベットで行われターンテーブルで運ばれる途中に各ステーションで試料、希釈液及び試薬が調合される。混合、発色のための時間が考慮されており、その後内蔵されている分光光度計で反応混合物の吸光度を測定する。

【使用方法等】

1. 設置条件

機器を安全に正しく使用するために、機器の設置は当社のフィールドサービスエンジニアが行います。

2. 使用方法

本医療機器の使用法の概要を以下に示します。

- 1) イオン交換水の元栓を開け、洗剤がセットされていることを確認後、電源を入れてください。
- 2) 分析前の装置点検を行ってください。
- 3) キャリブレーション分析の受付を行い、検量線を作成してください。尚、キャリブレーション分析は使用する試薬の添付文書に従い実行してください。
- 4) 試薬がセットされていることを確認してください。
- 5) 精度管理分析の受付を行い、コントロール検体を測定し、測定結果に異常がないことを確認してください。コントロール検体は1日に2回以上、濃度の異なる2つのコントロール検体を同時に測定することをおすすめします。
- 6) 通常分析の受付を行ってください。
- 7) 検体とラックを用意し、ラックをサンプラー部にセットしてください。
- 8) 分析をスタートしてください。
- 9) 分析結果の確認をしてください。分析結果は操作部のモニタに表示されます。また、プリンタ（オプション）にも印字可能です。得られた分析結果と、少なくともその前後に得られたコントロール検体の測定結果に異常がないことを確認してから、分析結果の報告を行ってください。
- 10) 動作終了後、終了処理を行い電源を落とし、イオン交換水の元栓を閉めてください。

■詳細は取扱説明書「2 使用上の注意、設置環境及び仕様」、「3 システム概要」、「5 分析の準備」、「6 分析を実行する」をご参照ください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意事項

- 1) 本医療機器の動作中は動作部に触れたり開口部に指や手を入れないでください。
- 2) 万一、試薬や水等が本医療機器内部にかかったときは、直ちに電源を落としてください。
- 3) 異常なノイズを発する装置が近くにない場所に本医療機器を設置してください。
- 4) 本医療機器が設置されている部屋では携帯電話や携帯無線などの電源を切るようにしてください。

この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください

- 5) 本医療機器は防爆形ではないので、機器の近くで可燃性及び爆発性気体を絶対に使用しないでください。

2. 相互作用

消耗品は当社が推奨する製品を使用するようにしてください。
当社が推奨する製品以外の消耗品を使用した場合には、本医療機器の性能及び安全性が低下することがあります。

3. 不具合・有害事象

- 1) 検体に貼り付けるバーコードラベルの誤読、不読を防ぐため、バーコードラベルは規格どおりに作製してください。
- 2) イオン交換水、洗浄液が正しく供給できるように、タンク内のチューブは浮きがないことを確認してください。
- 3) 本医療機器で使用する検査薬及び洗剤の中には、強酸、強アルカリのものがあります。直接手で触れたり衣服にかけたりしないように十分注意してください。
- 4) 検体の取違えを防止するため、シーケンシャル分析を行う場合には、以下の事項に特にご注意ください。
 - ・分析開始前に必ず開始サンプルNo.の確認を行ってください。
 - ・赤ラックをシーケンシャル分析で使用する際は、測定データがセットした検体に対応していることをワークシートなどで確認してください。
- 5) 検体の取違えを防止するため、自動で再検を行う場合には、分析が完了していないラックと同じラックIDのラックを2本以上セットしないでください。
- 6) ラテックス試薬を用いるとキュベットを汚す場合があります。キュベットが汚れた場合はアルカリ洗剤を使用してください。
- 7) サンプル分注シリンジ及び試薬分注シリンジを交換した際には、シリンジ内及び配管内の泡抜きを実施して、気泡がないことを充分確認してください。
- 8) サンプルカップにサンプルを分注するときは、サンプルの中に気泡を混入させないようにしてください。気泡が混入した場合は取り去ってください。
- 9) 試薬ボトル内の泡による誤検知を防止するため、試薬又は洗剤をセットする場合には以下の点にご確認ください。
 - ・試薬又は洗剤を充填する場合、15mL、30mL、60mL及び180mLの当社指定ボトルは、一番上の目盛を上限としてください。
 - ・試薬を入れた後、ボトル内に泡がないことを確認してください。
- 10) 検体量が少なく、20項目以上の分析を行う場合には、サンプルブロープの洗浄水の持ち込みにより僅かですが測定結果が低値になる場合があります。可能な限り、分析に必要な量よりも多い検体量の確保をお願いします。
- 11) 分析結果に測光0D値に関わる異常値記号(*, ?, @, D, B, !)が出力され、かつ異常値記号出力前後のリアクションデータに異常がみられる場合は、キュベットの洗浄液溢れの恐れがありますので、キュベット及びキュベット洗浄ノズルの状態の確認と、異常値記号出力前後の分析結果を再確認してください。

4. 臨床検査結果に及ぼす影響

- 1) 検体の取扱い
 - ・測定状態にある検体は移動させないでください。誤報告をする恐れがあります。
 - ・使用する採血管及びサンプルカップは、当社が指定する規格の製品を使用してください。
 - ・血清中に浮遊するフィブリン、ゴミがプローブや配管に詰まる可能性があります。本医療機器にセットする前に、浮遊するフィブリン、ゴミを除去してください。
1項目でも詰まりを検出した場合には、その検体の全てのデータを確認してください。
 - ・高粘度検体の測定では、正しいデータが得られない場合があります。
 - ・血清分離剤の入った採血管を使用する際は、分離剤がサンプルブロープに入り込まないよう血清量が十分ご注意ください。
 - ・正しくサンプリングできるように、適切な量をセットしてください。
 - ・本医療機器は、検体として血清、血漿、尿以外は使用しないでください。
 - ・尿検体中に浮遊物が認められた場合は、遠心分離して尿中の浮遊物を沈殿させてからご使用ください。
 - ・異常な色調を有する検体は測定に影響を与え、正しいデータが得られない場合があります。
 - ・検体中に共存する化学物質（内因性代謝物、薬剤、抗凝固剤、防腐剤など）により、臨床的に有意な干渉を受ける場合があります。

2) 試薬の取扱い

- ・測定中は、測定用試薬を追加、交換しないでください。
- ・測定用試薬を追加、交換した際には必ずキャリブレーションを取り直してください。
- ・試薬ボトルについては、弊社当社試薬の分注不良による誤データの原因となります。
- ・測定用試薬が他の試薬によって汚染され、分析結果に影響を与える場合があります。詳細については当該検査薬製造販売業者にお問い合わせください。

3) データの管理

- ・本医療機器の使用に際しては、キャリブレーションと精度管理を実施して、得られた分析結果と、その前後に得られたコントロール検体の測定結果に異常がないことを確認してください。
- ・メンテナンス等において、光源ランプ、電極などの主要部品を交換した場合は、必ずキャリブレーションを実施してください。

5. その他の注意

- 1) ランプ交換は電源を落とし、しばらく経ってから行ってください。
- 2) キーボードを繰り返し長時間使用しないでください。手や腕などに神経障害を生じる恐れがあります。
- 3) 保守点検時はブロープなどの可動部に注意してください。けがや感染の恐れがあります。
- 4) 設置状態を変更する際は、当社サービス部門又は販売部門に連絡してください。
- 5) 本医療機器を廃棄する際は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、特別管理産業廃棄物となりますので、法律に従い、適正な処理を行ってください。
- 6) 廃液については、「水質汚濁防止法」「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「感染性廃棄物処理マニュアル」に従って適正に処理を行ってください。なお、各試薬に含まれる物質のうち、「公害防止条例」や「排水基準」で規制されている物質については、それぞれの当該検査薬製造販売業者に問い合わせた上、処理してください。
- 7) 故障したときには、取扱説明書に明示された範囲で責任者が処理し、それ以外の故障は当社サービス部門に連絡してください。
- 8) 本医療機器の使用後には次の事項に注意してください。
 - ・機器は次回の使用に支障のないように必ず清掃してください。
 - ・イオン交換水の元栓は必ず閉めてください。
- 9) 測定用試薬の組み合わせによっては、廃液が沈殿し、廃液配管の詰まりの原因となる場合があります。詳細については当該検査薬製造販売業者にお問い合わせください。
- 10) 本医療機器の操作部について、機器の操作以外の目的では絶対に使用しないでください。コンピュータ部分にコンピュータウイルスを受け入れてしまう可能性があります。本医療機器に使用可能な記憶媒体はフロッピーディスク、CD-R、USBハードディスクです。
上記記憶媒体を使用する場合、事前に適切な手段を用いることでコンピュータウイルスに感染していないことを確認の上、使用してください。

■詳細は取扱説明書「1 はじめに」、「2 使用上の注意、設置環境及び仕様」をご参照ください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 設置環境（温度・湿度等）
 - 1) 周囲温度は18～32℃、測定中の温度変動許容幅は4℃以内で使用してください。
 - 2) 湿度は20～80%RHで本医療機器に結露を起こさない範囲で使用してください。
2. 耐用期間
使用開始（据付）後、7年又は2,100万テスト/ユニット〔自己認証（当社データ）による〕

■取扱説明書に示す保守点検を定期的実施し、点検結果により修理又はオーバーホールが必要であれば実施してください。

■取扱説明書の保守・点検に係わる事項に記載の保守部品を定期的に交換してください。

【保守・点検に係る事項】

以下に示す周期は、1日10,000テスト（1SEについては1日200検体）の割合で分析を行った場合を目安にしています。実際には本医療機器の使用状況に応じて保守点検を行ってください。

この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください

** 1. 使用者による保守点検事項

メンテナンス手順	頻度
シリンジの液漏れを点検する	毎日
上カバーの状態を確認する	
サンプルブローブ、試薬ブローブ、攪拌棒の点検、清掃、プライムを実施する	
サンプル前希釈液ボトルのイオン交換水又は希釈液を交換する	
サンプルブローブ用洗剤水を交換する	
プリンタと用紙を確認する	
希釈洗剤水タンクのハンドルが開位置にあるかを点検する	
ISEサンプルブローブを点検、洗浄、プライムする (ISEオプション)	
ISEを洗浄する (ISEオプション)	
ISEをキャリブレーションする (ISEオプション)	
サンプルブローブと攪拌棒を洗浄する	毎週
W2を実行する	
フォトキャリブ測定を実行する	
サンプル前希釈液ボトルを洗浄する	
Na、K電極の選択性チェック (ISEオプション)	2週間毎
電極ラインの自動強化洗浄 (ISEオプション)	
ISE攪拌棒、液面センサ、サンプルポット、サンプルポット電極ブロック間チューブを手動で洗浄する (ISEオプション)	1箇月毎
サンプルブローブと試薬ブローブ洗浄槽を洗浄する	
攪拌棒洗浄槽を洗浄する	
洗浄ノズル部を洗浄し、チューブ取付ジョイント部を点検する	2箇月毎
イオン交換水タンク、イオン交換水フィルタ、サンプル内洗浄水フィルタを清掃する	
ISE REF電極内液を点検、補充する (ISEオプション)	3箇月毎
エアフィルタを清掃する	
イオン交換水フィルタ、サンプル内洗浄水フィルタ、Oリングを点検し、必要に応じて交換する	
検液吸引ペリスタチューブとMID液分注ペリスタチューブを交換する (ISEオプション)	
サンプルポット電極ブロック間チューブとTコネクタを交換する (ISEオプション)	
REF電極ブロック側ドレインチューブとピンチバルブチューブを交換する (ISEオプション)	
ドレイン槽を手動で洗浄し、必要に応じてドレインチューブを交換する (ISEオプション)	
手動による電極ラインの強化洗浄 (ISEオプション)	
キューベットとキューベットホルダを洗浄する	
Na、K、Cl電極を交換する (ISEオプション)	
洗浄水供給用チューブ取付ジョイント部Oリングを交換する	1年毎
ISE REF電極とパッキンを交換する (ISEオプション)	2年毎
第1及び第2試薬ブローブを洗浄する	必要時
サンプルブローブを交換する	
試薬ブローブを交換する	
攪拌棒を交換する	
吸引チューブ取付ジョイントパッキンを交換する	
サンプルシリンジ、試薬シリンジ、ISEサンプルシリンジ、ISEバッファ液シリンジを交換する	
洗浄水シリンジタイプ1を交換するあるいは、洗浄水シリンジタイプ2を交換する	

試薬保冷库を清掃する	
除電ブラシを清掃、あるいは交換する	
サンプルブローブ、試薬ブローブの配管チューブを交換する	
光源ランプを交換する	
サンプルポットを交換する (ISEオプション)	
ISE電極ブロック (入口側) を清掃する (ISEオプション)	
ISE K電極を手動で洗浄する (ISEオプション)	
ISE REF電極ブロックを手動で洗浄、交換する (ISEオプション)	
ISE攪拌棒を交換する (ISEオプション)	
ISE用試薬を交換する (ISEオプション)	

■保守、点検の詳細手順、交換部品は取扱説明書「8 メンテナンス」をご参照ください。

*** 2. 業者による保守点検事項

保守点検項目	方法	頻度
イオン交換水、洗浄液タンクのフロートSWの点検	動作確認	6箇月毎
洗浄系チューブの点検	清掃	
廃液系チューブの点検	清掃	
ラック搬送面の点検	清掃	
ラック搬送状態	動作確認	
保冷库窓の点検	清掃	
反応槽部の点検	クーラント液量の確認	
サンプルバーコードリーダーの点検	清掃	
試薬バーコードリーダーの点検	清掃	
ラックIDバーコードリーダーの点検	清掃	
総合動作の点検	動作確認、データ確認	12箇月毎
試薬、サンプルブローブ移送器の点検	清掃、注油、停止位置の確認	
サンプル、試薬分注器の点検	清掃、注油	
ISE分注器の点検	清掃、注油	
ISE用静電センサの点検	動作確認	
電源の点検	清掃	
冷却器部の冷却フィン・冷却ファンの点検	清掃	
パソコンのCPU Cooling Fan and Heat sinkの点検	清掃	
廃液ポンプの点検	ベン、ダイアフラム、Oリングの交換	
真空ポンプの点検	ベン、ダイアフラムの交換	36箇月毎
イオン交換水ポンプの点検	交換	
脱気装置の点検	脱気膜の交換	
希釈洗剤ポンプの点検	交換	
希釈洗剤作成ポンプの点検	交換	60箇月毎
パソコンのバッテリーの交換	交換	
液面検知ケーブル及びチューブの点検	交換	
恒温液循環ポンプの点検	交換	

この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください

****【製造販売者及び製造業者等の氏名又は名称等】**

*** [製造販売業者]**

〒135-0063

東京都江東区有明三丁目5番7号 T0C有明ウエストタワー

ベックマン・コールター株式会社

フリーダイヤル：0120-566-730

[製造業者]

ベックマン・コールター・三島株式会社

この電子化された添付文書をよく読んでから使用してください