

医療用品 4 整形用品
高度管理医療機器 体内固定用大腿骨髄内釘 33187000
(体内固定用ネジ 16101003)

IPT ネイルシステム (ネイル ロング (遠位 3 穴))

再使用禁止

【警告】

抜去するまで患者に対して十分に術後指導をすること。
[術後、骨癒合前に過負荷を与えると折損等がおこり、
不具合発現の危険性が高まる恐れがある。]

【禁忌・禁止】

再使用禁止

[適用対象 (患者)]

金属や異物に対する重篤なアレルギーがある患者に
使用しないこと。[「不具合」の項参照]

[併用医療機器]


他社製のインプラント及び材料の異なるインプラントと
併用しないこと。[「相互作用」の項参照]

【形状・構造及び原理等】

1. 組成

チタン合金 (ASTM F136)

2. 形状・構造・原理

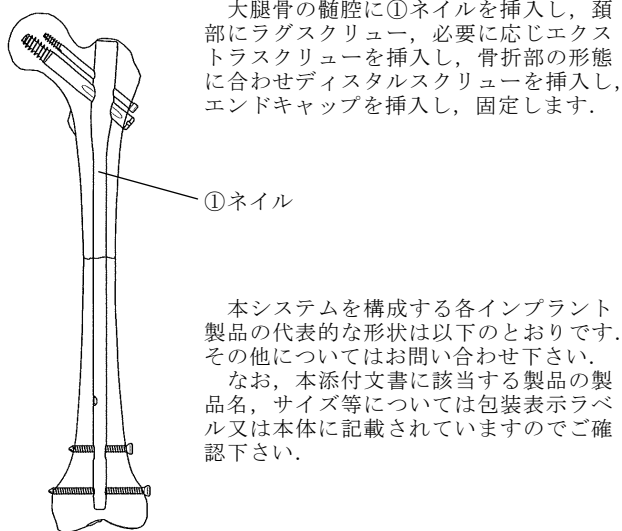

①製品名：ネイル 130° ロング 左/右



【使用目的又は効果】

1. 使用目的又は効果

大腿骨転子部骨折、大腿骨転子間骨折、大腿骨転子部貫通骨折、大腿骨骨幹部骨折、リビジョンにおける骨固定。

2. 使用目的又は効果に関連する使用上の注意

各ネイルの適応症例は次のとおりです。

・ロングネイル：


大腿骨転子下骨折(※)、大腿骨骨幹部骨折(※)、リビジョン

※若年者など骨量の豊富な症例では、ラグスクリュー挿入が極めて困難な場合がありますので、症例に応じてインプラントの選択を充分にご検討下さい。


【使用方法等】

1. 使用時

- 大腿骨大転子頂部よりオウル等にてネイル挿入口を開窓します。(図 1)
- ターゲットデバイスにネイルを接続し、髄腔へ挿入します。(図 2)
- ガイドピン の 刺入後、ステップリーマーにて大腿骨頸部をリーミングし、ラグスクリュー及び必要に応じエクストラスクリューを挿入します。(図 3)

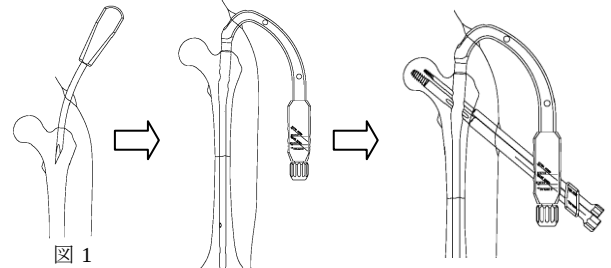


- 骨折形態によって必要に応じ、大腿骨骨幹部外側よりドリルにて穴あけを行い、ディスタルスクリューを挿入します。(図 4)
- ラグスクリューの回旋止め及び軟部組織の侵入を防ぐため、ネイルにエンドキャップを挿入し固定します。(図 5)

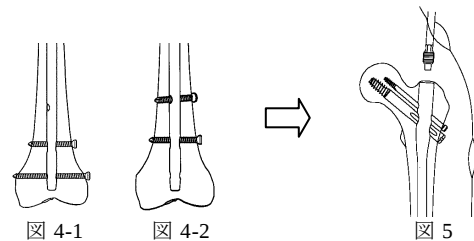


2. 使用後

原則としてその患者の症状に合わせ術後骨癒合が起こった後に抜去します。


- T レンチ又はドライバーにてエンドキャップを抜去し、ディスタルスクリューを抜去します。(図 6)
- T レンチを用いてエクストラスクリューを抜去します。(図 7)

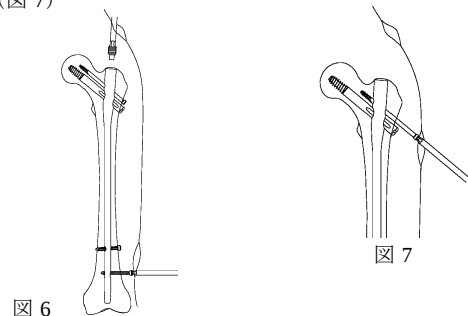

- 抜去ハンドルをネイルに固定し、抜去用 T レンチをラグスクリューに固定し、抜去ハンドルを把持しながらラグスクリューを抜去します。(図 8)
- 抜去ハンドルを回しながら、必要に応じスライドハンマーを組み付け、ネイルを抜去します。(図 9)

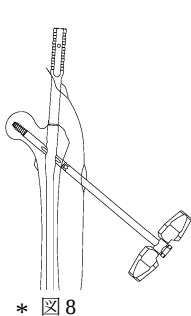

* 図8



* 図9

3. 使用方法等に関連する使用上の注意

- **1)** 患者の体質や解剖学的構造を考慮し、適切なサイズのインプラント材料を選択して下さい。
[不適切な場合、不具合・有害事象発現の可能性があります。]
- 2) 使用する際には必ず専用の手術器具を使用して下さい。また、傷をつけないようにして下さい。
- 3) 患者に埋め込んだ製品のトレーサビリティが確認できるように、患者のカルテに使用した製品の製品名、製品番号およびロット番号を記載して下さい。
- 4) ガイドピンが意図しない方向に進んで周囲の組織内に進入しないように、イメージインテンシファイヤー（X線透視）を用いて、ガイドピンの位置を頻繁に確認して下さい。
- *5)** インプラントの際、打撃したり、無理に挿入しないで下さい。
[インプラント又は手術器具が変形、破損する恐れがあります。]
- **6)** エンドキャップの締結は、ラグスクリューの回旋防止及び緩み防止の為、専用の手術器具で確実に行って下さい。
[ネイル内蔵のセットスクリューとラグスクリュー溝との係合、又はエンドキャップ締結力が不十分な場合、ラグスクリューの回旋又は移動、エンドキャップの緩み又は脱落が生じて不具合・有害事象発現の可能性がある恐れがあります。]
- *7)** 挿入／抜去の際は、専用の手術器具を正しく接続するとともに、周囲の神経や血管を損傷させないようにイメージインテンシファイヤー（X線透視）で確認しながら、慎重に行ってください。
- 8) 抜去する際は、製品／抜去器具に無理な力が加わらないよう慎重に使用して下さい。
[過度の負荷により、製品／抜去器具が破損する恐れがあります。]
- 9) スクリュー挿入／抜去の際は、スクリューのヘッドドライブに対してドライバー軸を傾けないよう軸直に操作して下さい。
[傾けた状態でのドライバー操作によりヘッドドライブが破損する恐れがあります。]

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- 1) 感染症を有する患者〔感染巣の転移や敗血症併発の恐れがあるため〕
- 2) 本製品を使用するための十分な骨量、骨質を有していない患者〔十分な固定が得られず、骨折治癒が遅れ、再骨折やインプラントの破損の不具合発現の可能性があるため〕
- 3) 重度の粉碎骨折、転位、その他処置の困難な骨折の患者〔インプラントが適切に機能しない恐れがあるため〕
- 4) 骨粗鬆症の患者〔骨との固定が十分でない、または骨癒合の遅れにより、不具合発現の可能性があるため〕
- 5) 神経障害、精神障害、アルコール中毒、薬物依存症等、術後の指導管理が十分に行えない患者〔医師の指導に従えず術後管理が十分に行えないため、治療が長期化し、不具合発現の可能性があるため〕
- 6) 術後、医師の指導に従わない患者〔十分な術後治療を行えないため、不具合発現の可能性があるため〕
- 7) 糖尿病などの生活習慣病、慢性関節リウマチ患者〔骨形成が阻害され、骨癒合が遅れることにより、不具合発現の可能性があるため〕
- 8) てんかんの患者〔医師の指導に従えず術後管理が十分に行えないため、不具合発現の可能性があるため〕
- 9) 肥満体の患者〔患者の負荷のため、骨との固定に失敗したり、インプラントの変形や破損により、不具合発現の可能性があるため〕

2. 重要な基本的注意

- 1) 本製品は人体と同等の能力を持つものではなく、強度を過信したり、またその使用法を誤ると破損する恐れがあるため、以下の点を十分ご理解の上、適切な種類を使用して下さい。
[金属製インプラントは鋭く変形、又は同一部分で繰返し変形させたり、削って表面に傷をつけると、当該部分に応力割れや金属疲労による破壊を生じる恐れがあります。]
[金属製インプラントの長さ、幅、厚さ、太さ等が不適当な場合、想像以上のストレスが加わり、金属疲労による破壊を生じる恐れがあります。]
[ドリルによる穴あけや、スクリューを挿入する際にネイルに傷をつけると、当該部分に応力が集中し、強度が低下する場合があります。]

- *2)** 本製品は、骨折部の正しい整復位を獲得した後、又は骨欠損部がある場合は適切な骨移植等を行った後に使用して下さい。
[これらが適切でないと、骨折部の転位が悪化した場合も含め、インプラントは想像以上のストレスを受け、緩み、脱転、変形、Z-effect 又は破損等を生じる恐れがあります。]
- *3)** 手術後、リハビリ等を行う際は、患者に対し本製品の機能的な限界（製品の破損等）を説明すると同時に、十分な指導のもと実施して下さい。また、定期的なレントゲン撮影等を含め術後の骨の状態及びインプラントの状態を十分に観察して下さい。
[リハビリの際に、転倒等による過度の荷重を受けることによりインプラントの変形や破損等が生じ、インプラントの破損に伴う再骨折が生じる恐れがあります。また、リハビリ時の動きなどにより、骨折部の再転位やインプラントの脱転、Z-effect などを生じる恐れがあります。]
[骨癒合の遅れ、又は骨癒合不全が認められた場合、或いは骨折治癒過程（骨折部の再転位を含む）に異常が認められた場合、直ちにインプラントの抜去・置換等、適切な処置を施して下さい。インプラントは長期にわたる繰返し負荷により緩み、脱転、変形、金属疲労による破損が生じる恐れがあります。]
- 4) 本製品は骨癒合後、原則として抜去して下さい。また手術後、本製品を留置することで不具合が生じた場合は適切な処置を行って下さい。
[骨癒合後は、本製品の機能的効果はなく、むしろ様々な合併症を引き起す可能性があります。]
[本製品を抜去する場合は、患者に対する潜在的なリスクを考慮する必要があります。]
[骨代謝の活発な患者や若年層に使用した場合は、本製品を不必要に長期間留置すると製品の抜去が行えなくなるなど特有の不具合が生ずる可能性があります。]
- **5)** 本品については、試験によるMR安全性評価を実施していません。

3. 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

1) 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・処置方法	機序・危険因子
・他社製のインプラント製品	インプラントの緩み、破損の危険性が高まる恐れがある。	組合せの互換性が確保できないため固定力等が不足する。
・材質の異なるインプラント製品	腐食による不具合の危険性が高まる恐れがある。	異種金属が隣接する事により電気化学的な作用により腐食が生じる。

4. 不具合・有害事象

本製品の使用において、患者の状態、骨折部の形態及び骨癒合の状態などにより次のような不具合・有害事象がまれに現れることがあるので、異常が認められた場合は直ちに適切な処置を施して下さい。

- 1) 重大な不具合
・製品の破損、破損片の体内遺残
- 2) 重大な有害事象
・偽関節、変形骨癒合、再骨折（術中／術後）
・カットアウト、インプラントの脱転
・感染症、血栓症
・骨の短縮、骨壊死、骨密度の低下
・金属アレルギー、異物アレルギー
・手術における神経的損傷、穿孔時発熱障害
- **3)** その他の不具合
・挿入／抜去時の製品／器具の破損
・術後のインプラントの緩み、Z-effect
・ラグスクリューの過度のスライディング又は骨頭穿破
・ラグスクリューのスライディング不良
- 4) その他の有害事象
・痛みや不快感、異物感
・骨癒合不全
・血行再生障害
・挿入／抜去時における破損器具の体内遺残
・金属製インプラントの内在に起因するX線、MRI、CTへの影響

5. 高齢者への適用

高齢者は一般に骨量・骨質が十分でないことが多いので、慎重に使用し、治療の経過にも十分に注意して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：高温、多湿、直射日光を避けて常温で保管
有効期間・使用の期限：外箱ラベルに記載「自己認証による」

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社ホムズ技研
〒391-0213 長野県茅野市豊平 4734-352
電話番号 0266-76-5881

製造業者

株式会社ホムズ技研