MES-CG08-061-43

２０２１年 ７ 月（第１版）

製造販売届出番号:13B1X00306N10017

器０１　手術台及び治療台
一般医療機器　　手術台アクセサリー　　(70469000)

伸縮式スクリーン掛（ロング）

【禁忌・禁止】

1．他社製手術台では使用しないこと。［他社製手術台での使用可能は確認していません。］
2．スクリーンで患者の顔を覆わないこと。［患者の顔にスクリーンがかかったらすぐに上げて下さい。］

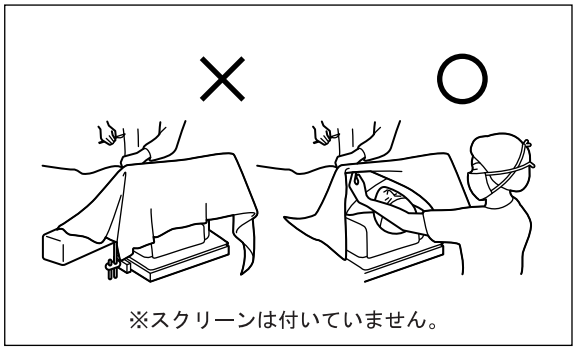

【形状・構造及び原理等】

１．外観図

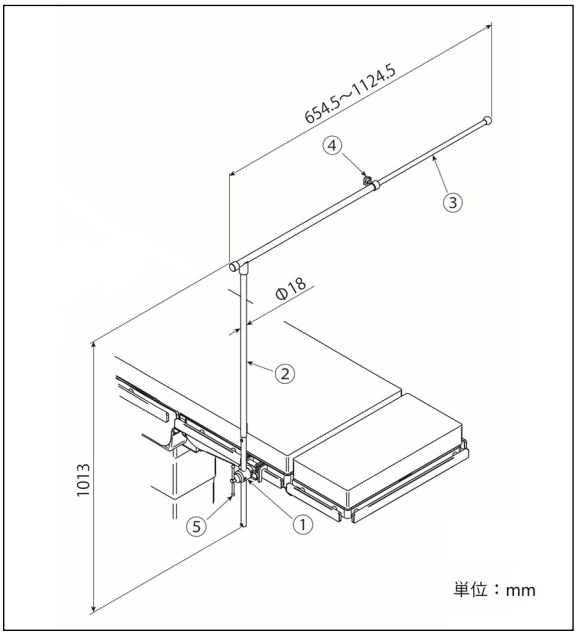

商品コード	商品名	構成	質量
08-061-43	伸縮式スクリーン掛 ロング　固定金具付	①②③④⑤	3.3kg
08-110-01	レール固定金具（大型） Ver.2	①⑤	0.9kg

２．　原材料

①レール固定金具：ステンレス鋳鋼品
②スクリーン掛：ステンレス鋼棒
③横棒：ステンレス鋼棒
④固定ハンドル：合成樹脂
⑤固定ハンドル：ステンレス鋼棒
注：番号は１．外観図の番号に対応

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリーであり、伸縮式のスクリーン掛。手術台のサイドレールの一方に角度自在調節のできるレール固定金具に取り付けて使用する。

【使用方法等】

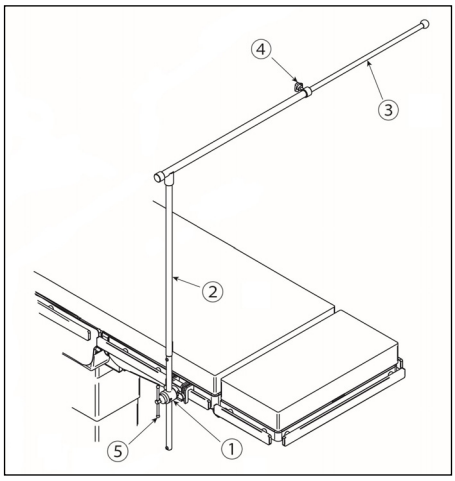

1. 手術台のサイドレールにレール固定金具①を取り付けます。
2. スクリーン掛②をレール固定金具①に差し込み、付属の固定ハンドル⑤で仮止めします。
3. 患者の体位に合わせてスクリーン掛②を動かし位置を調整します。
4. 調整後、固定ハンドル⑤を締めてレール固定金具①及びスクリーン掛②を固定します。
5. 必要に応じて、固定ハンドル④で横棒③の長さを調節します。
6. 収納時は横棒③を収納して、固定ハンドル④を締めます。

【使用上の注意】

１． 重要な基本的注意

① 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

② 手術台を作動させるときは、他の手術台アクセサリーやテーブルトップとの接触・干渉に注意して下さい。

２． 相互作用

［併用注意］

分離式手術台で使用する場合は、分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動させてください。接触するとテーブルトップの分離ができず、アクセサリーが破損するおそれがあります。

【保管方法及び有効期間等】

１．保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管して下さい。

２． 耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：７年（注）

［自己認証による］

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

１． 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認して下さい。

２． 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭して下さい。

３．故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社　千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。