MES-CG08-051-00

＊２０１７年１１月（第２版）（新記載要領に基づく改訂）
２０１４年 １ 月 １ 日（第１版）

製造販売届出番号:13B1X00306N10033

器０１　手術台及び治療台
一般医療機器　　手術台アクセサリー　（70469000）

改良型下肢牽引装置 ＭＯＣ－１４２

＊ 【警告】
患者の任意の体位を確保するためにアクセサリーで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]

＊ 【禁忌・禁止】
他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]

＊【形状・構造及び原理等】
１．形状・構造

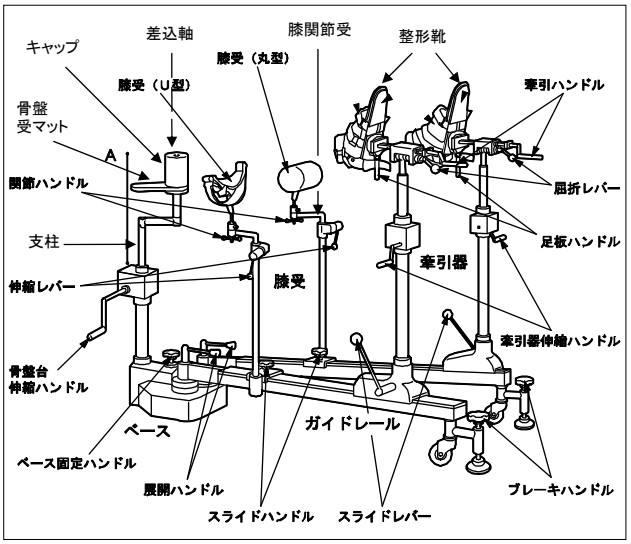

製品コード：08-051-00

構成品

No.	構成品
1	ベース/ガイドレール
2	整形靴（左右各 1）　（製品コード：08-115-05）
3	牽引器（左右各 1）
4	膝受（丸型）
5	膝受（U 型）
6	骨盤受（側臥位用）
7	骨盤受（大）
8	骨盤受（中）
9	骨盤受（小）
10	マット（側臥位用）
11	マット（大）
12	キャップ（大）　（製品コード：08-115-37）
13	キャップ（小）
14	骨盤台伸縮ハンドル
15	L 型支柱
16	股間支柱（大）　（製品コード：08-115-36）
17	股間支柱（小）
18	差込軸
19	側臥位股間受
20	膝関節受
21	側臥位用支柱
22	膝受（スタンド・左右各 1）

構成品外観

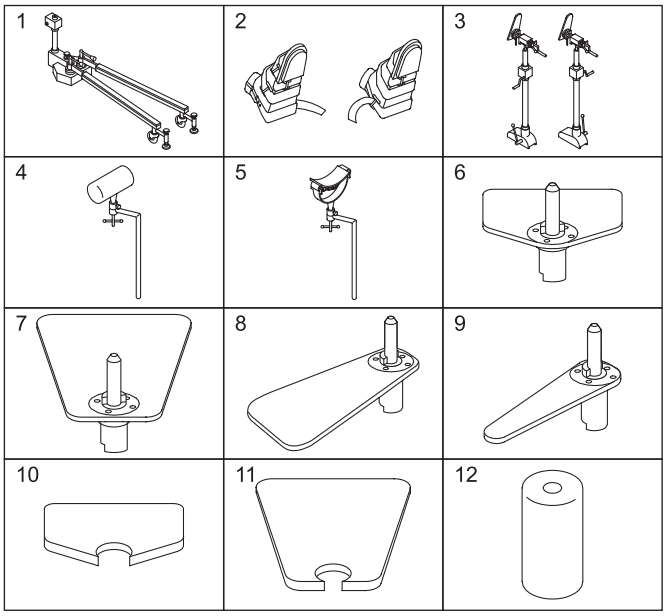

取扱説明書を必ずご参照下さい。

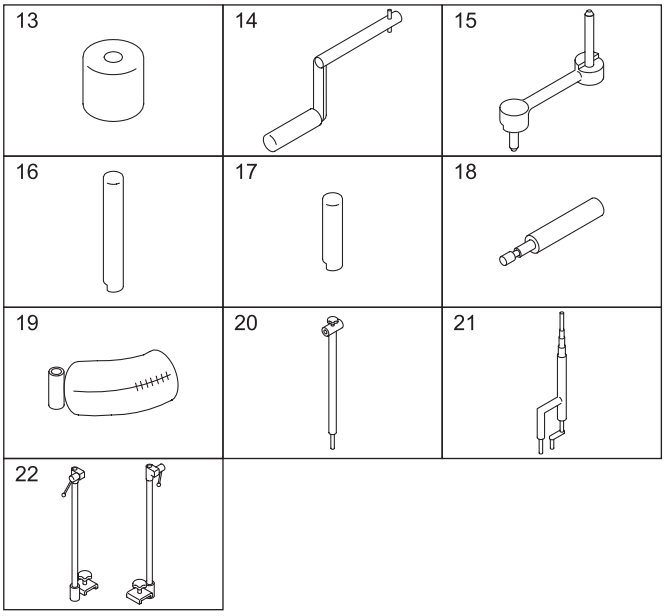

２．材質
金属製品：ステンレス鋼又は炭素鋼又はアルミ合金
樹脂製品：ウレタン又はフェノール樹脂

＊【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリー。牽引手術で患者のポジションを設定するための床置式アタッチメント。

＊【使用方法等】

１．使用方法

詳細な使用方法は取扱説明書をご参照ください。
1-1 手術台の脚板を外します。
1-2 ＭＯＣ－１４２のベースを手術台ベースの前に置きます。
1-3 ガイドレールを必要な角度に広げます。
1-4 ベースおよびブレーキの固定ハンドルを回して固定します。
1-5 牽引器・膝受・骨盤受のハンドルを操作して位置を調節します。
1-6 患者を載せてポジションを設定します。

２．下肢牽引装置の組合せ例

① 大腿骨頸部骨折手術位

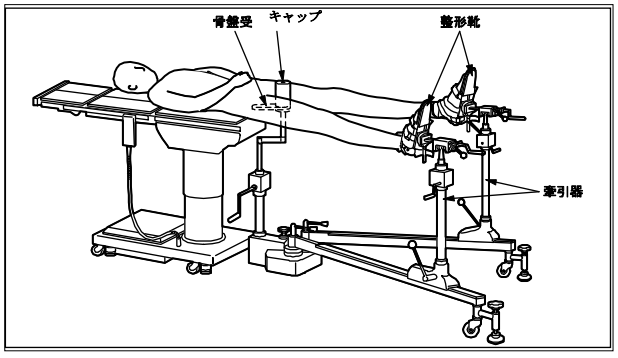

② 大腿骨骨幹部骨折手術位

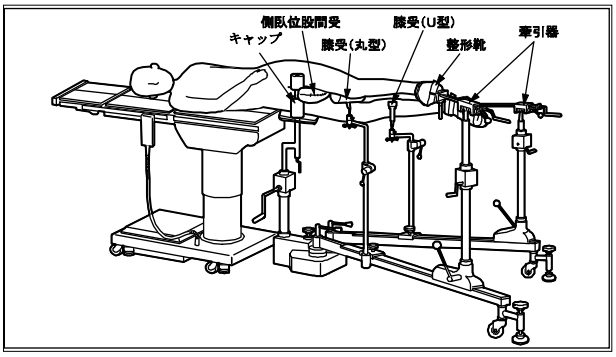

③ 下腿骨骨折手術位

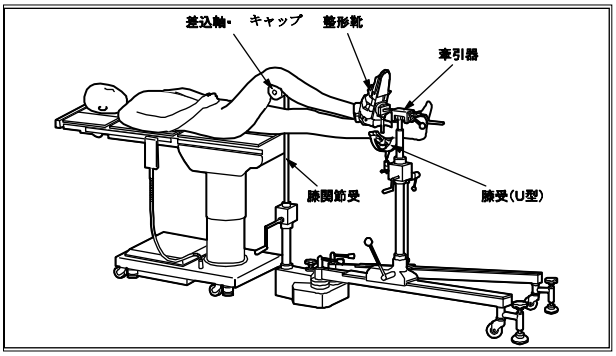

＊【使用上の注意】

１．警告

① 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では器機が外れたり、動いたりして、患者に障害が起きるおそれがあります。

２．重要な基本的注意

① 手術台を作動するときは他のアクセサリーやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
② 靴型（№２）のベルトを無理に引っ張らないでください。破損するおそれがあります。
③ 下表の商品を使用する際はマット部分に鋭利なものをあてないでください。破損するおそれがあります。
④ 靴型（№２）及びマットを使用する商品（下表）は、消毒剤の種類によっては材質が劣化するおそれがあります。消毒剤を使用する前に必ず表示又は説明書の内容を確認してください。

注：№は【形状・構造及び原理等】１．構成品・材質欄の表№に対応。

≪マットを使用する商品≫

№	商品名
4	膝受（丸型）
10	マット（側臥位用）
11	マット（大）
12	キャップ（大）
13	キャップ（小）
19	側臥位股間受

３．相互作用

［併用注意］
分離式手術台での使用では、分離／装着時は必ず下肢牽引装置を手術台から離してください。手術台ベースの前に置いた状態では分離／装着ができません。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

＊【保管方法及び有効期間等】

１．保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

２．耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：７年（注）
［自己認証による］

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（マット及び靴型を含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

＊【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

１．使用前・使用後の点検

① 使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

② 靴型（№２）は「ベルトを引っ張っても破損しないこと」を確認してください。

２．清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

３．故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

【保証期間に係わる事項】

本品は納品/設置してから１年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。

取扱説明書を必ずご参照下さい。