MES-CG08-075-11
＊２０１７年１１月（第２版）（新記載要領に基づく改訂）
２０１４年 １ 月 １ 日（第１版）

製造販売届出番号:13B1X00306N10099

器０１　手術台及び治療台
一般医療機器　手術台アクセサリー　（70469000）

ベースユニットアタッチメント２０Φタイプ（M）

＊ **【警告】**
患者の任意の体位を確保するために アクセサリーで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺 や褥瘡の原因になります。]

＊ **【禁忌・禁止】**
1．他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]
2．ベースユニット以外の機種では使用しないこと。[他機種での使用可能は確認していません。]

＊【形状・構造及び原理等】

1．外観図

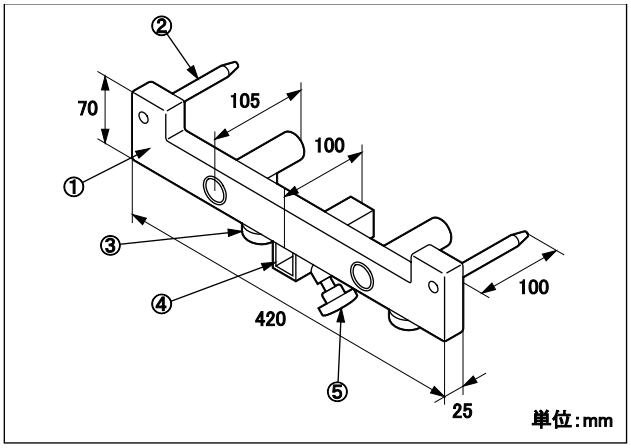

① フレーム　④ アタッチメント差込口
② 差込軸　⑤ アタッチメント固定ハンドル
③ 固定ハンドル

商品コード	商品名
08-075-11	ベースユニットアタッチメントΦ20 ㎜ タイプ（M）

２．質量
2.1 kg

３．材質
本体：ステンレス鋼棒、ステンレス鋼管
固定ハンドル：合成樹脂

＊【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリー。頭部受等のベースユニットを支持するための器具。

＊【使用方法等】

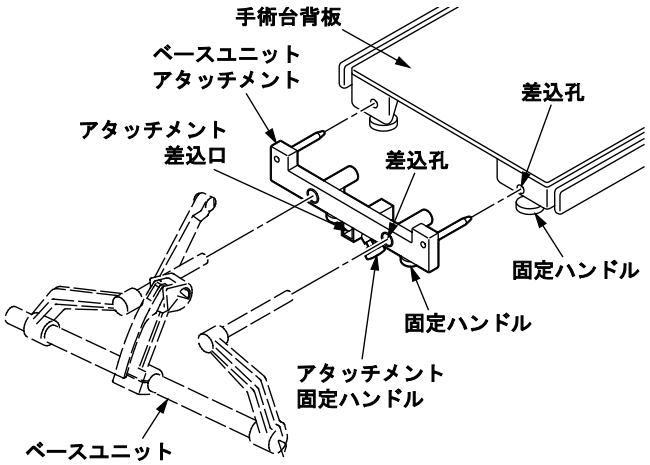

1 手術台の頭部板を取り外します。
2 手術台の背板差込孔にベースユニットアタッチメントを取り付けます。
3 手術台背板の固定ハンドルを締めます。
4 ベースユニットアタッチメントの差込穴にベースユニットを取り付けます。
5 ベースユニットアタッチメントの固定ハンドルを締めます。
6 ベースユニットの使用方法に従って構成部品等を取り付けます。
注：ベースユニットの詳細な使用方法は、ベースユニットの取扱説明書を参照してください。

＊【使用上の注意】

１．警告
締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

２．重要な基本的注意
① ベースユニットは、ベースユニットの取扱説明書に従って使用してください。
② 手術台を作動するときは他の手術台アクセサリーやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

３．相互作用
[併用注意]
分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動してください。接触するとテーブルトップ分離ができず本品及び併用機器が破損するおそれがあります。

＊【保管方法及び有効期間等】

１．保管方法
高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

２．耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：７年（注）

［自己認証による］

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

＊【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

１．使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

２．清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

３．故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから１年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。