MES-CG08-115-48

＊２０１７年１０月（第２版）（新記載要領に基づく改定）
２０１４年 １ 月 １ 日（第１版）

製造販売届出番号:13B1X00306N10115

器０１　手術台及び治療台
一般医療機器　　手術台アクセサリー（70469000）

スライド式牽引器

＊【警告】
１．患者の任意の体位を確保するためにアクセサリーで支持するときは常に患者の状態を監視すること。［長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因になります。］
２．側臥位での使用は下側になる腕を上肢台に固定すること。［宙にさらした状態では患者に障害が起きるおそれがあります。］

【禁忌・禁止】
＊１．他社製手術台では使用しないこと。［他社製手術台での使用可能は確認していません。］
＊２．【使用方法等】２．使用可能な手術台アクセサリーに示す機種以外では使用しないこと。［他機種での使用可能は確認していません。］
３．牽引器の位置調整後、スライドロックレバーを ON（押し込んだ状態）にすること。［牽引直前に牽引器がスライドしてしまった場合、過牽引になるおそれがあります。］
＊４．スライドロックレバーが OFF の状態（手前に引いた状態）では牽引を行わないこと。［牽引器が急にスライドして患者に障害が起きるおそれがあります。］

【形状・構造及び原理等】

１．形状・構造

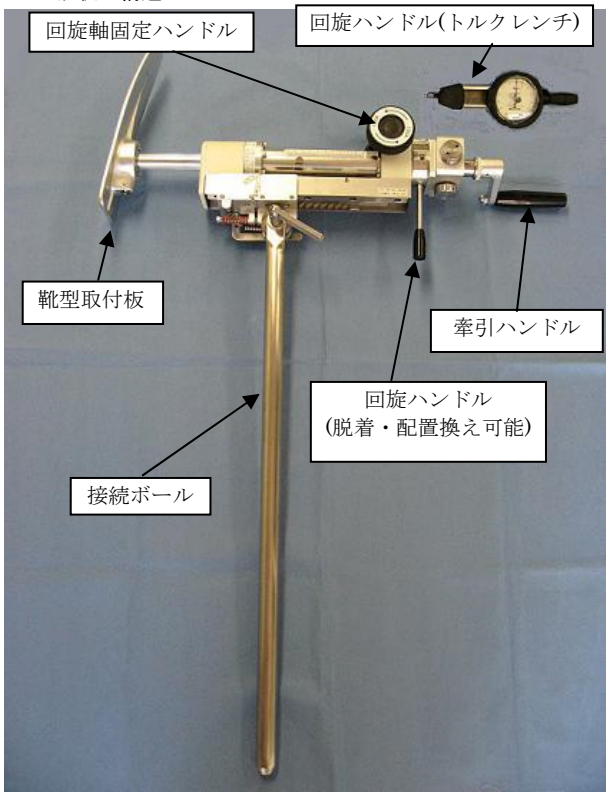

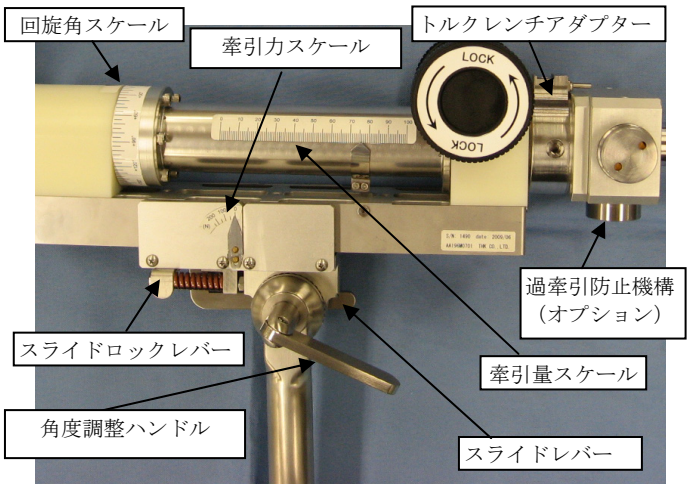

＜拡大図＞

商品コード	商品名
08-115-48	スライド式牽引器

＊２．外寸
650 ㎜(長)×101 ㎜(幅)×950 ㎜(高)
＊３．質量
8Kg
４．材質
ステンレス鋼・アルミニウム合金鋳物・合成樹脂

＊【使用目的又は効果】
手術台に付属するアクセサリーであり、牽引手術で患者のポジションを設定するための器具である。牽引距離、牽引力、回転角度及びトルクを表示する機能を有する。

＊【使用方法等】
＊１．使用方法
1-1 次頁 1-7 に示す図の様にスライド式牽引器を取付けます。
1-2 牽引量スケールが０㎜になる様に、牽引ハンドルを回して調節します。
1-3 回旋角スケールが０° になる様に、回旋軸固定ハンドルを緩めて調節して０° で LOCK します。
1-4 靴型取付板と患者の足までの距離を調整します。調整は展開アームで行い、微調整は牽引器のスライド機構で行います。
1-5 靴型取付板に患者の足を固定して牽引を行います。
牽引は牽引ハンドルを回します。牽引量スケールと牽引力スケールを確認しながら牽引を行います。
1-6 回旋方向の整復は、回旋軸固定ハンドルを緩めて、回旋ハンドル（トルクレンチ）を回します。回旋角スケールとトルクを確認しながら整復を行います。整復後、回旋軸固定ハンドルを LOCK します。

1-7 スライド式牽引器の組合せ例

例）大腿骨頸部骨折手術位

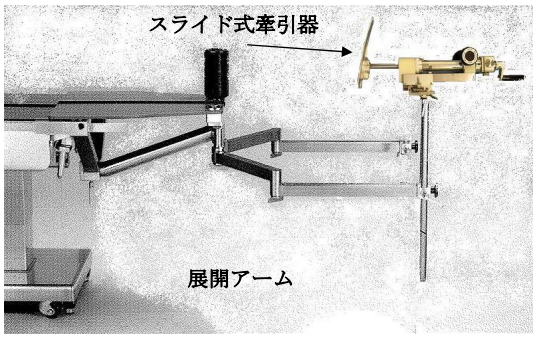

＊２．使用可能な手術台アクセサリー

販売名：下肢牽引装置 製造販売届出番号：13B1X00306N10032

【使用上の注意】

＊１．警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

２.重要な基本的注意

手術台を作動するときは他の併用機器やテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

３.相互作用

［併用注意］

分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動してください。接触するとテーブルトップの分離ができず本品及び併用機器が破損するおそれがあります。

＊【保管方法及び有効期間等】

＊１．保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

＊２．耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：７年（注）

［自己認証による］

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】

＊＜使用者による保守点検事項＞

１．使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

２．清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

３．故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

＊【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから１年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。