MES-CG08-300-01

＊２０１７年 ９ 月（第２版）（新記載要領に基づく改訂）
２０１４年 １ 月 １ 日（第１版）

製造販売届出番号：13B1X00306N10153

器０１　手術台及び治療台
一般医療機器　　手術台アクセサリー　（70469000）

特定保守管理医療機器

ＭＯＴサイドカメラアーム

＊
【禁忌・禁止】
1．他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]
2．各種固定ハンドル及びネジ部が緩んだ状態で使用しないこと。[カメラアーム及びカメラ本体が動き、患者に障害が起きることがあります。]
3．許容荷重を越えたカメラを装着しないこと。[カメラアームが動き患者に障害が起きることがあります。]
4．設置後の調整はカメラ装着ネジ及びグースネックで行うこと。[カメラ本体が緩む可能性があります。]
5．アーム及びグースネック部分に物を掛けないこと。[荷重により関節軸が動き患者に障害が起きることがあります。]

＊【形状・構造及び原理等】

１．　外観図

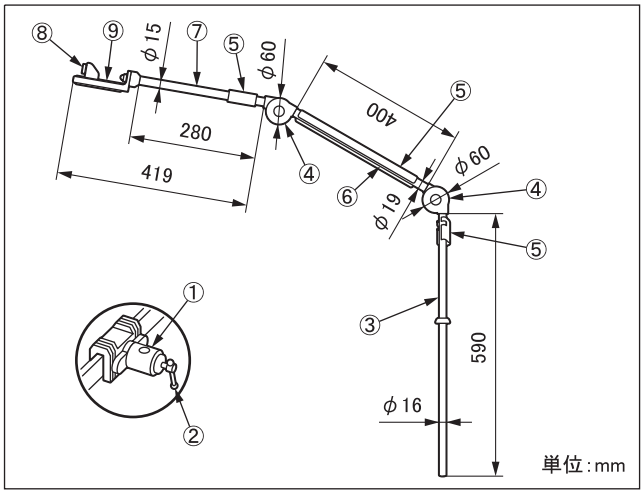

① レール固定金具　④ 関節軸　⑦ グースネック
② 固定ハンドル　⑤ 配線カバー　⑧ カメラ装着ネジ
③ 支柱　⑥ アーム　⑨ カメラアダプター

商品コード	商品名	構成
08-300-01	ＭＯＴサイドカメラアーム（固定金具付）	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨
08-110-01	レール固定金具（大型）Ver.2	①②

２．　質量

本体：2.2 kg　　レール固定金具：0.9 kg

３．　材質

レール固定金具：ステンレス鋳鋼品
固定ハンドル／支柱：ステンレス鋼棒
アーム／一般配管用ステンレス鋼管
関節軸／配線カバー：合成樹脂
グースネック：銅合金棒
カメラ装着ネジ：アルミニウム合金棒
カメラアダプター：一般構造用圧延鋼材

４．　許容荷重

３００ｇ（取付可能なカメラの質量）

＊【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリーです。術野を撮影するためのカメラを先端に取付けするための屈折可能なアームです。

＊【使用方法等】

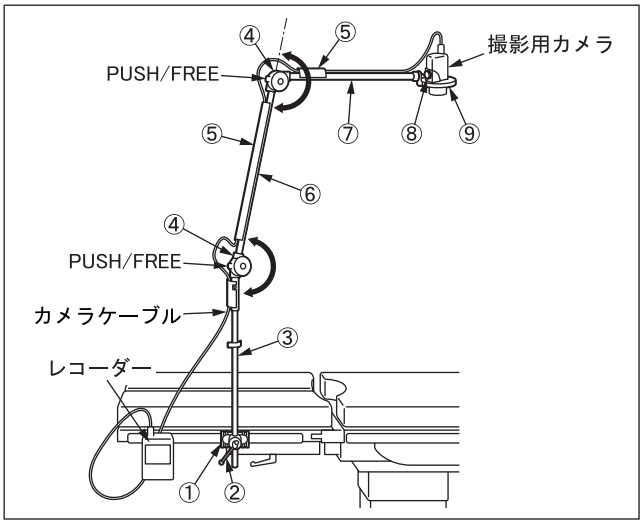

① レール固定金具　⑥ アーム
② 固定ハンドル　⑦ グースネック
③ 支柱　⑧ カメラ装着ネジ
④ 関節軸　⑨ カメラアダプター
⑤ 配線カバー

1. 撮影用のカメラを、カメラアダプター⑨にカメラ装着ネジ⑧で取り付ける。
2. カメラアダプター⑨を回転して、位置を調整・固定する。
3. 撮影用のカメラの配線（カメラケーブル）を配線カバー⑤の内側に挿入して、レコーダーシステムへの接続準備をする。
4. 支柱③をレール固定金具①を介して手術台のサイドレールに取り付ける。
5. 支柱③の位置を固定ハンドル②で調整・固定する。
6. 関節軸④のボタン(PUSH/FREE)を操作して、アーム⑥およびグースネック⑦の位置を調節･設定する。
7. カメラケーブルをレコーダー本体に取り付ける。
（レコーダーはレール固定用の専用装置が付いています。）
8. 画像撮影及び記録の状態を確認する。

＊【使用上の注意】

１．警告

締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

２．重要な基本的注意
手術台を作動するときは他のアクセサリーやテーブルトップとの接触・干渉に注意して下さい。

３． 相互作用
［併用注意］
分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動させること。接触するとテーブルトップの分離ができず併用機器及び本品が破損するおそれがあります。

＊【保管方法及び有効期間等】

１． 保管方法
高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管して下さい。

２． 耐用期間
適切な保守点検及び適切な保管をした場合：７年（※）［自己認証による］

※耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

＊【保守・点検に係る事項】
＜使用者による保守点検事項＞

１． 使用前・使用後の点検
使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認して下さい。

２． 清掃・消毒
血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭して下さい。

３．故障時のお願い
本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社　千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから１年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。

***