MES-CG08-075-42

＊＊２０１７年１２月（第４版）
＊２０１７年 ９ 月（第３版）

＊＊ 製造販売届出番号：13B1X00306N10120

器０１ 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリー（70469000）

＊＊ 腰部延長ボード（300 ㎜）

＊ **【警告】**
患者の任意の体位を確保するためにアクセサリーで支持するときは常に患者の状態を監視すること。［長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となります。］

【禁忌・禁止】
他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]

	商品ｺｰﾄﾞ	商品名	構成	質量
＊＊	08-075-42	腰部延長ボード 300㎜ 本体	①②③④⑦	10 kg/個
＊＊	08-075-43	腰部延長ボード 5701 用 カセッテ枠	⑤⑥⑦	1.8 kg/個
＊＊	08-075-44	腰部延長ボード 5701 用ＥＸマットレス	⑧	1 kg/個
＊＊	08-083-00	固定式カセッテ格納枠 腰部延長ボード 300㎜ 用	⑤⑦⑨	2kg/個
＊＊	08-083-20	デジタルカセッテ格納枠 腰部延長ボード 300㎜ 用	⑦⑩⑪	2kg/個
＊＊	08-083-40	固定式・デジタル兼用ベーク板 腰部延長ボード 300㎜ 用	①⑦	1.6 kg/個
＊＊	08-083-60	ミズホオリジナルマットレス 腰部延長ボード 300㎜ 用	⑫	0.6kg/個

【形状・構造及び原理等】

＊＊ ＊ １．外観図

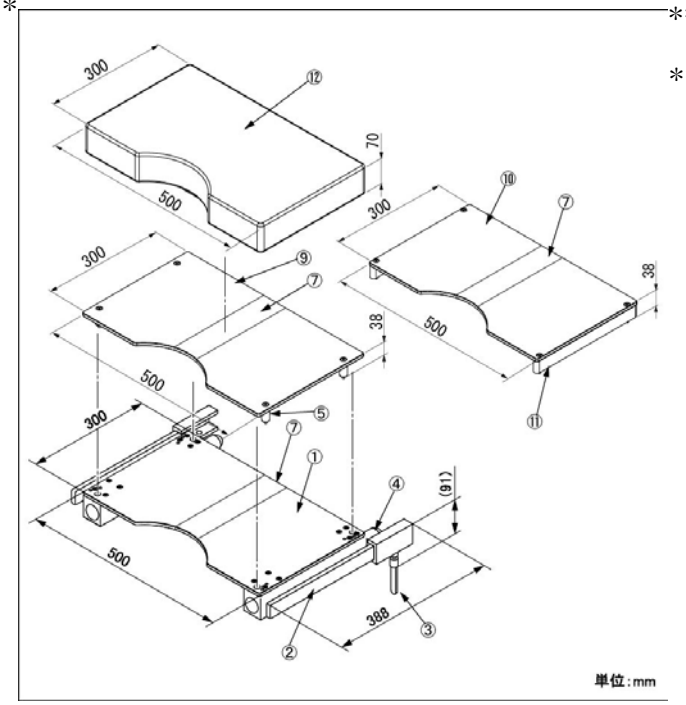

＊＊ ２．材質
＊
① ボード：熱硬化性樹脂積層板
② サイドレール：ステンレス鋼棒
③ 固定ハンドル：ステンレス鋼棒
④ 差込軸：ステンレス鋼棒
⑤ カセッテ支柱：炭素工具鋼鋼材
⑥⑨⑩カセッテ格納枠：熱硬化性樹脂積層板
⑦ 面ファスナー：ナイロン
⑧⑫マットレス：発泡ウレタン
⑪ カセッテ支柱：ポリカーボネイト
注：番号は１．**外観図**の番号に対応

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリー。
脚板を外した状態の腰板に取り付けて、患者を砕石位の体位で腎臓撮影（イメージ）をするため、腰板の長さを延長するためのボード。

【使用方法等】

＊＊ １． 使用方法
＊

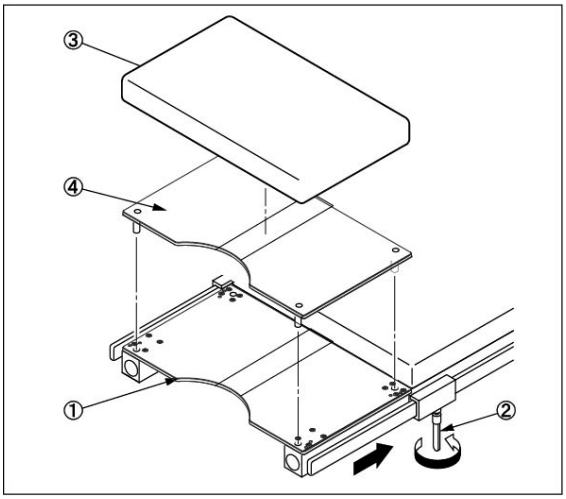

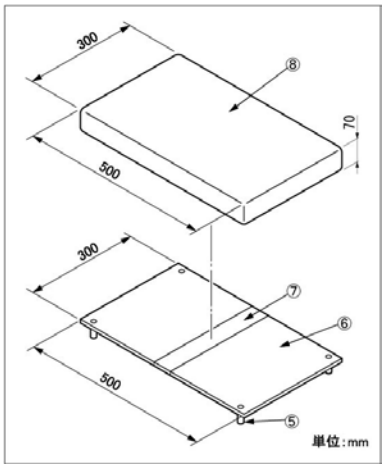

1-1 手術台の脚板を取り外します。
1-2 手術台の脚板差込孔にボード①を差し込みます。
1-3 両端の固定ハンドル②でボード①を固定します。
1-4 マットレス③を取り付けます。
1-5 X線撮影が必要な場合、ボード①とマットレス③の間にカセッテ枠④を取り付けます。

** * ２．使用可能な手術台

当社製手術台

【使用上の注意】

１．警告
締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

２．重要な基本的注意
手術台を作動するときは他の手術台アクセサリーやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

１．保管方法
高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

＊ ２． 耐用期間
適切な保守点検及び適切な保管をした場合：７年（注）
［自己認証(弊社データ)による］
注: 耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（マットレスを含む）の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【保守・点検に係る事項】
＜使用者による保守点検事項＞

１．使用前・使用後の点検
使用前･使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

２．清掃・消毒
血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭してください。

３．故障時のお願い
本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」･「使用禁止」･「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから１年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。