MES-CG08-070-25

＊＊２０２１年１１月（第３版）
＊２０１８年 ５ 月（第２版）

製造販売届出番号：13B1X00306N10242

器０１　手術台及び治療台
一般医療機器　　手術台アクセサリー　（70469000）

カーボンエクステンションボード（１００cm）

【警告】
1．患者の任意の体位を確保するためにアクセサリーで支持するときは常に患者の状態を監視すること。[長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因になります。]
2．荷重、衝撃をあたえないこと。[手術台との振動により“跳ね返り現象”が起こり、血管等を傷つけることがあります。]

【禁忌・禁止】
1．他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]
2．【使用方法等】２.使用可能な手術台に示す機種以外では使用しないこと。[他機種での使用可能は確認していません。]
3．許容荷重を越える重量を加えないこと。[破損することがあります。]

＊＊＊【形状・構造及び原理等】

１．外観図

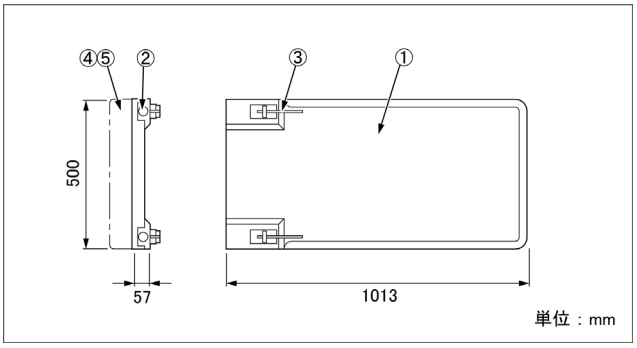

カーボンエクステンションボード 100 cm

商品コード	商品名
08-070-25	カーボンエクステンションボード 100 cm本体のみ
08-070-31	カーボンエクステンションボードマットレス 100cm 用 50mm 厚
08-070-32	カーボンエクステンションボードマットレス 100cm 用 70mm 厚
08-070-33	カーボンエクステンションボードマットレス 100cm 用 90mm 厚
08-070-34	カーボンエクステンションボードマットレス 100cm 用 110mm 厚
08-057-51	カーボンエクステンションボード 100cm マット MOP140mm 厚
08-083-65	ミズホオリジナルマットレスカーボンエクステンション 100cm 用
08-083-66	ミズホオリジナルマットレス 110mm カーボンエクステンション 100cm 用

２．質量：カーボンエクステンションボード本体　7.5 kg

３．許容荷重：120 kg

４．原材料
①ボード：炭素繊維強化プラスチック
②差込孔：アルミニウム合金板
③ハンドル：機械構造用炭素鋼鋼材
④マットレス：発泡ウレタンフォーム
⑤ＭＯＰマットレス：軟質ウレタンフォーム
注：番号は１．**外観図**の番号に対応

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリー。患者の背部を支持するための器具。Ｘ線透過性の高い炭素繊維強化プラスチックを使用。

＊＊＊【使用方法等】

１．取付け方法
1-1 手術台の頭部板及び背板を取り外します。
1-2 手術台側の差込軸を水平にした状態で、カーボンエクステンションボード（本体）を差し込みます。
1-3 カーボンエクステンションボード（本体）を手前に引いて、手術台に完全に差し込まれていることを確認します。
1-4 専用のマットレスを取り付けます。

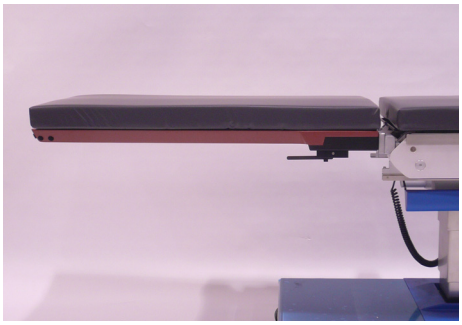

カーボンエクステンションボード 100 cm

２．使用可能な手術台
当社製手術台

＊＊【使用上の注意】

重要な基本的注意
① 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。
② 手術台を作動するときは他のアクセサリーやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。
③ 手術台と接続する部分には金属材料が使われてＸ線を透さない部分があります。Ｘ線撮影に使用するときには注意してください。
④ カーボンエクステンションボードを手術台に取り付けた状態で、カーボンエクステンションボードを引いて手術台を移動しないこと。[落下して破損又はけがをするおそれがあります。]

【保管方法及び有効期間等】

１．保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

２．耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：７年（注）

［自己認証による］

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品（マットレスを含む)の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

＊＊【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

１．　使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

２．　清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れを水で拭き取り、消毒液を浸したガーゼ等で清拭してください。手順の詳細及び使用可能な消毒液については、手術台の取扱説明書をご参照ください。

３．　故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社

TEL 03(3815)3097

製造業者：Anholt Technologies, Inc.

アンホルト テクノロジー社

アメリカ合衆国

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから１年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。