MES-CG08-064-02

＊＊２０１７年 ９ 月（第３版）（新記載要領に基づく改訂）
＊２０１４年 ３ 月２７日（第２版）

製造販売届出番号：13B1X00306N10243

器 ０１ 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリー （70469000）

上腕骨顆上骨折用上肢台Ａ

【警告】
１．患者の任意の体位を確保するためにアクセサリーで支持するときは常に患者の状態を監視すること。【長時間の体位は神経麻痺や褥瘡の原因となる場合があります。】
＊ ２．側臥位での使用は下側になる腕を上肢台に固定すること。【固定しない状態では患者に障害が起きるおそれがあります。】

【禁忌・禁止】
＊ 他社製手術台では使用しないこと。[他社製手術台での使用可能は確認していません。]

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリー。主に側臥位のポジションで患者の上部になる手腕を支持するための器具。

【使用方法等】
＊

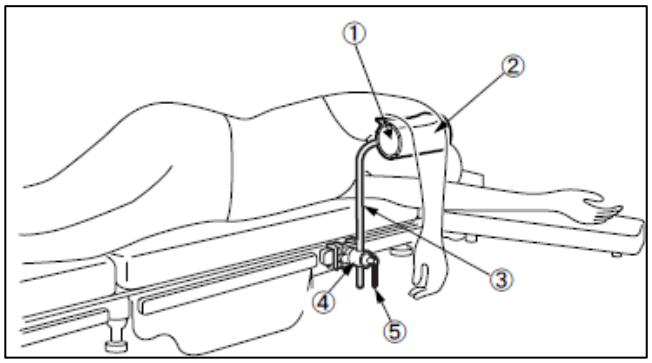

1. 手術台のサイドレールにレール固定金具④を取り付けます。
2. 支柱③をレール固定金具④に差し込み、固定ハンドル⑤を締めます。
3. 患者の上肢を支持台①の上のマット②に載せて、支柱③を動かし位置を調整します。
4. 調整後、固定ハンドル⑤を締めてレール固定金具④及び支柱③を固定します。

【使用上の注意】

１．警告
＊＊ 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。

２． 重要な基本的注意
手術台を作動するときは他のアクセサリーやテーブルトップとの接触・干渉に注意して下さい。

＊３． 相互作用
[併用注意]
分離式手術台での使用は分離時にストレッチャーレール受けに接触しない位置まで移動させること。接触するとテーブルトップの分離ができず併用機器及び本品が破損するおそれがあります。

【保管方法及び有効期間等】

＊＊１． 保管方法
＊ 高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管して下さい。

＊＊ ２． 耐用期間
＊ 適切な保守点検及び適切な保管をした場合：７年（※）[自己認証による]

※耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です。

【形状・構造及び原理等】

＊１． 外観図

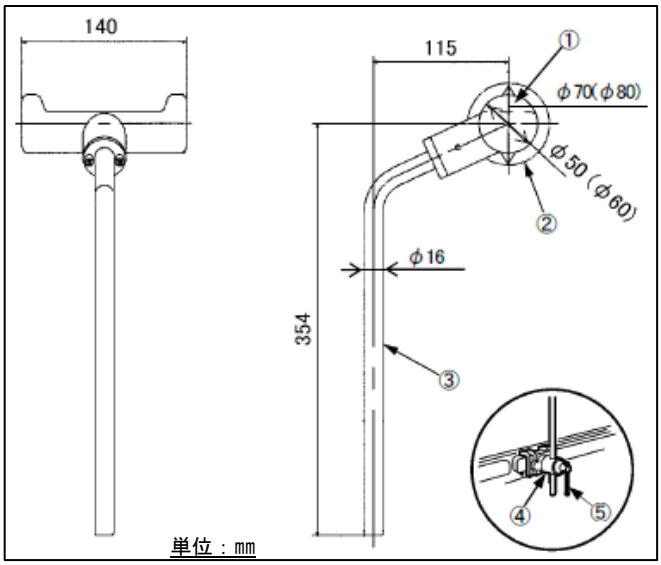

	商品コード	商品名
＊	08-064-02	上腕骨顆上骨折用 上肢台スタンダードＡφ70
＊	08-064-04	上腕骨顆上骨折用 上肢台 Ｃφ80

２． 質量
本体
上肢台スタンダードＡ：1.0 kg
上肢台 Ｃ：1.1 kg
＊固定金具：0.9 kg

＊３． 材質
3-1 本体
① 支持台：ナイロン
② マット：ナイロン
③ 支柱：ステンス鋼棒
3-2 固定金具
④ レール固定金具：ステンレス鋳鋼品
⑤ 固定ハンドル：ステンス鋼棒
＊注：番号は１．外観図の番号に対応

【保守・点検に係る事項】

＊ ＜使用者による保守点検事項＞

＊＊１． 使用前・使用後の点検

＊ 使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認して下さい。

＊＊２． 清掃・消毒

＊ 血液・薬剤・汚染等の汚れは水で拭き取り、さらに消毒用アルコール・ガーゼで清拭して下さい。

＊＊３．故障時のお願い

＊ 本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＊＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社　千葉工場

【保証期間に係る事項】

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。