MES-CG08-075-00

＊２０２２年 ３ 月（第２版）
２０１６年 ４ 月（第１版）

製造販売届出番号：13B1X00306N10268

器０１ 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリー （70469000）

幅狭頭部受

＊ 【警告】
＜使用方法＞
患者の任意の体位を確保するためにアクセサリーで支持するときは、常に患者の状態を監視すること。［長時間の体位保持は神経麻痺や褥瘡の原因になります。］

＊ 【禁忌・禁止】
＜併用医療機器＞
他社製手術台では使用しないこと。［他社製手術台での使用可能は確認していません。］

＊【形状・構造及び原理等】

１．外観図

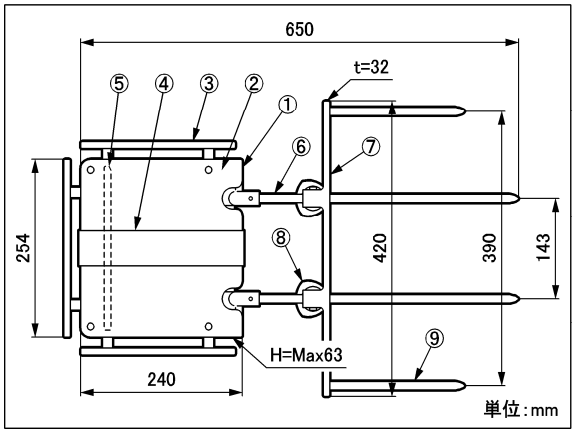

幅狭頭部受

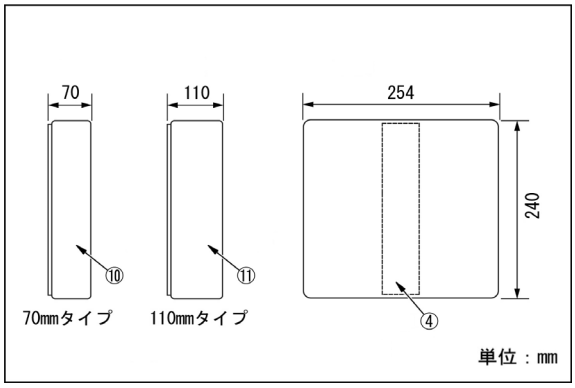

マットレス

商品コード	商品名	構成
08-075-00	幅狭頭部受	①～⑨
08-083-69	ミズホオリジナルマットレス 240mm 幅狭タイプ	④⑩
08-083-70	ミズホオリジナルマットレス 240mm 幅狭タイプ 110mm 厚	④⑪

２．質量

幅狭頭部受本体：7.5 kg
マットレス（70mm タイプ）：0.2 kg
マットレス（110mm タイプ）：0.3 kg

３．原材料

① 頭受フレーム：アルミニウム合金鋳物
② ボード：熱硬化性樹脂積層板
③ サイドレール：ステンレス鋼棒
④ 面ファスナー：ナイロン
⑤ 頭受屈折レバー：アルミニウム合金棒
⑥ 頭受差込軸：ステンレス鋼棒
⑦ アタッチメントフレーム：ステンレス鋼棒
⑧ 固定ハンドル：ステンレス鋼棒
⑨ アタッチメント差込軸：ステンレス鋼棒
⑩ マットレス：ポリウレタン
軟質ウレタンフォーム
注：番号は１．外観図の番号に対応

４．機能

頭受屈折範囲
上がり:60° ／下がり:90°（手動）

【使用目的又は効果】

手術台に付属するアクセサリー。通常の頭部受よりも幅の狭い頭部受。アタッチメントを介して、手術台本体に取り付けて頭部を支持。

＊【使用方法等】

１．取り付け方法

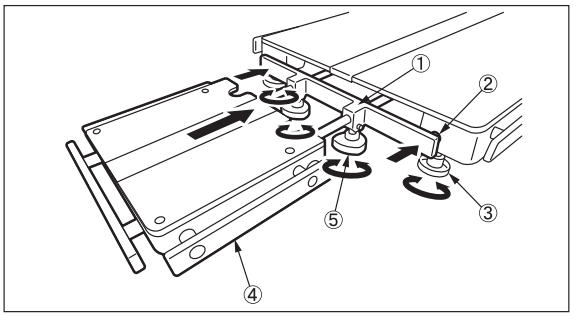

1-1 スライド機構を有する手術台へ取り付ける場合、スライドを中点位置にしてください。
1-2 手術台の頭部板を外します。
1-3 アタッチメント①を頭部板差込孔②に差し込み、頭部板固定ハンドル③を回して固定します。
1-4 頭部受④をアタッチメント①に差し込み、固定ハンドル⑤を回して固定します。

２．取り付け可能な手術台

弊社製手術台

＊【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 締結部の固定は必ず確認してください。ゆるんだ状態では機器が外れたり、動いたりして患者に障害が起きるおそれがあります。
2. 本製品を手術台に取り付け後、手術台のスライド機能は使用せず、スライドを中点位置のままご使用ください。
3. 手術台を作動するときは他の手術台アクセサリーやテーブルトップとの接触・干渉に注意してください。手術台のスライド機能は使用しないでください。

＊【保管方法及び有効期間等】

１．保管方法

高温・高湿を避け温度や湿度が極端に変化しない場所及び水のかからない場所に保管してください。

２．耐用期間

適切な保守点検及び適切な保管をした場合：７年（注）
［自己認証（弊社データ）による］

注：耐用期間内であっても、使用状況又は使用頻度により、突発的な故障、部品の著しい消耗・劣化・破損等を生じた場合は該当部品の交換が必要です

＊【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

1. 使用前・使用後の点検

使用前・使用後に「破損箇所がないこと」を確認してください。

2. 清掃・消毒

血液・薬剤・汚染等の汚れを水で拭き取り、消毒液を浸したガーゼ等で清拭してください。なお、消毒液は弊社製手術台にて確認済みの消毒液と同一のものをご使用ください。確認済みの消毒液については手術台の取扱説明書をご参照ください。

3. 故障時のお願い

本装置が故障したと思われるときは、本装置に「故障」・「使用禁止」・「修理必要」等の適切な表示をし、ご購入店又は弊社に連絡してください。

＜業者による保守点検事項＞

弊社及び弊社が認めた業者のみが実施可能です。それ以外の業者による保守・点検は、有害事象の発生、性能・機能低下の事態を招くおそれがあります。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ミズホ株式会社
TEL 03(3815)3097

製造業者：ミズホ株式会社千葉工場

保証期間に係る事項

本品は納品/設置してから 1 年間を保証期間として無償修理いたします。但し第三者が修理した場合、天災による破損、不適切な使用、あるいは故意による破損は除きます。その他保証条件は弊社規定に依ります。