


機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 鉗子 10861001

閉胸器

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

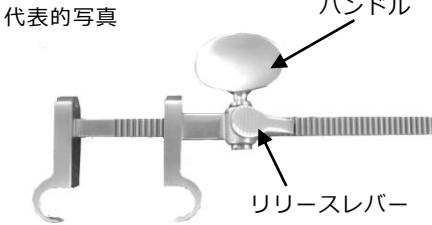

2. 原材料：ステンレス鋼

3. 原理

可動する爪は、ハンドルを回転させることにより閉じる。

【使用目的又は効果】

胸部の手術等で視野確保のために拡げた肋骨をもとに復するために用いる手術器具をいう。本品は再使用可能である。

* 【使用方法等】

使用方法

- 1) 使用前に、必ず洗浄・滅菌を行う。医療機関でバリデーションされた滅菌条件で滅菌すること。（【保守・点検に係る事項】参照）
- 2) 可動部をいったん広げ、使用部位に挿入する。
- 3) ハンドルを回転させて、可動部によって組織等を適切な位置まで閉じる。
- 4) はずす場合には、適切な位置まで可動部をいったん広げて取り外す。

* 【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1) 本品がハイリスク手技に使用された場合には、ブリオン病感染予防ガイドラインに従った洗浄・滅菌を実施すること。（【保守・点検に係る事項】参照）
- 2) 本品がブリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。

* 【保守・点検に係る事項】

1. 清掃方法

- 1) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄・消毒し、必要に応じて滅菌する。
- 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守る。
- 3) 潤滑剤や防錆用の保守油等が塗布されている場合があるため、滅菌を行う場合は適切に除去すること〔油が付着したまま高圧蒸気滅菌を行うと、器具が変色する可能性がある〕。

- 4) 超音波洗浄装置・ウォッシャーディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、可動部分は開放し、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理する。
- 5) 金属タワシ、クレンザー（磨き粉）等は、器具表面を損傷するので使用を避ける。
- 6) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨する。
- 7) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥する。
- 8) 手術器具用潤滑剤の塗布を推奨する〔可動部の防錆のため〕。
- 9) 「医療現場における滅菌保証のガイドライン2021」に記載されている高圧蒸気滅菌条件は以下のとおり。

滅菌温度	保持時間
121℃	15分
126℃	10分
134℃	3分

- 10) 「ブリオン病感染予防ガイドライン 2020」に記載されている洗浄・滅菌条件は以下のとおり。洗浄においては、アルカリ洗浄剤を用いて 90-93℃ の高温で行う。ウォッシャーディスインフェクターの使用が望ましい。工程を 2 回繰り返すこととも推奨される。滅菌においては、134℃/8-10 分の真空脱気プレバキューム高圧蒸気滅菌を行う。滅菌時間は 18 分に延長することも推奨される。

2. 点検

滅菌前、使用前に汚れ・破損・変形・可動部の動き等を点検する。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：村中医療器 株式会社
TEL : 0725-53-5546



製造業者：マックスハウゼー社 ドイツ
Max Hauser Su(“)ddeutsche Chirurgiemechanik GmbH