*2020 年 6 月 （第 4 版）
** 2017 年 10 月 （第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）

届出番号　27B1X00109000211

機械器具 58　整形用機械器具
一般医療機器　　手術用ドリルビット　　32390000

ベクト　セラミックツイストドリルエキストラショート

【形状・構造及び原理等】

［形状・構造］

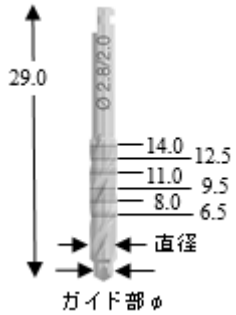

［サイズ・種類］

（単位：mm）

規格	直径	ガイド部 φ
2.8	2.8	2.0
3.5	3.5	2.8
4.3	4.3	3.5
5.3	5.3	4.3

［体に接触する部分の主な組成］

セラミック

［原理］

歯科用ハンドピースに装着して使用する。

【使用目的又は効果】*

ＳＰＩシステムインプラント又はイニセルインプラントを埋入する際、骨を穿孔するのに使用する。

【使用方法等】**

［使用方法］

(1) 本品を歯科用ハンドピースに装着する。
(2) 軽く圧力をかけながら、埋入するインプラント体の深さまで埋入窩を形成する。

［使用方法等に関連する使用上の注意］

(1) ハンドピースメーカーの指定に従って軸部を奥まで挿入し、確実にロックされていることを確認すること。
(2) 使用前に回転させて振れがないことを確認すること。
(3) 本品は、回転させた状態で穿孔を始めること。
(4) 使用回転数は、下表を目安とすること。

規　格	回転数（rpm）
2.8	600
3.5	500
4.3	400
5.3	300

(5) 本品は、骨内で回転を止めないように使用すること。
(6) 本品は、逆回転では使用しないこと。
(7) 破損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
(8) 術中は外部注水により冷却効果を確保し、常に断続的なポンピングで行うこと。
(9) 本品の使用回数は、20 症例が目安である。（20 回まで使用可能ということではない。）
(10) 本品は、長さ 14 mm までのインプラント体に使用すること。

【保守・点検に係る事項】

［滅菌］

(1) 初回使用前と毎診療後に、必ず高圧蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件（日本薬局方による）：115～118℃ 30 分間
121～124℃ 15 分間
126～129℃ 10 分間
(2) 135℃以上に加熱しないこと。
(3) プラスチックケースは耐熱性がないため、滅菌の際は使用しないこと。

［殺菌・消毒］

(1) 熱湯と洗浄剤の相互作用により、本品に損傷を与えるため、器具除染用洗浄器で洗浄しないこと。
(2) 変色の恐れがあるため、紫外線による殺菌は行わないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：株式会社モリタ
電 話 番 号 ： 06-6380-2525
外国製造業者： トーメン メディカル ＡＧ
Thommen Medical AG
国　　名　　： スイス

［お問い合わせ先］

問 合 せ 窓 口 ： 株式会社モリタ　お客様相談センター
電 話 番 号 ： 0800-222-8020（無料）
Ｆａｘ 番 号 ： 0800-222-6480（無料）
Ｅ－ｍａｉｌ ： e-customer@morita.com

676-07d-2006