医療機器製造販売届出番号：20B1X00007000023

機械器具 58　整形用機械器具
一般医療機器　歯科用インプラント手術器具（JMDN:70965001）

*深度ゲージ（φ4.2）

**【禁忌・禁止】
1. 併用医療機器
(1)併用禁忌
・当社が指定する製品以外とは組み合わせて使用しないこと。［「相互作用」の項参照］

【形状・構造及び原理等】
〈形状〉



（マーク部について）

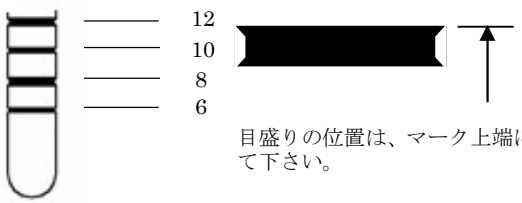

目盛りの位置は、マーク上端に合わせて下さい。

マーク位置(㎜)	6	8	10	12
マーク幅（㎜）	0.3	0.5	0.3	0.5

〔材質〕ステンレス鋼

【使用目的又は効果】
歯科用インプラントの外科手術に用いる器具であり、形成したインプラント床の深度及び径の確認に使用する。

【使用方法等】
**１．使用方法
(1)通法に従って手術野の消毒、麻酔、歯肉および骨膜の切開剥離ののち、ドリルスケジュールにそってドリリングを行います。
(2)インプラントドリルによるインプラント床形成後、インプラント床を生理食塩水で十分に洗浄してから、深度ゲージを試適し、意図した深度に形成されているかどうか確認します。
(3)所定深度までの形成が不十分な場合は、再度形成を行って下さい。

**［使用方法に関連する使用上の注意］
(1)本品は未滅菌製品ですので、使用前にオートクレーブで滅菌を行って下さい。　　滅菌条件　121℃　30 分
(2)誤飲防止のため、縫合糸やフロスなどを深度ゲージの孔に通して使用して下さい。
(3)埋入予定のインプラントサイズにより専用の深度ゲージを使用して下さい。
(4)本品はプラトンインプラントボディ Type Ⅰ、Ⅱ 専用です。

【使用上の注意】
**１．重要な基本的注意
(1)素材のステンレス鋼は、使用方法、環境によっては錆びることがありますので洗浄、乾燥、保管には十分ご注意下さい。
(2)使用後は、血液などの凝固を防ぐため、直ちに拭き取るか、防錆滅菌液入りのシャーレ等に入れて下さい。
(3)超音波洗浄の際、金属を腐食させる恐れのある洗浄液、酸性水などは使用できません。
(4)洗浄液使用後は充分水洗し、洗浄後の乾燥は充分に行ってください。また洗浄後は極力素手で扱わないようにして下さい。
(5)洗浄、滅菌には、なるべく精製水を使用して下さい。水道水を使用すると、塩素イオンの影響で腐食することがあります。
(6)「もらい錆び」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないで下さい。また、洗浄・乾燥時は他の金属材料のツールと分け、１本ずつガーゼで巻くなど取り扱いには十分ご注意下さい。

２．相互作用（他の医療機器との併用に関すること）
〔併用禁忌・禁止〕（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が指定する以外の製品	本製品は当社が指定する製品と組み合わせて使用するよう設計されています。指定外の製品とは組み合わせて使用しないこと。	形状が異なるため、適切な組み合わせが得られず、想定外の不具合が起こる恐れがある。

【保管方法及び有効期間等】
直射日光及び高温多湿を避けて保管して下さい。

＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元
株式会社　ヨシオカ
長野県駒ヶ根市下平２９３４－５７７
TEL　0265-82-5959　　FAX　0265-82-6353

販売元
PLATON JAPAN
株式会社プラトンジャパン　ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ 0120-36-8950
東京都町田市大蔵町５６　鶴川アカデメイアビル
TEL　042-734-8088㈹　FAX　042-737-6708

本医療機器の使用にあたっては添付文書のほか、ユーザーマニュアルを必ずご参照下さい。

YS02023-02-03