類別：機械器具 73 補聴器　管理医療機器　JMDN コード：41207000　一般的名称：デジタル式補聴器

販売名：補聴器　HB-W1YS

【禁忌・禁止】

幼児などの手の届かないところに保管すること。
補聴器や電池は飲み込むと危険である。

大きな音で聞き続けないこと。
大きな音で聞き続けると、さらに聞こえを悪くすることがある。また、補聴器からピーピー音が発生するハウリング状態で使用し続けると、聞こえを悪くすることがある。

他人に補聴器を貸さないこと。
他人の耳を傷めることがある。

かゆみやかぶれに注意すること。
体質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合がある。皮膚に異常を感じたときは使用を中止し、専門医に相談すること。

【形状・構造及び原理等】

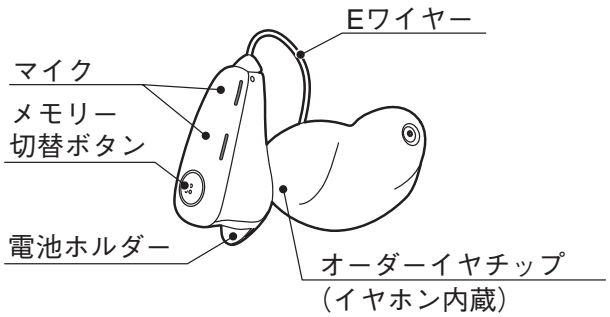

寸法／質量：	3.63 × 1.86 × 1.04 cm／ 約 8 g(EXパワーイヤホンの場合) 約 4 g(ミディアムイヤホンの場合)	
材質：	本体	ABS 樹脂 ／パーフルオロ デシルアクリラート
	E ワイヤー	ナイロン系エラストマー ／パーフルオロ デシルアクリラート
	オーダーイヤチップ	アクリル
	耳せん	シリコンゴム
空気電池：	PR48	1 個
電池寿命：	約 350 時間（EX パワーイヤホンの場合） 約 325 時間（ミディアムイヤホンの場合） 電池寿命は、使用条件によって異なる場合がある。	
原理：	音を適切な大きさに増幅して耳に伝えることにより聴力を補う。	

【使用目的又は効果】

身体に装着して、難聴者が音を増幅して聞くことを可能とすること。

【使用方法等】

電池ホルダーに電池を入れ、本体を耳に装着します。

電池ホルダーを閉じます。

メモリー切替ボタンで、内部設定を使用したい設定に切り替えます。

使用を終えるときは、電池ホルダーを開けて、耳から外します。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- この補聴器は、出荷時に 30 dB を超える音響利得がある。試聴に際して健常な聴力の方には大きな音に感じる場合がある。
- 次の場合、補聴器の使用前、あるいは使用中は中止して、耳鼻咽喉科医師の診察を受けること。

  耳漏、耳の中の痛み、難聴の進行、めまい、頭痛、耳の皮膚にかゆみやかぶれなどが認められるとき。
- 以下の診断･治療を受けるときは、補聴器を外すこと。
  - MRI（磁気共鳴画像診断装置）による診断
  - CT などの X 線を使用した診断
  - マイクロ波治療器など電磁波を利用した装置での治療
  - 放射線などによる治療
- 耳せんが外れて、耳の中に残る恐れがあるため、耳せんを正しく取り付けること。

その他の注意

- 防水用耳せんとして使用しないこと。

  この補聴器は、耳に装用した状態で、防水性能を備えているが、防水用耳せんとしては使用できない。水中に耳を浸けたり、シャワーを耳にかけたりすると、耳の中に水が入る場合がある。外耳道、鼓膜等に疾患がある場合は注意すること。
- イヤホンの音口を濡らさないこと。

  この補聴器は耳に装用した状態のときのみ、防水性能を有する。そのためイヤホンの音口を濡らすと、イヤホンの内部に浸水する。

取扱説明書を必ず参照してください

- 洗面所や道路など、落とすと壊れやすい場所での補聴器のつけ外しをしないこと。
- ヘアスプレーや香水等、気化する物を使用しないこと。
- ストーブのそば、直射日光の当たる場所、車の中などの温度の高くなるところや、浴室、加湿器のそばなど湿度の高くなるところに置かないこと。
- 内部をハリ、ピン、ペン先などでつつかないこと。
- 取扱説明書に従い、指定の電池を使用すること。
- 強力な磁気を帯びたものを接触させないこと。
- 補聴器を砂地の上に置かないこと。
  この補聴器は耳に装用した状態のときのみ、防じん性能を有する。そのため補聴器を砂地の上に置くと、イヤホンの内部に砂が侵入する。
- 高圧の水流をあてないこと。
- 高い水圧をかけないこと。
- 高温多湿環境に長時間さらさないこと。
- 海水、日焼けローション、シェービングローション、整髪料、育毛剤、化粧水、香水、ヘアカラー、温泉水など、真水や水道水以外の液体に触れさせないこと。
- 電池ホルダーを閉めるとき、毛髪、ゴミなどを挟むと、防水・防じん性能が一時的に低下するので、注意すること。
- 水泳や入浴後は、綿棒などで耳内の水を除去してから、装用すること。
- 乳児が使用する場合には、誤飲等に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

輸送や保管に関する環境条件：

温度：-10～50℃

湿度：10～90％（ただし結露なきこと）

直射日光の当たる場所を避け、保管すること。

耐用期間　［自己認証（当社データ）による］

本体　5年

【保守・点検に係る事項】

使用者（装用者）による保守点検事項

・ご使用後には、補聴器本体や電池を、タオル等を使用してお手入れをしてください。詳細は、取扱説明書の「使い終わったら」の章を参照してください。

・防水・防じん性能を維持するため、1年間有効の防水点検を、1年に1度、業者（販売店）に依頼してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

リオン株式会社

TEL：042-359-7880（代表）

FAX：042-359-7441